


# **Instrumentální technika**

laboratorní pomůcky a  
zařízení





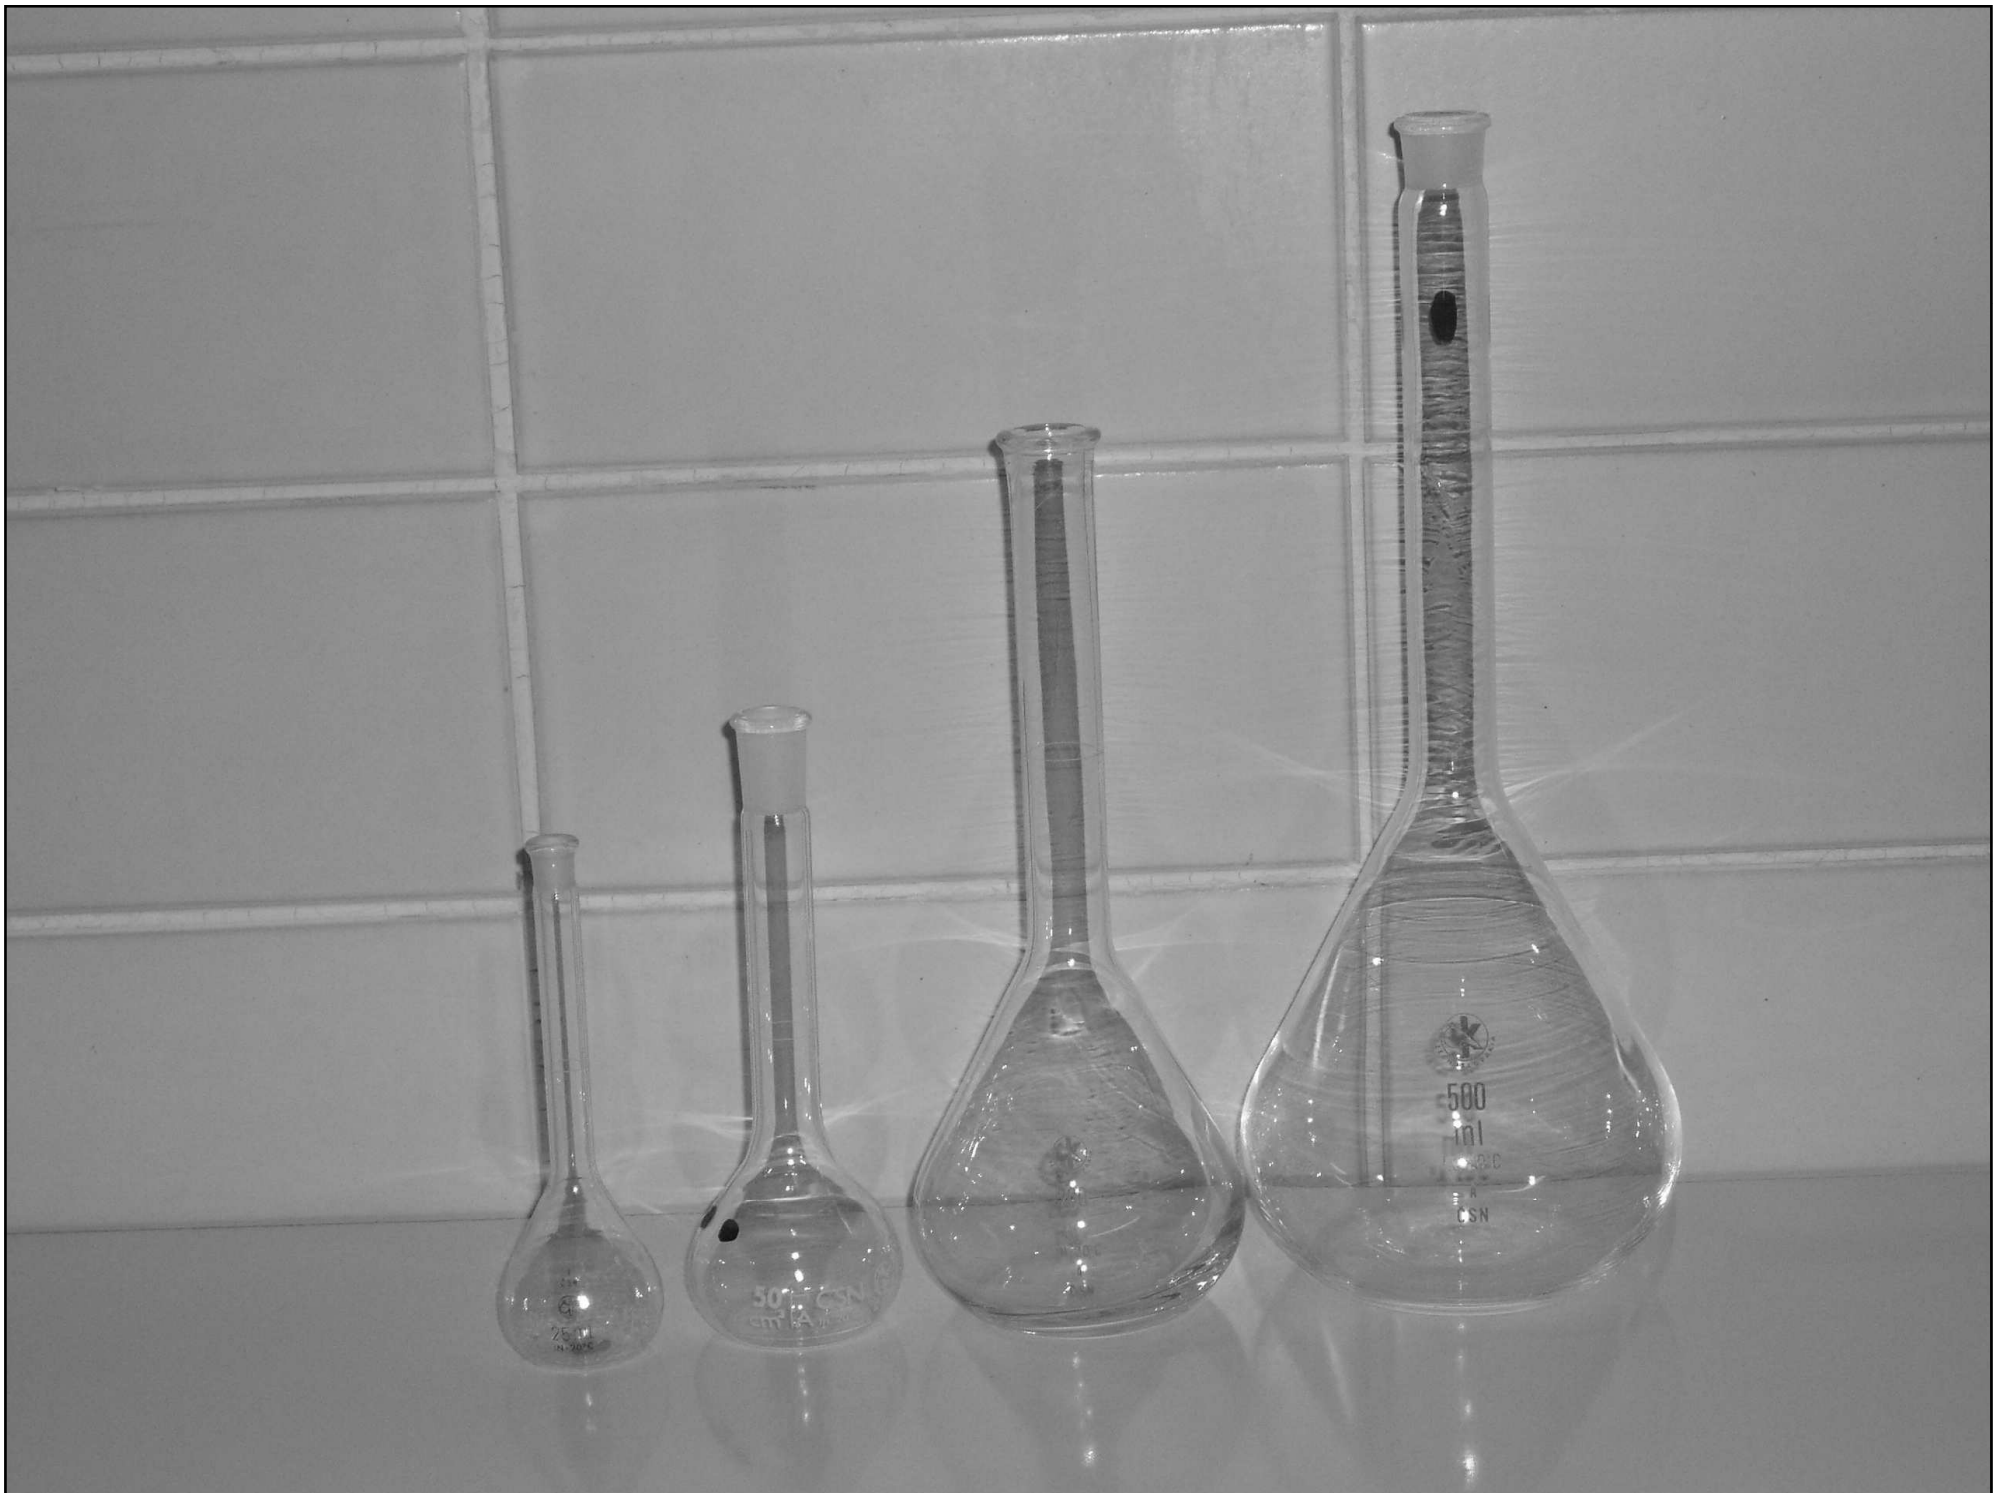



















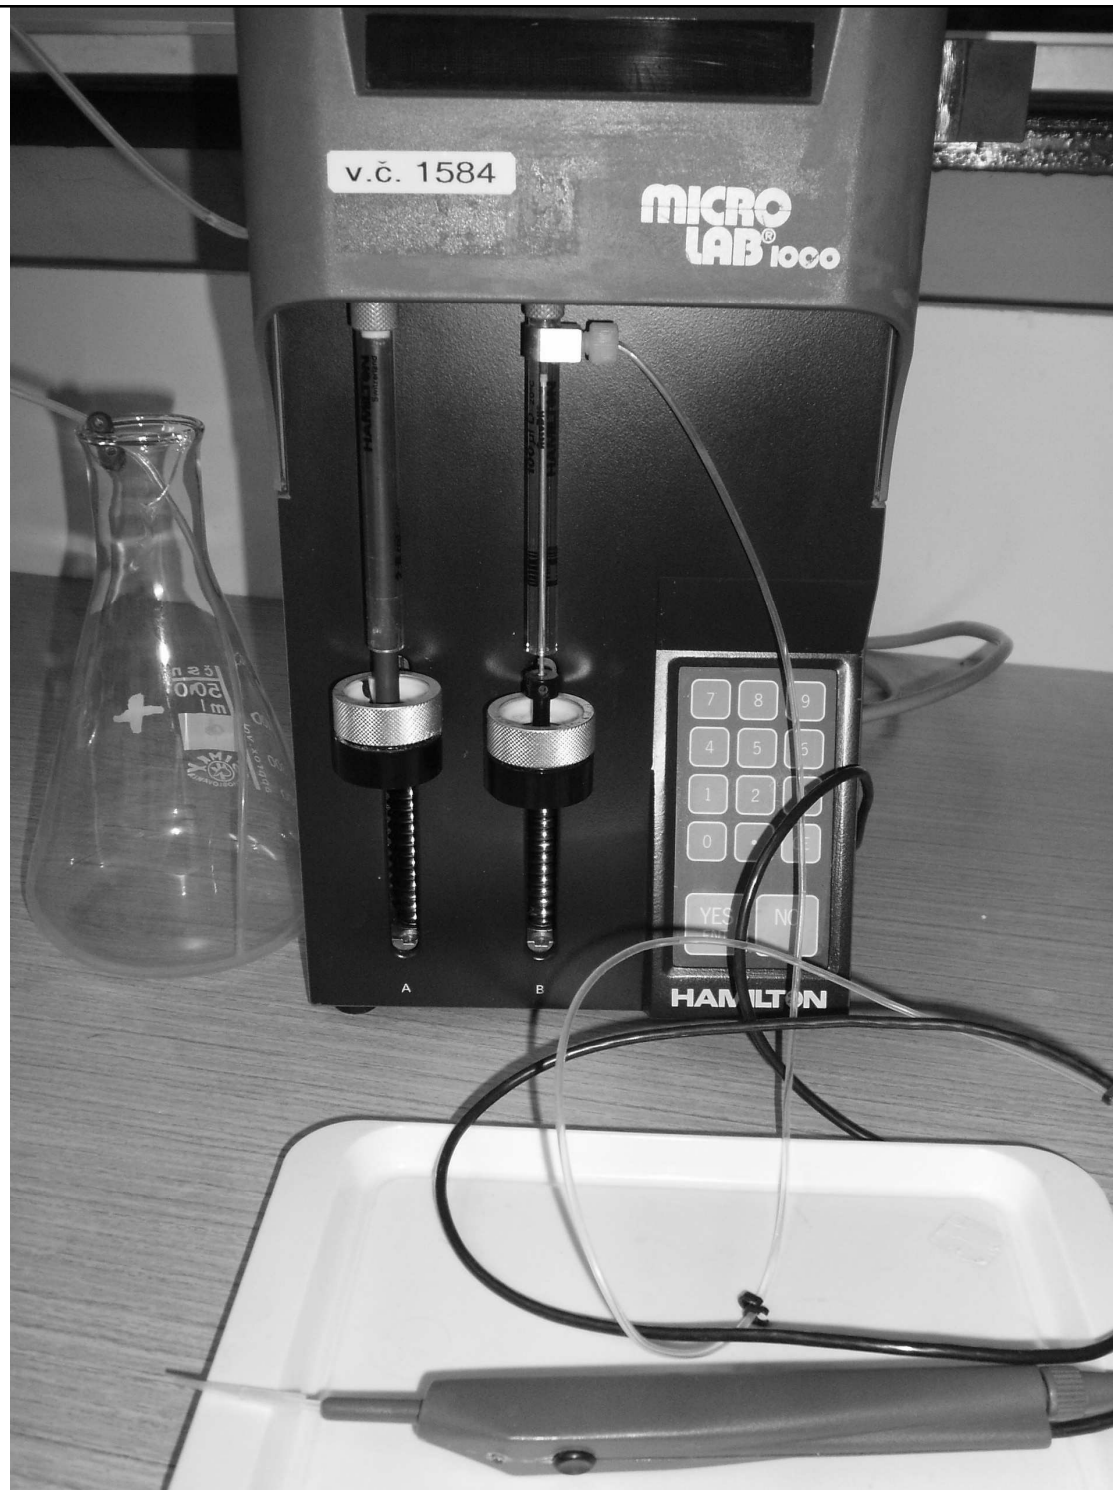

# Funkce automatického programovatelného dilutoru

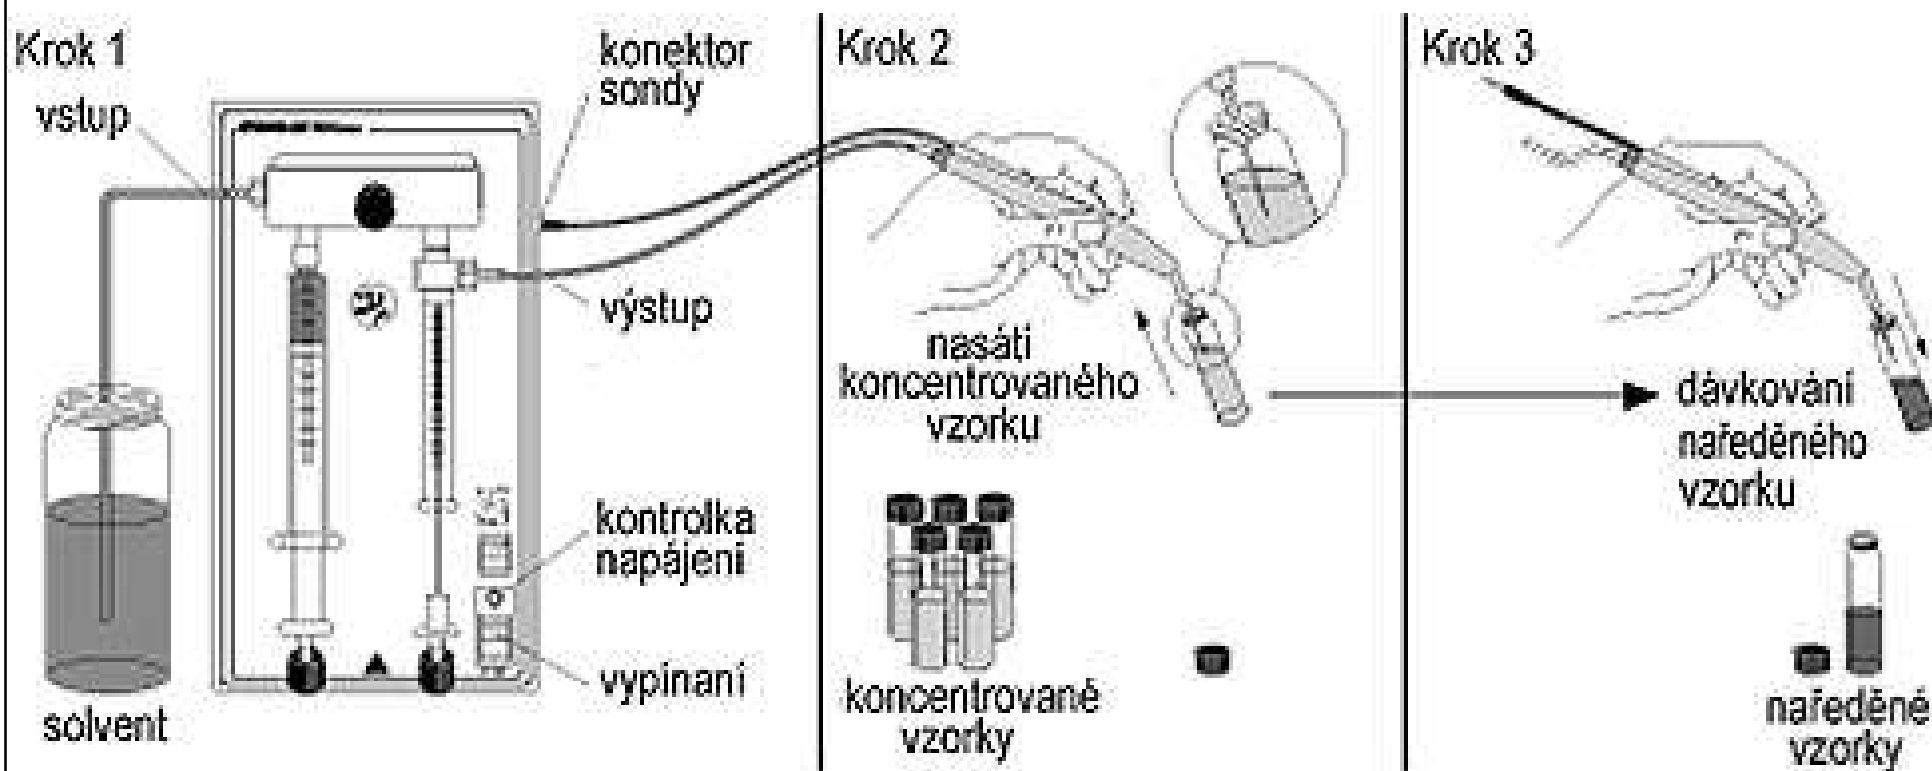

**Krok 1:** Levá stříkačka se naplní naprogramovaným množstvím rozpouštědla (ředidla) ze zásobníku.

**Krok 2:** Pomocí pravé stříkačky se nasaje do koncové části ruční sondy naprogramované množství koncentrovaného vzorku.

**Krok 3:** Do viálky se nadávkuje patřičné množství vzorku i rozpouštědla.

**Jednoduché ředění**



**Sériové ředění automat.**



**Sériové ředění manuál.**



**Ředění + přidání  
Vnitřního standardu**





0.00 g


v.c. M46561

**METTLER PM2000**

On/Off  
Re-Zero  
Menu





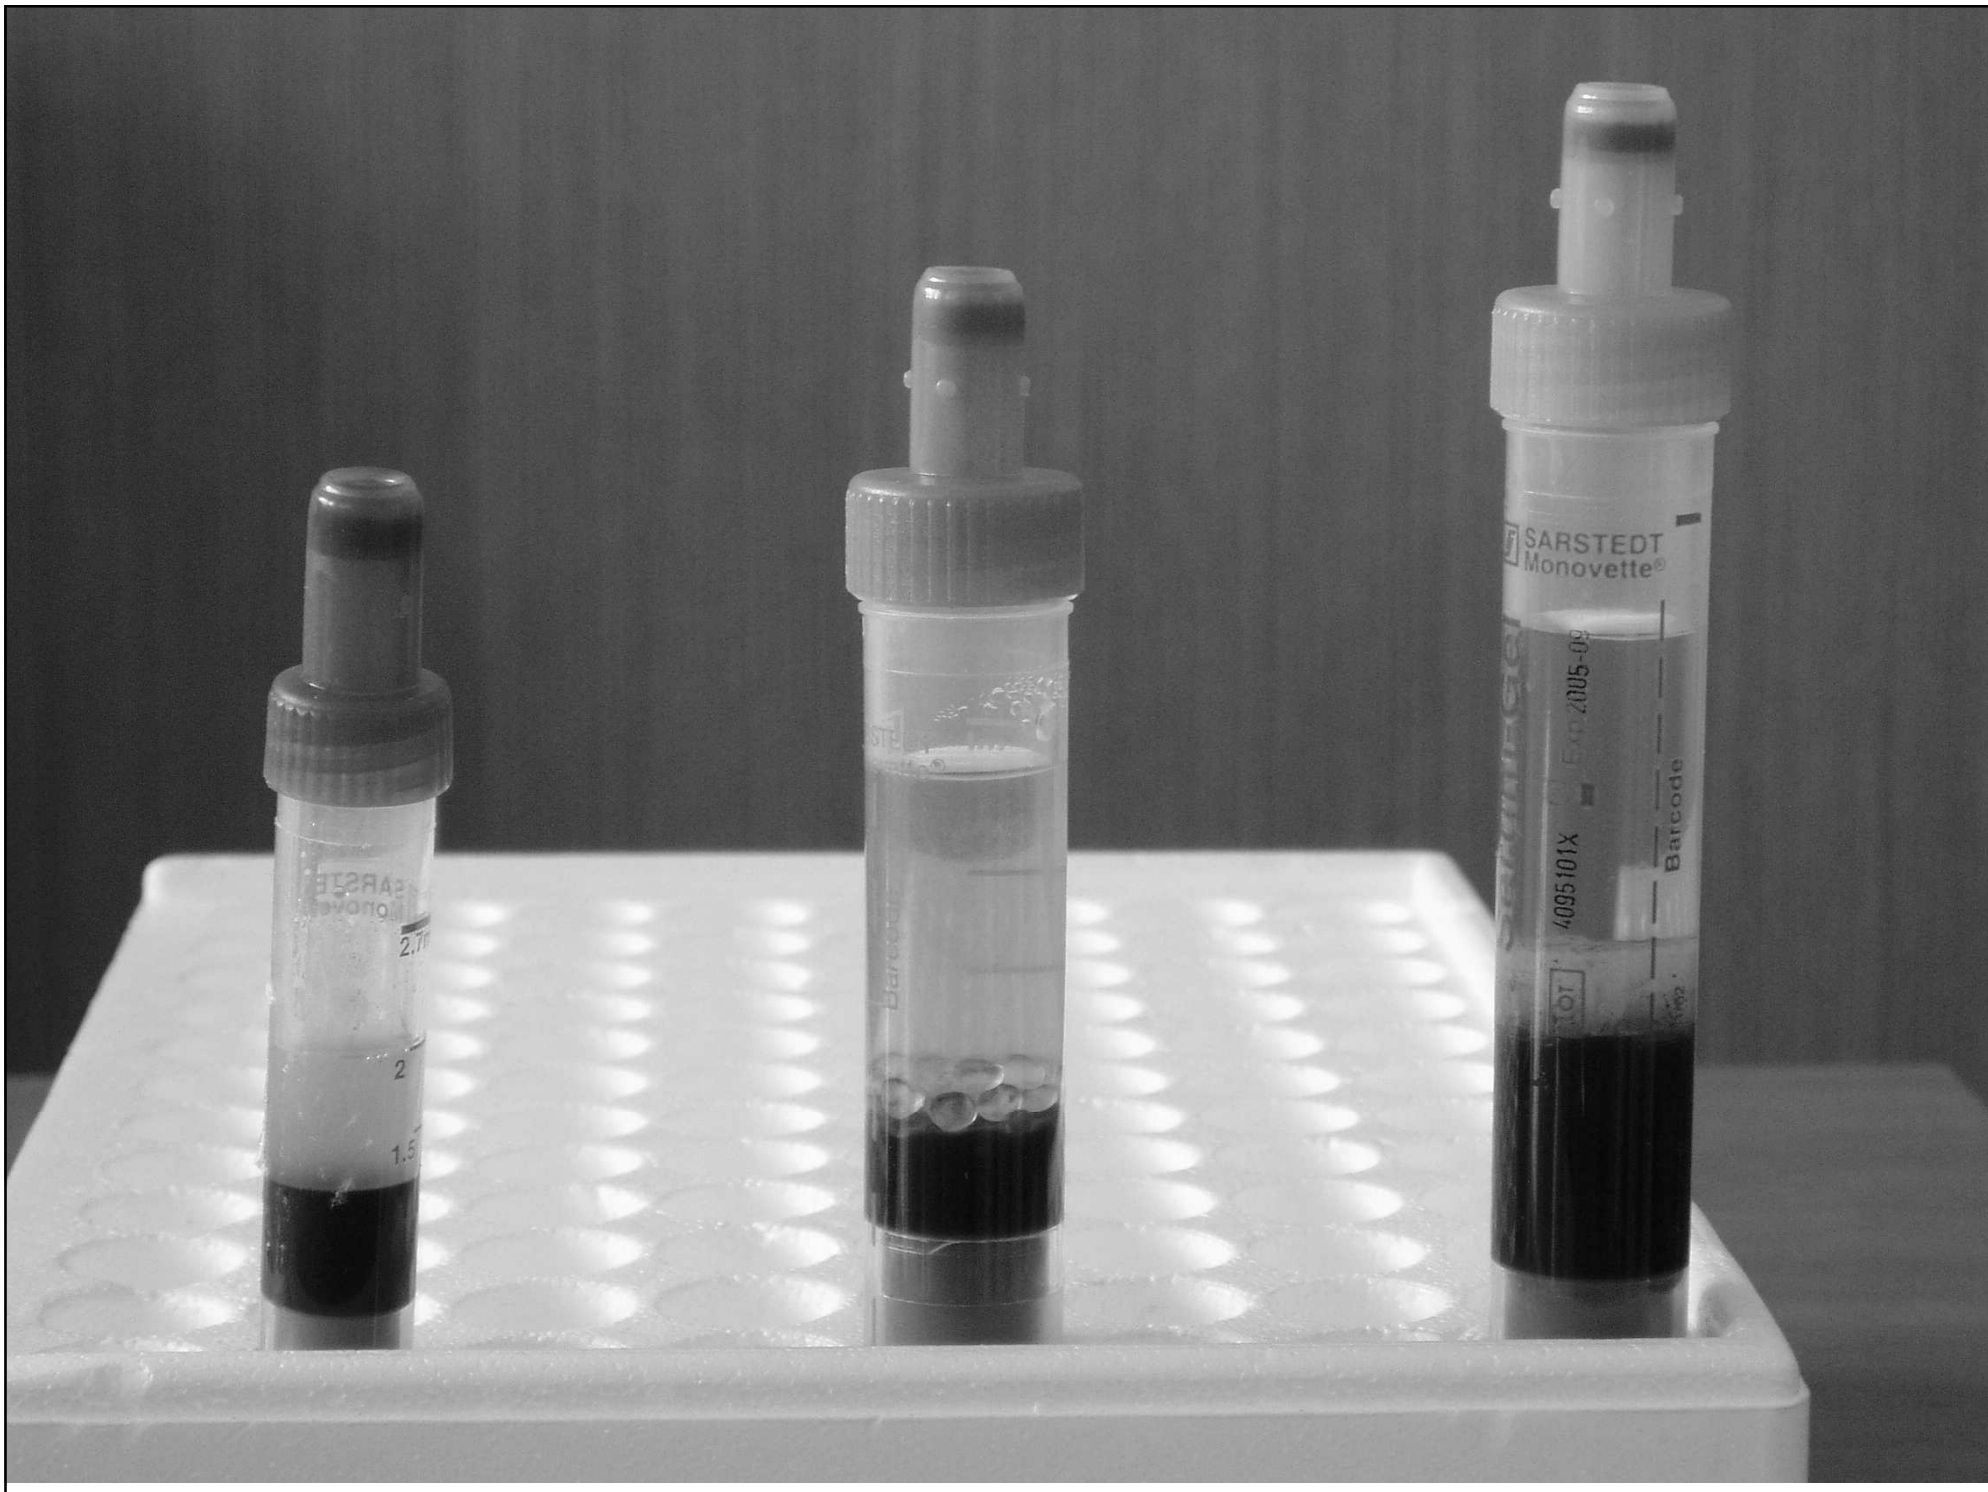

SARSTEDT  
Monovette®  
2.7 ml  
2  
1.5

SARSTEDT  
Monovette®  
Barcode

SARSTEDT  
Monovette®  
4095101X Exp. 2005-09  
Barcode  
TOT  
Type














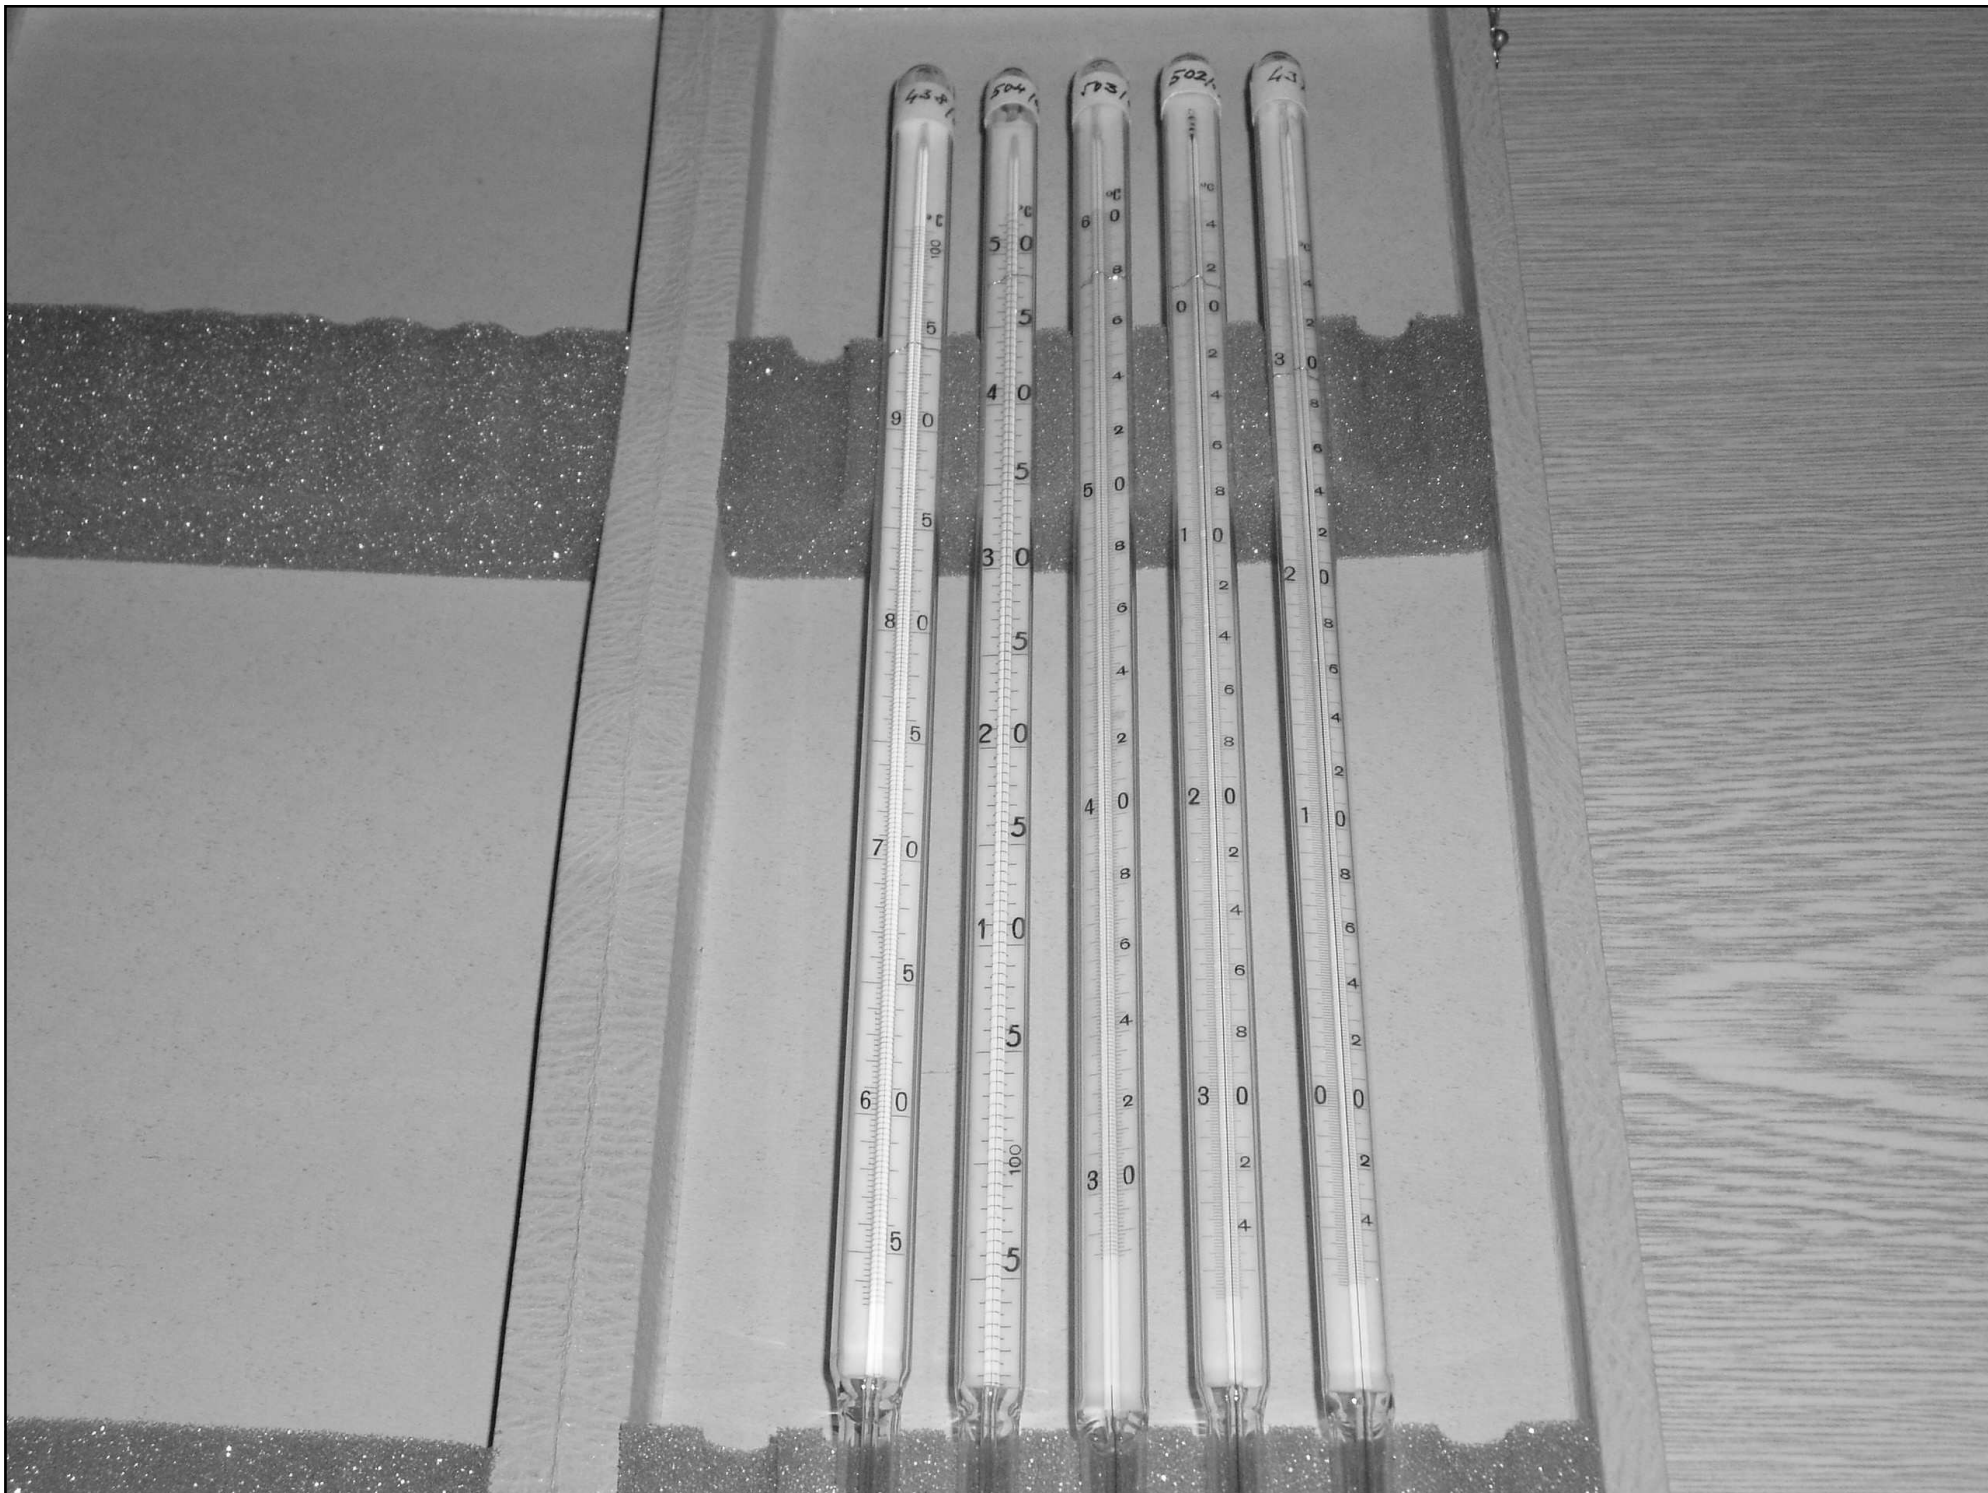



COMPAQ

Falcon  
System Task Nastavení Návod Servis  
OKBH-Bohunice - 16.02.2006 17:04 16:50  
Kontrola systému Test

OKBH-Bohunice		R1 chemik, pouz(L) 1		R2 chem. zásob (L) 2		R3 statim (L) 3		R4 5		R5 6		R11 pult kontroly 4	
		3,8 °C	3,3 °C	4,6 °C	3,6 °C	3,9 °C	4,1 °C	6,7 °C	6,2 °C	5,7 °C	4,6 °C	-26,1 °C	
Lab. Modulár 10		IM1 sety (L) 21		IM22 sety RIA (L) 22		IM3 séra (L) 23		IM11 pult (M) 24		IM4-IMMULITE 25			
		25,3 °C	5,2 °C	4,1 °C	4,3 °C	4,4 °C	3,9 °C	-20,6 °C	6,4 °C	6,4 °C			
			4,7 °C										
IM13 26		Lab. AxSYM aRIA (P) 31		P1 Elisa (L) 41		P2 BM (L) 42		P3 Likvory (L) 43		P12 pult kontroly (M) 44			
		-21,9 °C	26,1 °C	5,9 °C	7,3 °C	6,2 °C	6,0 °C	6,5 °C	5,1 °C	-21,4 °C			
S1 sklad 61		S2 AxSYM spec (L) 62		S3 AAS (L) 63		S11 pult AxSYM (M) 64		P5 45		chladiaci box 80			
		8,4 °C	4,4 °C	4,4 °C	4,4 °C	-23,7 °C	5,7 °C	5,7 °C	4,3 °C				
		8,5 °C	4,1 °C	4,0 °C	4,0 °C		3,9 °C	3,9 °C	3,8 °C				

Definice načtena za: 219 [ms] data načtena za: 15 [ms], zobrazena za: 110 [ms]

Start Falcon cs ITL C:\BIN\POLAB\BIPOTE...



R1 chemik, použ.(L) 1	R2 chem. zásob (L) 2	R3 statim (L) 3	R4 statim (L) 4	R5 statim (L) 5
3,9 °C	4,6 °C	3,9 °C	6,7 °C	
3,4 °C	3,6 °C	4,2 °C	6,1 °C	
Lab. Modulář 10	IM1 sety (L) 21	IM22 sety RIA (L) 22	IM3 séra (L) 23	IM4 séra (L) 24
25,3 °C	5,2 °C	4,2 °C	4,4 °C	
	4,7 °C	4,3 °C	3,9 °C	
IM13 26	Lab. AxSYM aRIA (P) 31	P1 Elisa (L) 41	P2 BM (L) 42	P3 BM (L) 43
-21,9 °C	26,1 °C	5,9 °C	6,1 °C	
		7,3 °C	6,0 °C	
S1 sklad				

display  
digit. teploměru

větrák pro  
nucenou  
cirkulaci vzduchu

