


M U N I
M E D

Nepřímá kalorimetrie.

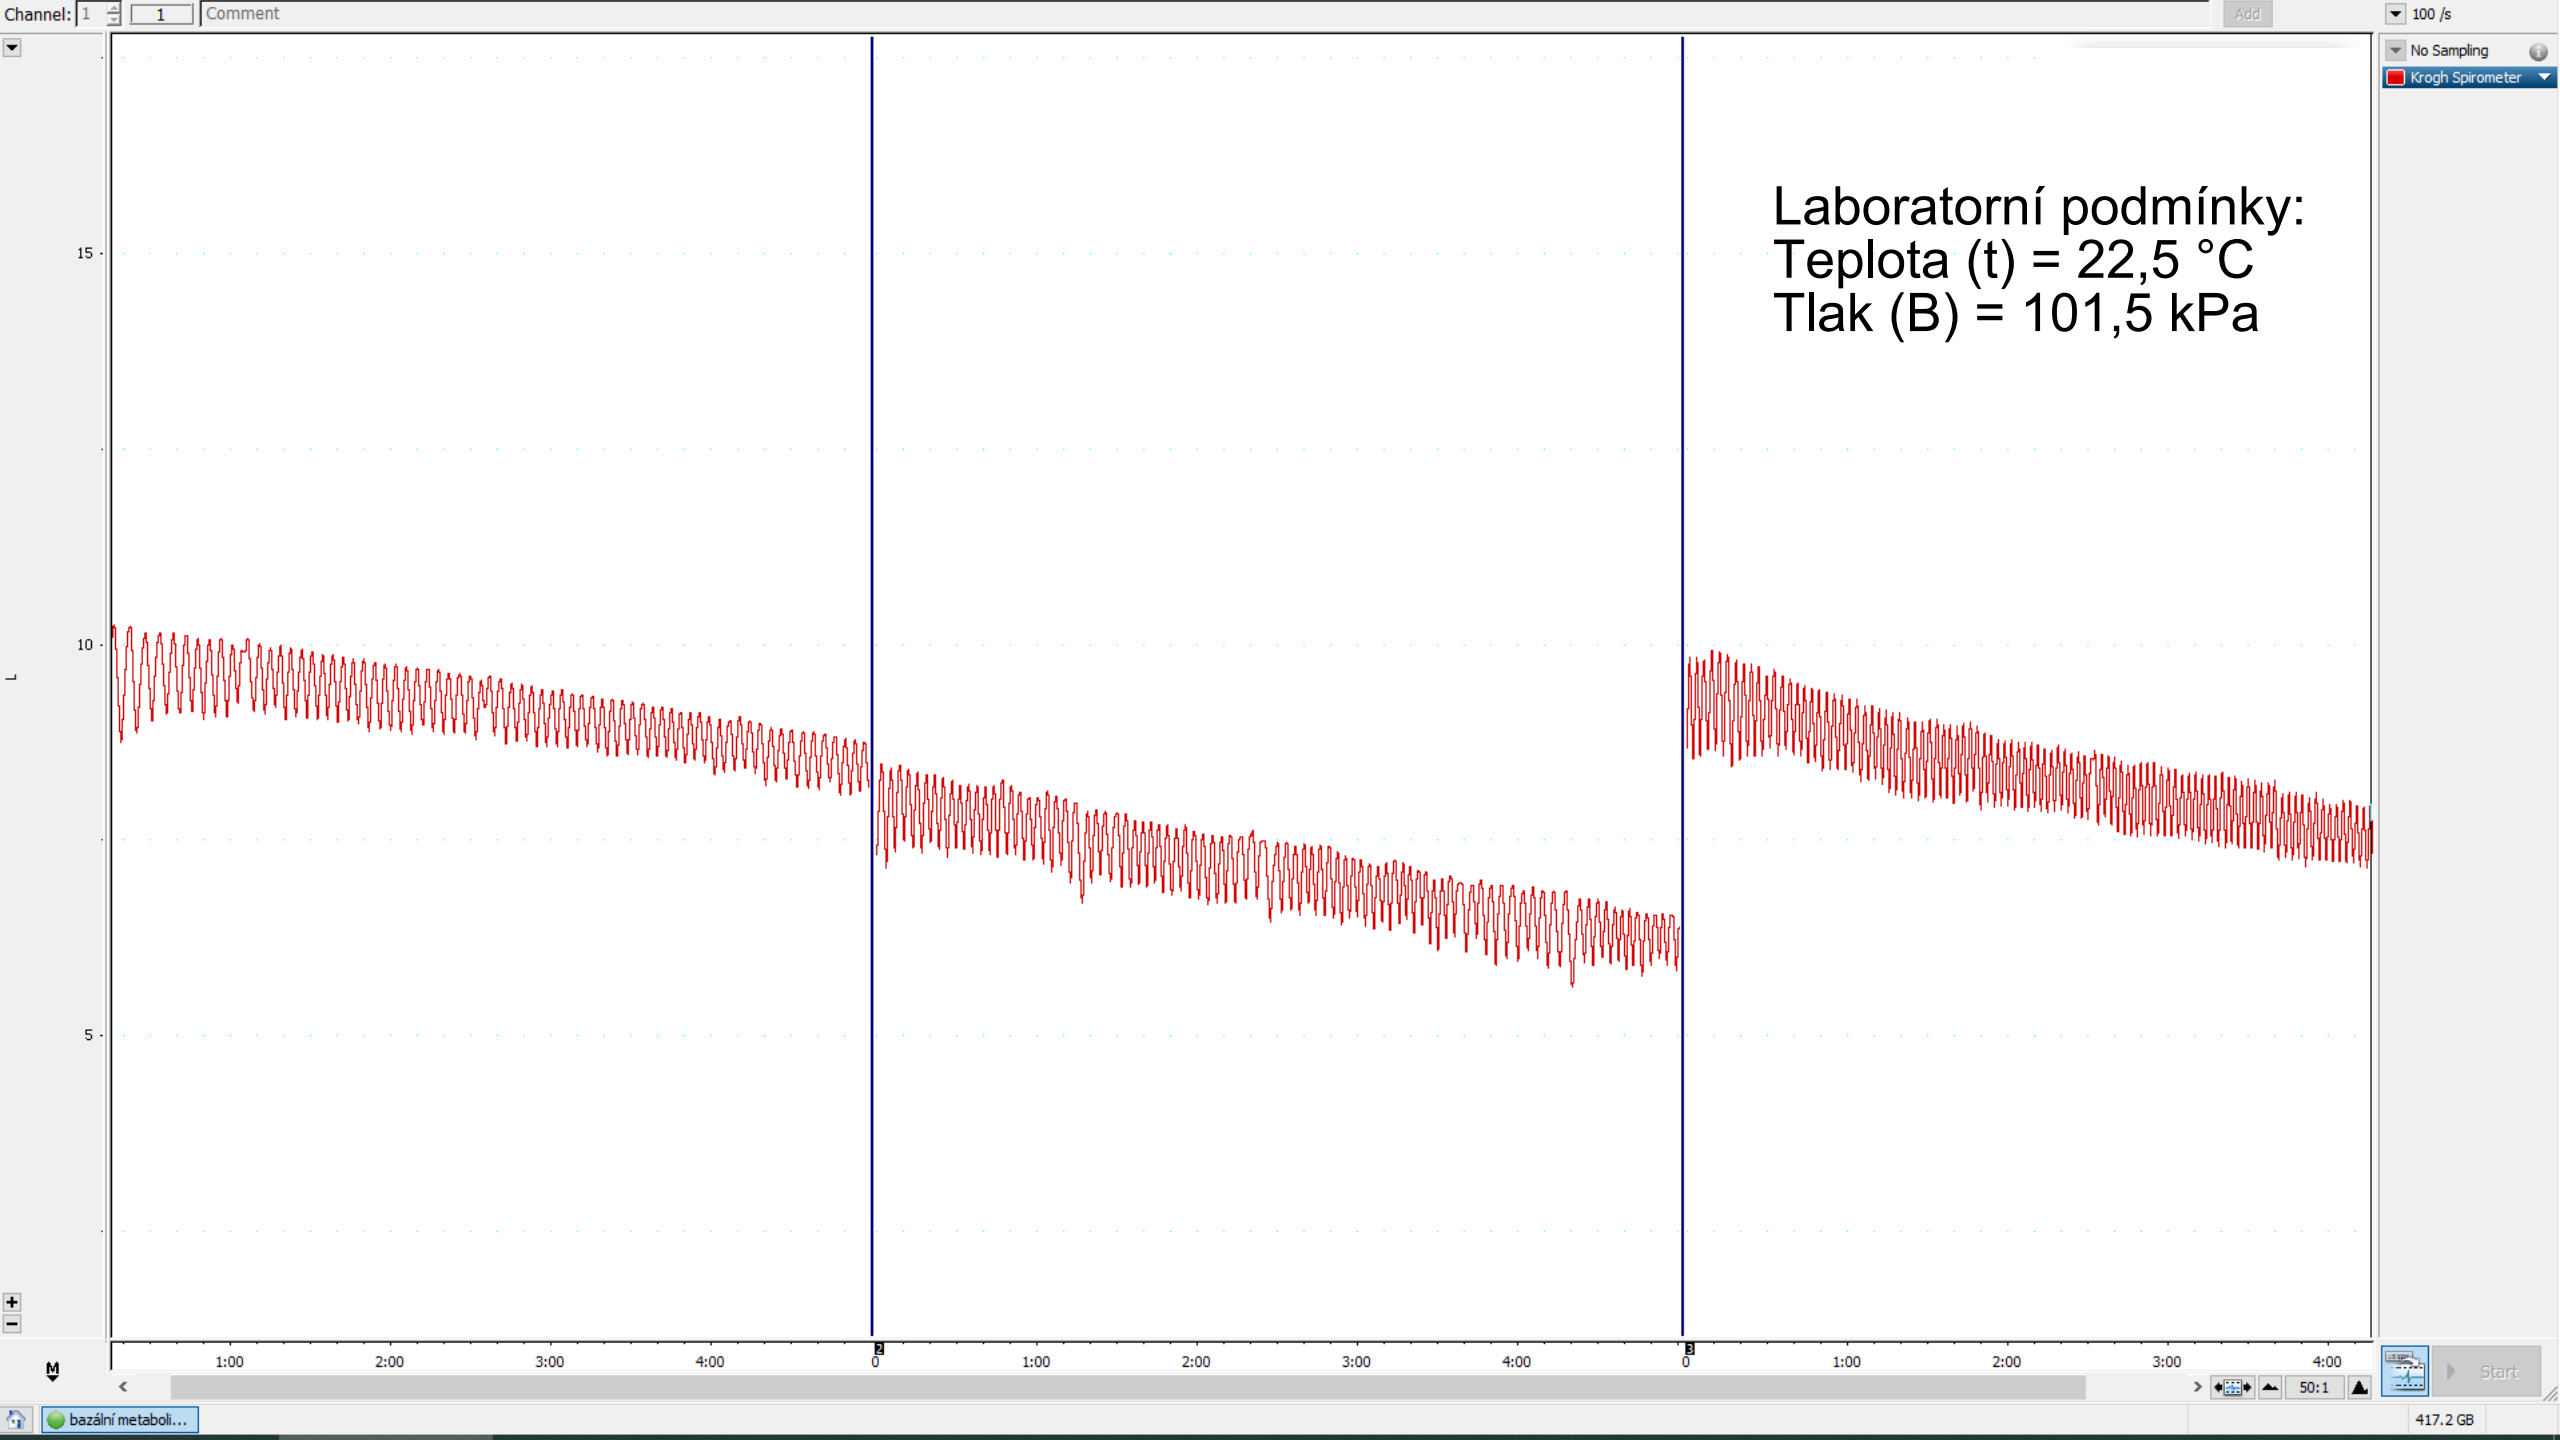

Měření v leže

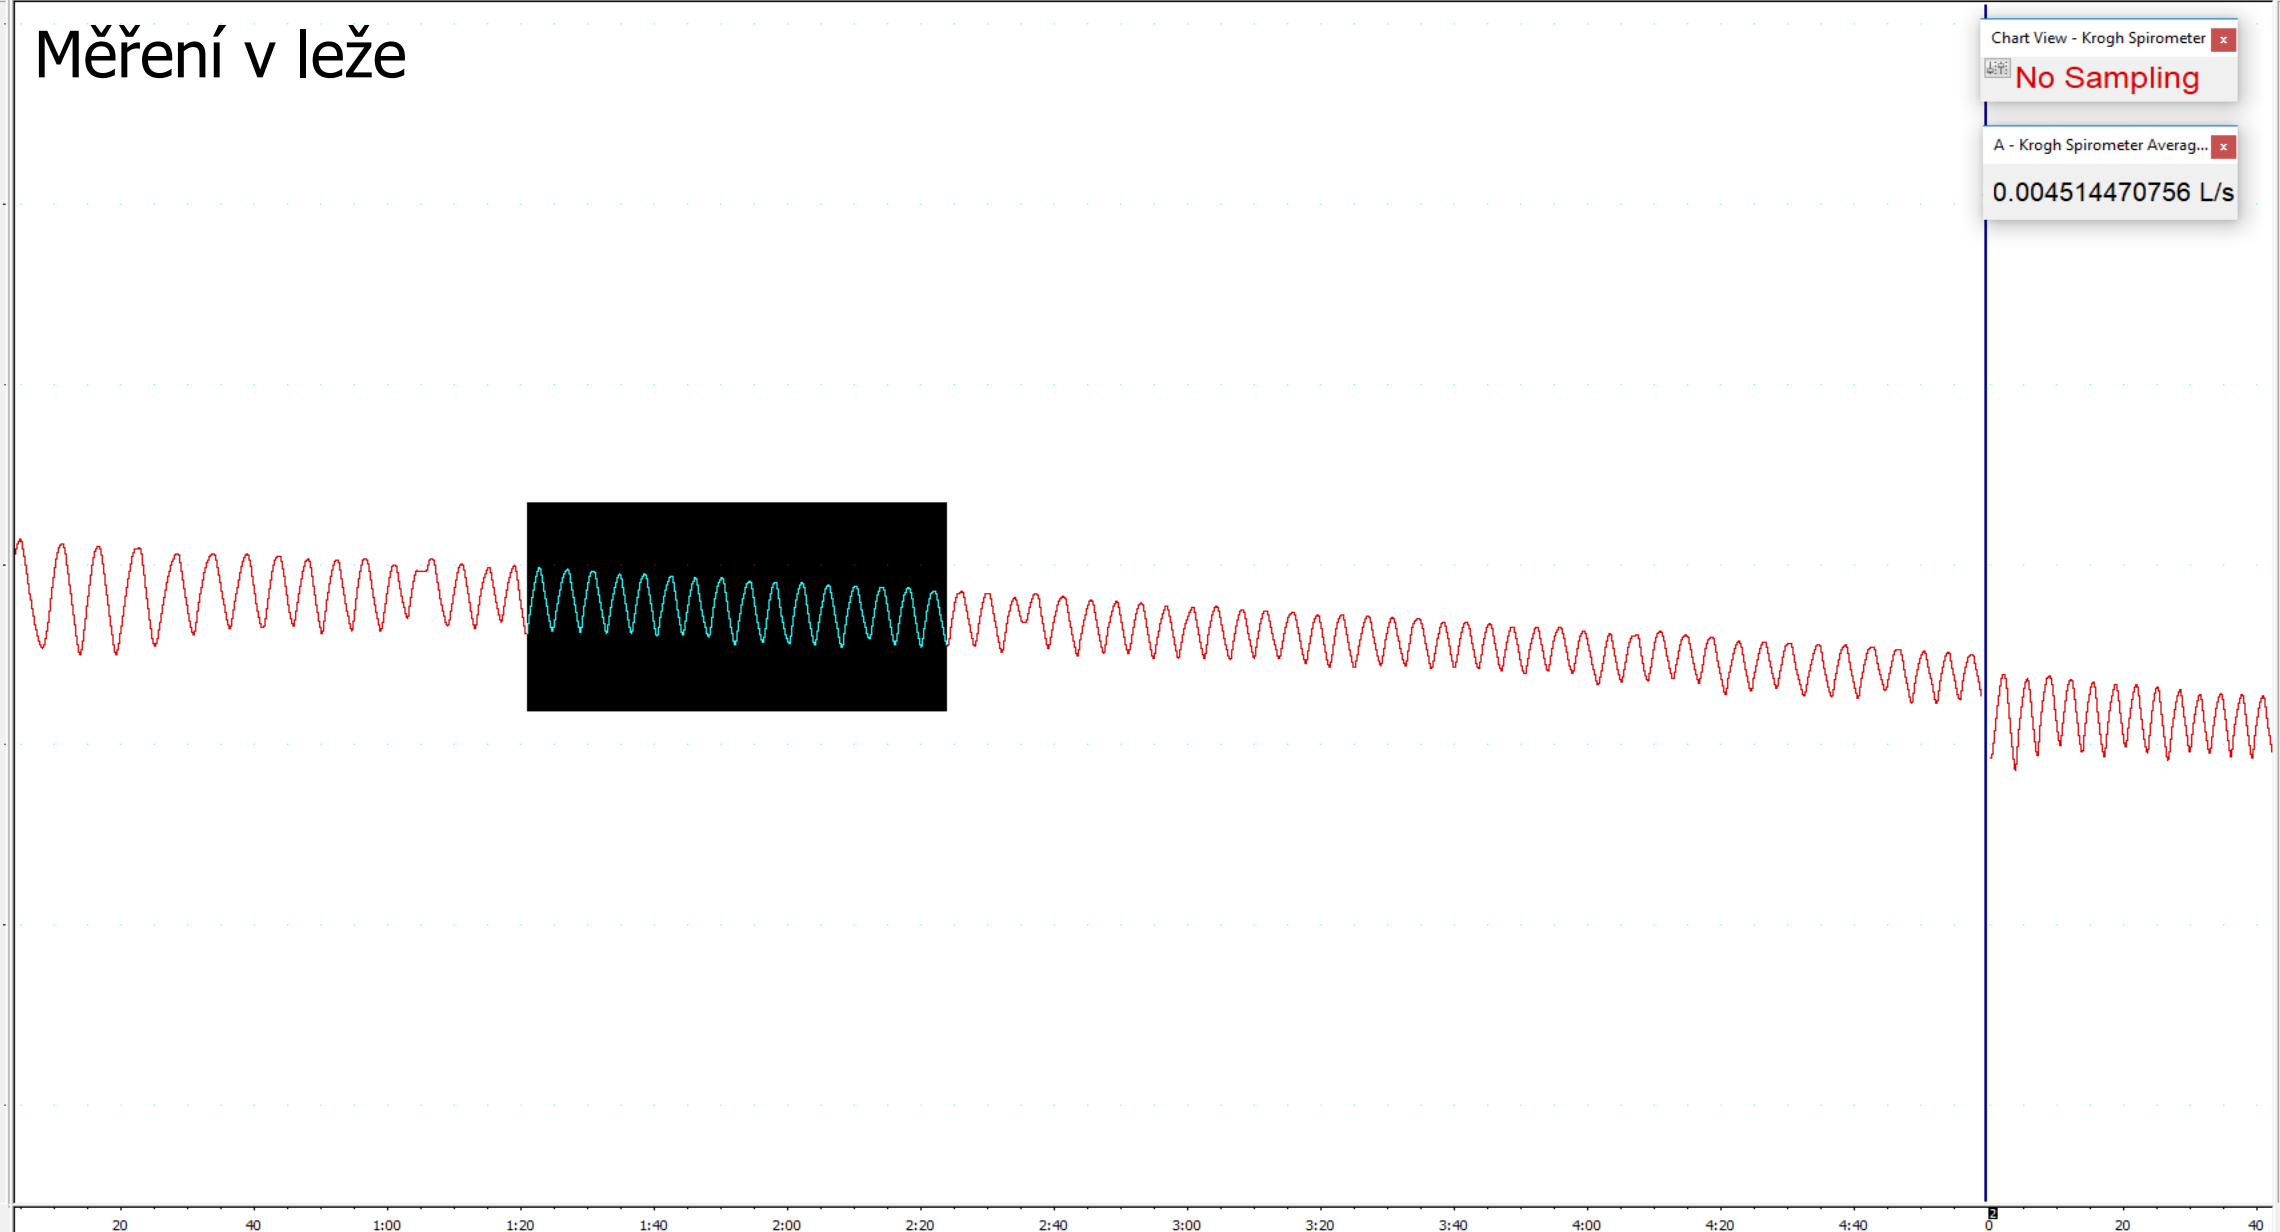


Chart View - Krogh Spirometer x

No Sampling

A - Krogh Spirometer Averag... x

0.004514470756 L/s

Měření ve stoje

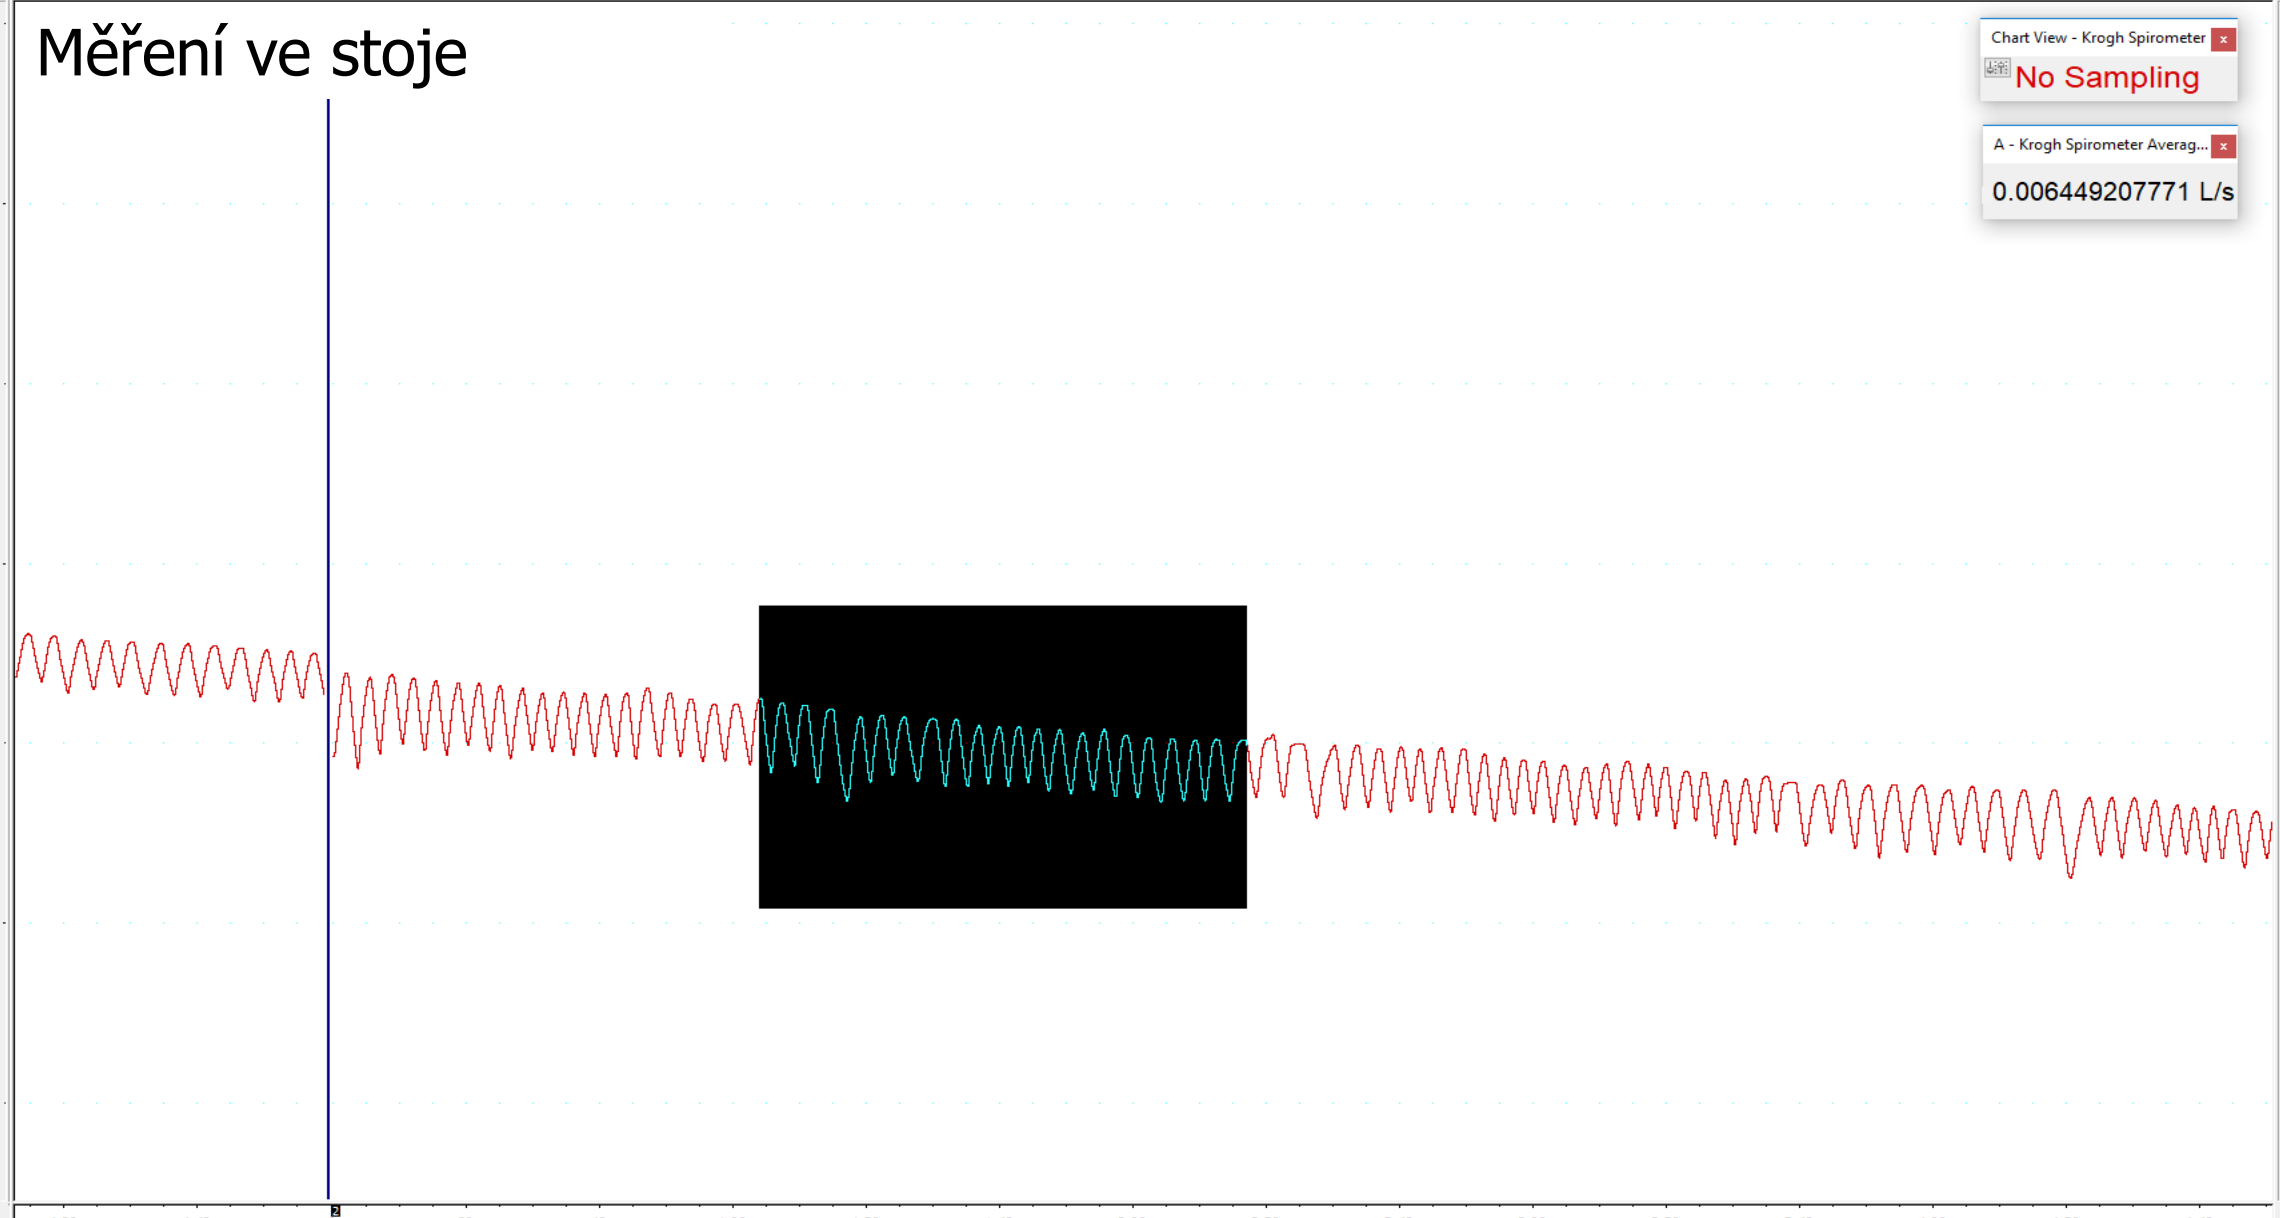


Chart View - Krogh Spirometer
No Sampling

A - Krogh Spirometer Averag...
0.006449207771 L/s

No Sampling
Krogh Spirometer

Měření po zátěži

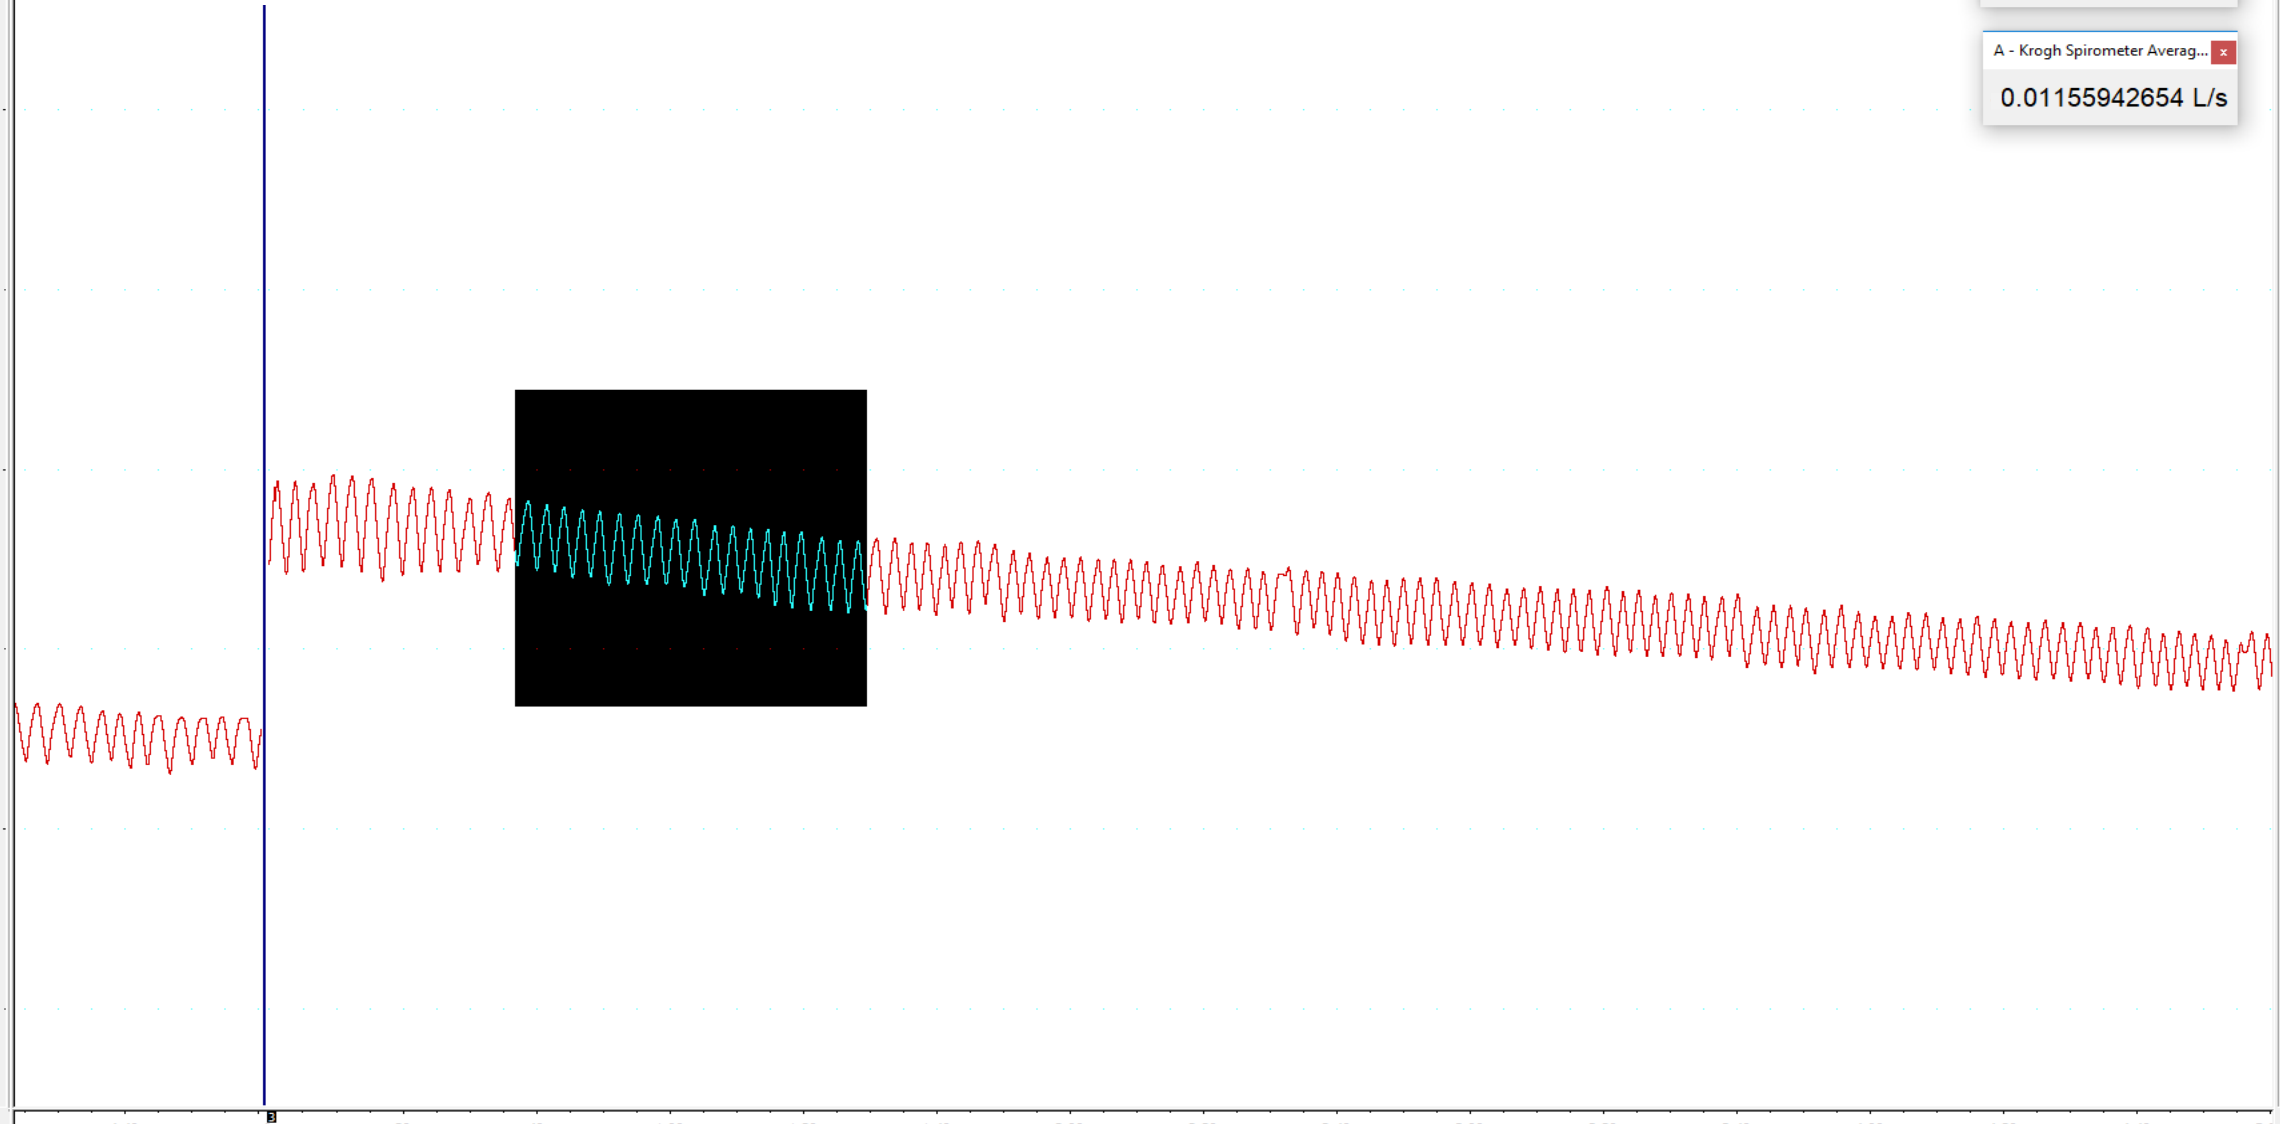


Chart View - Krogh Spirometer
No Sampling

A - Krogh Spirometer Averag...
0.01155942654 L/s

No Sampling
Krogh Spirometer