


Termoanalytické měření TG/DSC pro vzorek $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

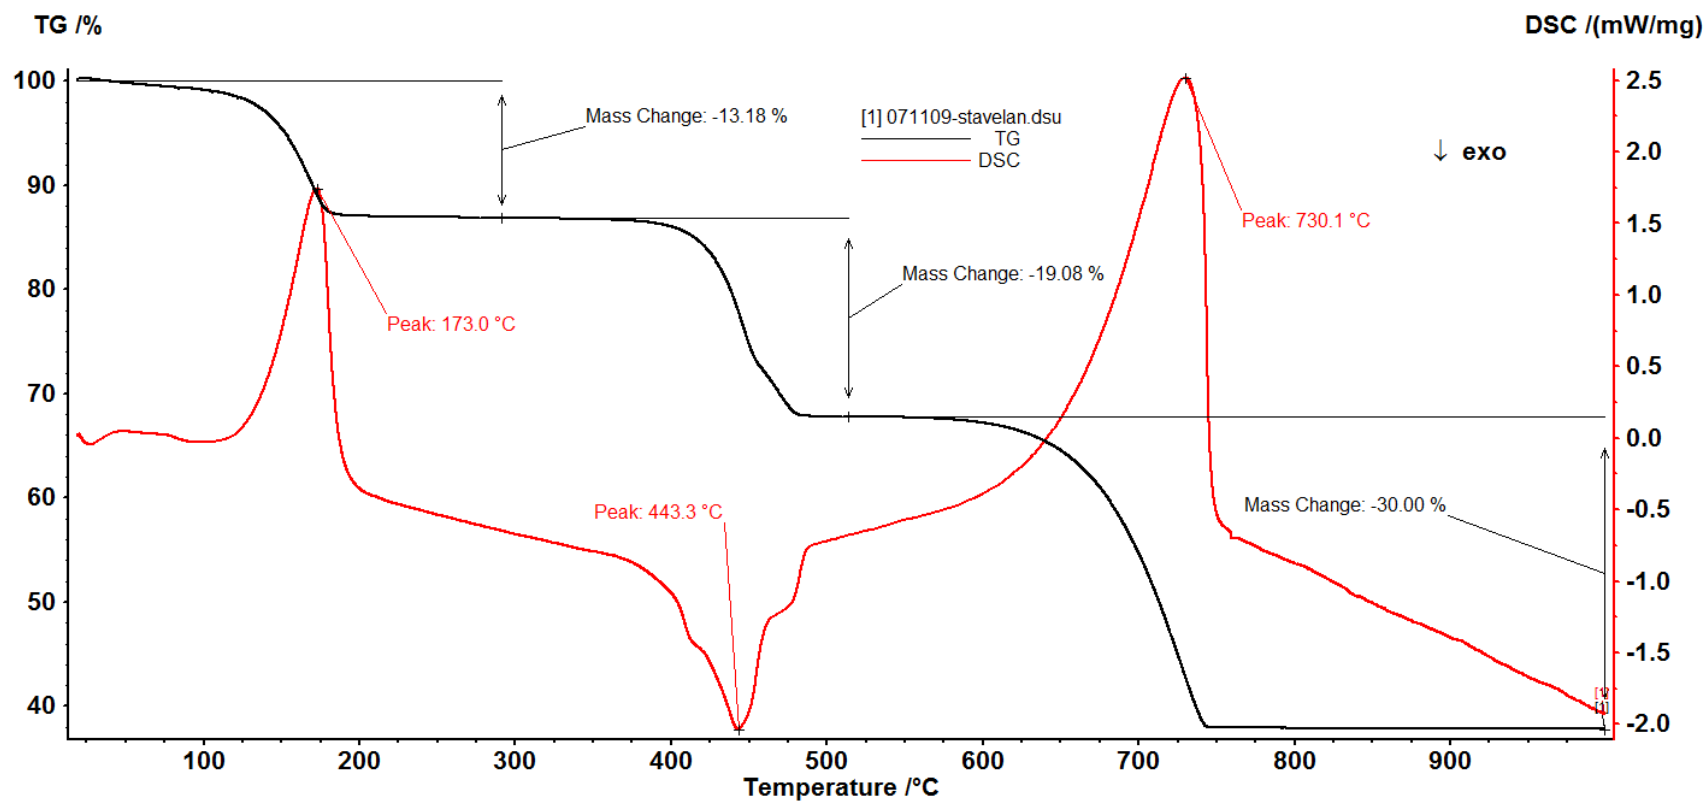

Použité parametry: navážka do 20 mg, rychlost ohřevu 5 K min^{-1} maximální teplota $1000 \text{ }^{\circ}\text{C}$, atmosféra N_2 , průtok $70 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$