


Přednáška č. 2

Mikroskopické techniky

„The role of the infinitely small in nature is infinitely large“
Louis Pasteur



Janssenovi Z 9 x,
~ 1595



Replika mikroskopu
Antony van Leeuwenhoek
Z 50 - 275 x
17.století



"Objekt, který má
reálně 1 milimetr,
by měl při zvětšení
tímto mikroskopem
700 metrů,"

Ústav molekulární genetiky AV ČR
v současnosti nejdokonalejší biologický prozařovací
elektronový mikroskop, prodaný v ČR - Tecnai T20

Buňka

minimální jednotka strukturní, funkční a reprodukční

- **Vývoj buněčné teorie**

rozvoj mikroskopie (17. století až současnost)

Jan Evangelista Purkyně (1787 -1869) mezi prvními na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život



J.E.Purkyně

Matthias.J. Schleiden (1804-81) a Theodor Schwann (1810-82)

1839 buněčná teorie: Vývoj živé přírody se opírá o růst a tvoření buněk, buňky rostlin a živočichů se shodují tvarem a funkcí. Buňka je základní, stavební a funkční jednotkou živých organismů.



Rudolf Virchow (1821-1902)

„nové buňky vznikají jen dělením z již existujících“

L. Pasteur (1822-85)

fermentace, popřel teorii spontán. tvoření buněk

rozvoj biochemie 1.pol.20.stol 1953 struktura DNA (Watson, Crick, Franklinová)




R.Virchow



Louis Pasteur

Prokaryotická buňka



- živý, otevřený systém schopný regulace a autoreprodukce
- jádro neodděleno od CPL membránou, větš. kruhová (i lineární) DNA
- haploidní buňky (1 alela) množící se nepohlavně
- bez buněčných organel, jediná membrána je cytoplasmatická
- ribosomy se liší od ribosomů eukaryotních buněk – menší, volně v CPL

vyjma Archea:

5S, 16S a 23S rRNA

translace začíná N-formylmethioninem

geny pro RNA bez intronů

- specifické struktury a vlastnosti bakt. buňky:


peptidoglykan (až na mykoplasmata)

steroly v membránách zcela výjimečně


bičík – globulární bílkovina flagelin, pohyb rotací

anaerobiosa, schopnost vázat N, tvorba kyseliny PHB (zásob.l.)


pokud fotosyntéza - anoxigenní




bakteriální ribozom




E. coli



S. aureus



G-





G+

Velikost a tvary bakteriální buňky

velký poměr povrchu k objemu - velká plocha kontaktu buňky s prostředím

• Velikost bakt b. v μm

| | | |
|---------------------|-------------------|--|
| <i>Chlamydia</i> | 0,3 x 0,3 |  |
| <i>Bdellovibrio</i> | 0,8 x 0,3 | |
| <i>Rickettsia</i> | 1 x 0,3 | |
| <i>S. aureus</i> | 0,8-1 x 0,8-1 | |
| <i>E. coli</i> | 2-3 x 0,4-0,6 | |
| <i>B. subtilis</i> | 1,8-4,8 x 0,9-1,1 | |
| <i>Streptomyces</i> | vlákno x 0,7-1,6 | |
| <i>Chromatium</i> | 25 x 10 | |
| Spirochety | 500 |  |

• Tvary bakt. buňky

Koky - sférické, oploštělé, lancetovité

- diplokoky, streptokoky, tetrády, sarciny, stafylokoky

Tyčinky - rovné, zakřivené, větvcí se, palisády pleomorfní

Kokobacily


Pupeny

Prostéky

Spirily

Hvězdice

Mycelia



750 μm - největší známá prokaryotní buňka, objevená r.1999: *Thiomargarita namibiensis*
Nejmenší (např. někteří příslušníci rodu *Mycoplasma*) měří průměrně 100 až 200 nm

Bacterial Morphology



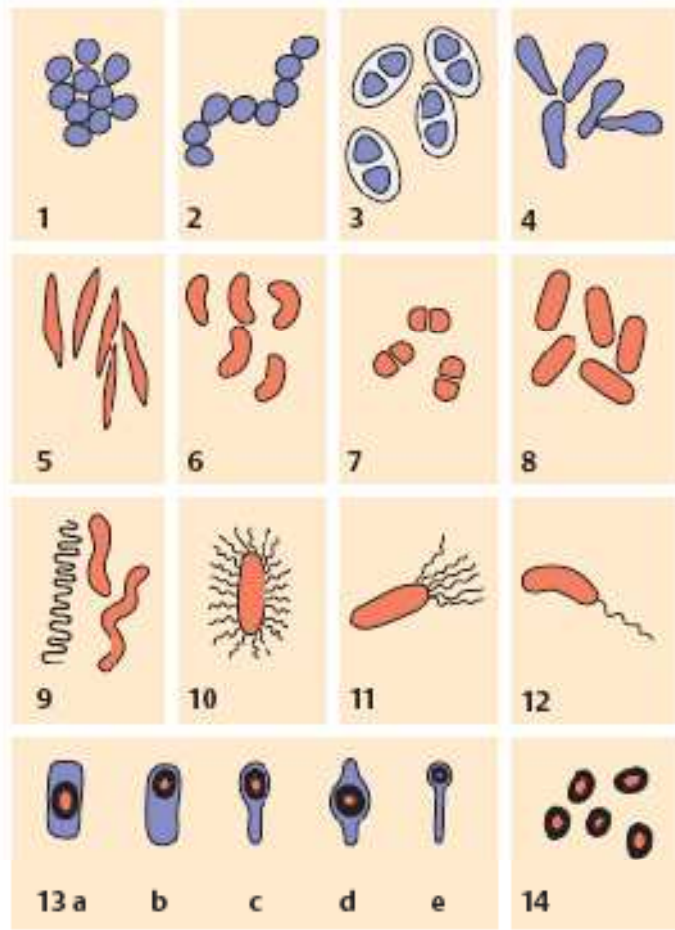


Fig. 3.1




1. Gram-positive cocci in grapelike clusters (staphylococci)
2. Gram-positive cocci in chains (streptococci)
3. Gram-positive cocci with capsules (pneumococci)
4. Gram-positive, clubshaped, pleomorphic rods (corynebacteria)
5. Gram-negative rods with pointed ends (fusobacteria)
6. Gram-negative curved rods (here comma-shaped vibrios)
7. Gram-negative diplococci, adjacent sides flattened (neisseria)
8. Gram-negative straight rods with rounded ends (coli bacteria)
9. Spiral rods (spirilla) and Gram-negative curved rods (*Helicobacter*)
10. Peritrichous flagellation
11. Lophotrichous flagellation
12. Monotrichous flagellation
13. Formation of endospores (sporulation) in cells of the genera *Bacillus* and *Clostridium* (spore stain)
 - a) Central spore, vegetative cell shows no swelling
 - b) Terminal spore, vegetative cell shows no swelling
 - c) Terminal spore ("tennis racket")
 - d) Central spore, vegetative cell shows swelling
 - e) Terminal spore ("drumstick")
14. Free spores (spore stain)

Magnification and Orientation II




Why doesn't a simple magnifying lens produce an inverted mirror image?

With the object closer to the lens than the focal point, the light rays diverge, giving the viewer the illusion that he/she is seeing a larger object, farther away, in the same orientation.



BioEd Online

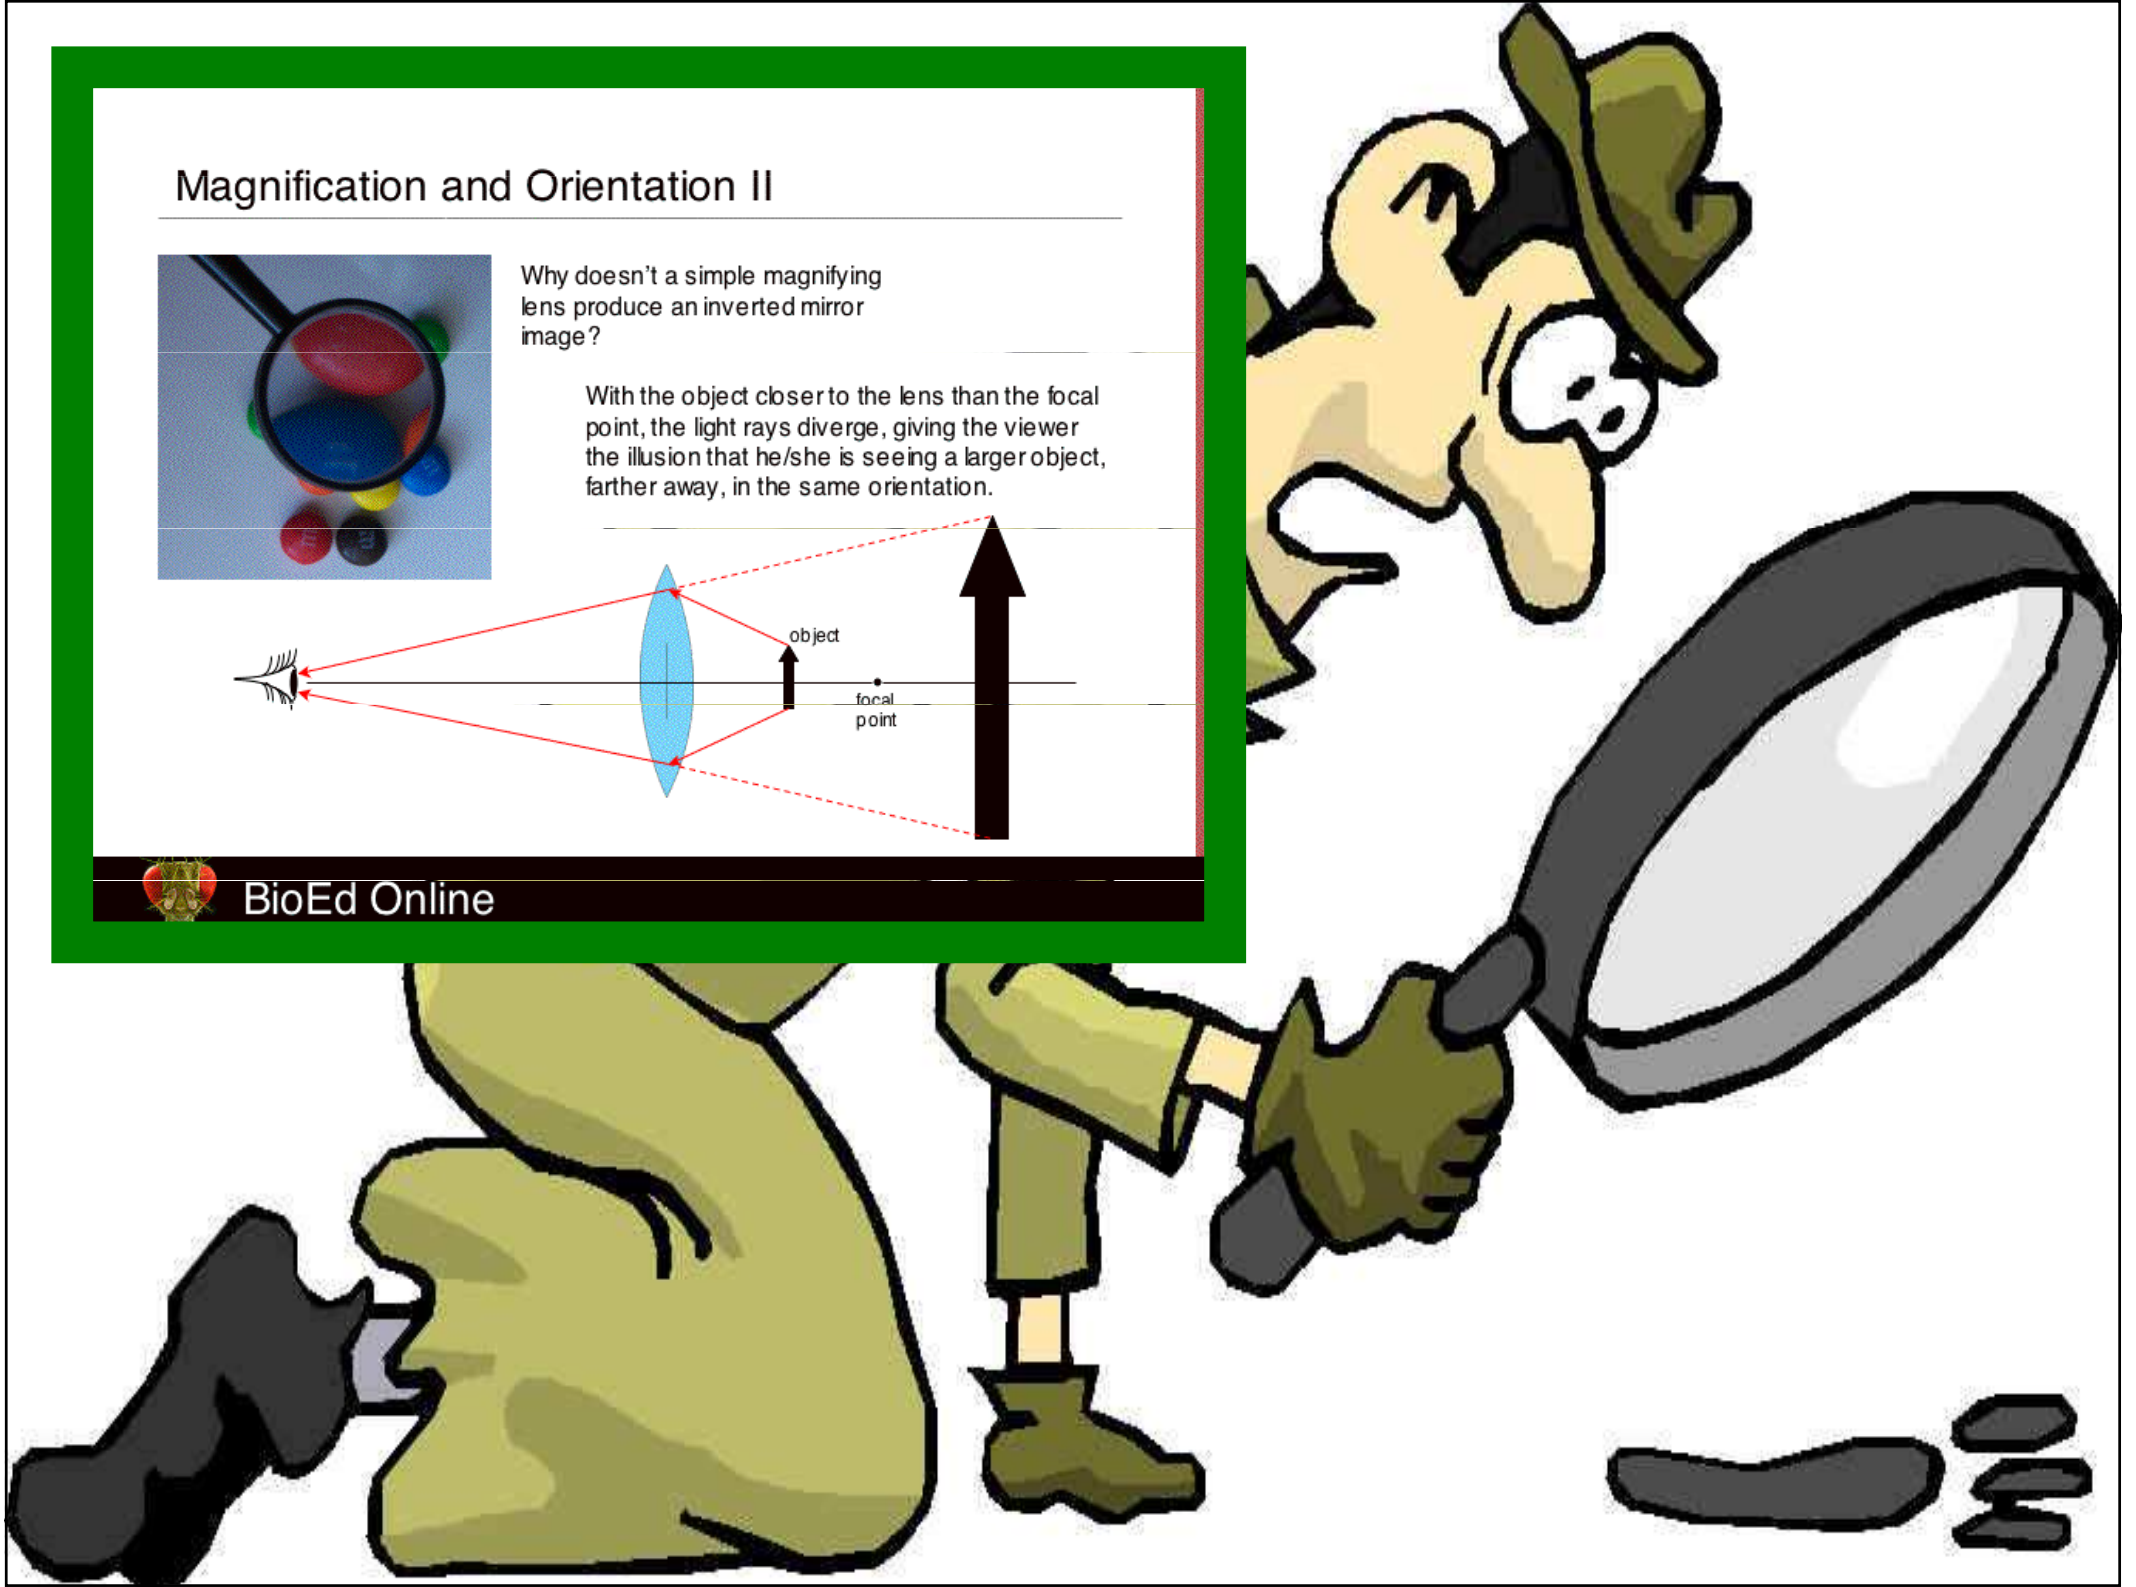

Morfologie kolonií

- Velikost (průměr; mm)
- Tvar
- Profil
- Okraje
- Povrch
- Transparence - průhledná, průsvitná, neprůsvitná kolonie
- Barva - kolonie bezbarvá, pigment: naředlá, bělavá, žlutá ...

Další znaky

Vůně, zápach

- po jasmínu, žluklém másle, ovocný ...

Tvorba mycelia

Změny media - dvorec zbarvení, hemolýzy, precipitátu

Konzistence - zjišťuje se bakteriální kličkou (viskózní, mazlavá, drobivá, zarůstá do agaru)





Figure 4
Colony mutants derived from SIN96 strain. Strains were grown on 1.5% agar medium for 50 hours at 25°C. The colony in the center is SIN96, with wild type morphotype and mutants at the periphery: 1) SINett, 2) CAD, 3) CIC, 4-6) cotton-like colonies.



Scientific Research Centre practical jokes



© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

"On the other hand, maybe humor shouldn't be analyzed."

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com



Macroscopic

Mikroskopie




Lidské oko má rozlišovací schopnost 0,07 mm.

Pro mikroskopii lze využít jakékoli vlnění s vlnovou délkou kratší než jsou rozměry objektu.



- **Pojmy a schémata mikroskopie**
- **A) Optická** - zobrazení struktur lišících se vzájemně absorbcí viditelného světla
 - 1) **Varianty optického mikroskopu**
 - 2) **Speciální optické mikroskopy**


zobrazení struktur lišících se vzájemně např. absorbcí UV i IR světla
- **B) Elektronová**
- **C) Akustická**



Historie mikroskopie



Tubulární mikroskop
Bratři Janssenové, 1595



Robert Hook 1665
Již olejová lampa




Nejstarší nákras
složeného
mikroskopu,
Isaac Beckman,
Middelburg, 1625




tot mijn
Doen
en meni
ende, di
door M
men no
dekkinge niet, amicus, en, zoo doet
Duyslant, zoo ik onderrigt werd.

90 ANTONI van LEEUWENHOEKS

Ik be
laten af
nen trek
nige de
Men l
van teke
servatiet
Boekje
was seer
daer uyt
ik dat Be
Job. Fra
of ik sag
kleynet
ren, als
doch se
nu komt
het aan



ren in 't geheel te
weinig nut kon
arom ik maar een
n afteikenen.
groot opgegeven
eroscopische Ob
de waren, welk
verveylt was. Ik
hoopende dat ik
ar soo rasen had
wa, door de H.
niet bekomen,
dig was: want de
e in afgebeeld wa
waren wel groot,
tey kent. Of die
ot-glasen, of dat
is my onbekent



Krystaly vinného octa,
Antony van Leeuwenhoek

Mikroskop typ I, 1670
Antony van
Leeuwenhoek
Jednoduché,
zaostřovací šroub,
držák.

Bez světla.

Celkem 419 mikroskopů



John Yarwell
Compound
Monocular
Microscope
(circa late 1600s)

1595 - Zachariáš a Jan Janssenovi - 1. mikroskop






Cuff's Microscope
(circa mid 1700s)



John Marshall
Compound
English
Microscope
(circa 1720)

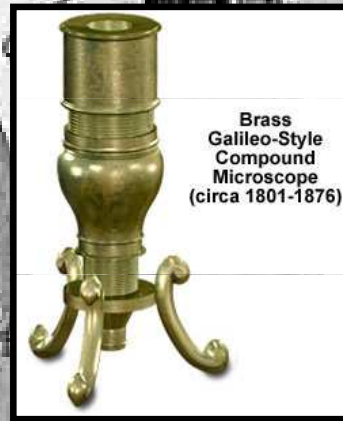

Brass
Galileo-Style
Compound
Microscope
(circa 1801-1876)



Early Ross
Compound Microscope
(circa 1831)



Oberhauser's
Drum
Microscope
(circa 1850)



Spencer
Compound
Binocular
Microscope
(circa 1932)



Carl Zeiss 1886
Složený monokulární mikroskop
Van Leeuwenhoekovy „Listy“




„Carl Zeiss“
binokulární mikroskop (design 2002)

Optická (světelná) mikroskopie

Max. zvětšení 1500 X, max. rozlišení 200 nm

Stavba světelného mikroskopu

- mechanické součásti - stativ, noha, tubus, revolverový měnič objektivů, stolek, makro- a mikrošroub
- optika mikroskopu (objektiv a okulár) – kombinace čoček, korekce vad
- osvětlovací zařízení - světlo prochází objektem



- zdroj světla: lampa v noze s kolektorovou čočkou
- kondenzor – ze 2-3 spojených čoček
- soustřeďuje světelné paprsky na objekt

Základem mikroskopu jsou dvě soustavy čoček:

1) Objektiv – vytváří skutečný, zvětšený a převrácený obraz pozorovaný okulárem jako lupou.



➡ **Výsledkem je neskutečný, zvětšený a převrácený obraz.** ←

- čím kratší ohnisková vzdálenost objektivu, tím větší je zvětšení

2) Okulár – zvětšuje obraz vytvořený objektivem, zvětšení je prázdné. Koriguje zbytek vad.


a) jeden – mikroskopy monokulární

b) dva – binokulární (Carl Zeiss 1933), světelný svazek rozdělen hranolem na dva



vznik obrazu

transmise, odraz, absorpce, fluorescence, lom



Na základě vlastností světla v prostředí vzniká obraz


Pojmy mikroskopie

Celkové zvětšení Z


- kolikrát je obraz sledovaného objektu větší než objekt
- je dáno součinem zvětšení objektivu a okuláru
- omezeno rozlišovací mezí

"Empty" Magnification

Final magnification using a simple lens system (e.g., dissecting microscope)



Same images: Final magnification using a compound light microscope



 BioEd Online

Rozlišení - jak daleko musí být od sebe dva body, aby nesplynuly v jeden

Rozlišovací mez - teorie výpočtu vychází z interference prošlých paprsků (E.K. Abbe)

$$\delta = \lambda / n \cdot \sin \alpha$$

Numerická
apertura

λ vlnová délka použitého světla - čím vyšší, tím vyšší rozlišení


n index lomu prostředí mezi čelem objektivu a sklíčkem

αúhel mezi optickou osou mikroskopu a kuželem paprsků vstupujících z preparátu do objektivu

- Numerická apertura objektivu
(NA)
 $n \cdot \sin \alpha$

= součin úhlu dopadu paprsků od objektu do objektivu a indexu lomu

- čím je vyšší, tím vyšší je rozlišovací schopnost objektivu, ale nižší hloubková ostrost

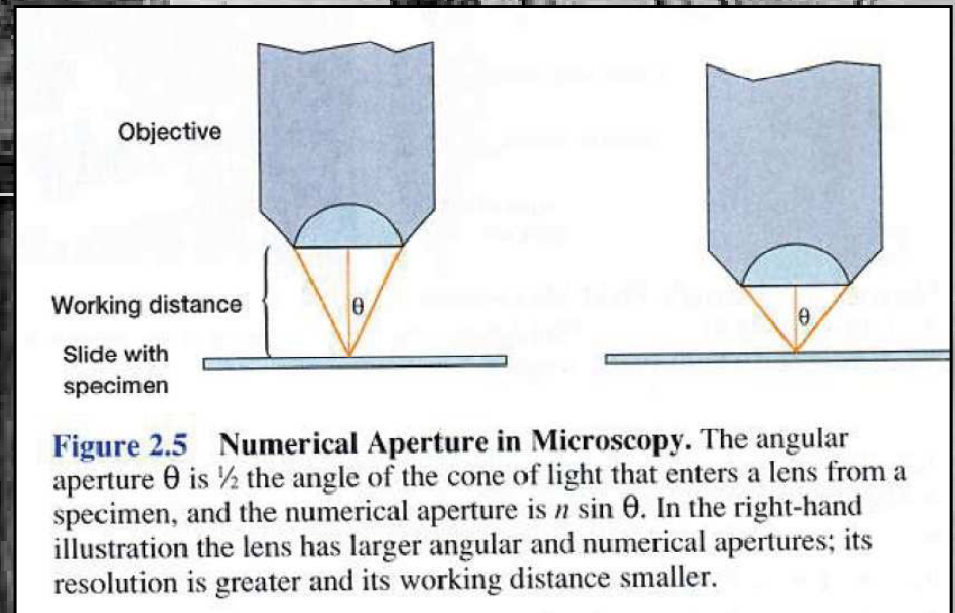

- Pracovní vzdálenost

- od povrchu čočky objektivu po krycí sklo

- Kontrast

- rozdíl ve vizualizaci objekt / pozadí

Suchý objektiv:

Paprsek vystupující z preparátu pod úhlem α se na rozhraní mezi krycím sklíčkem a vzduchem láme od kolmice a nemůže se již podílet na tvorbě obrazu.

**menší index lomu
menší numerická
apertura
vyšší rozlišovací mez**

$$n = 1$$


$$NA = \max 1$$

Pro žlutozelené světlo:

$$\lambda = 550 \text{ nm}$$

$$NA = 0,95$$

$$\text{Rozlišovací mez} = 0,6 \mu\text{m}$$



Rozlišovací mez

$$\delta = \lambda / n \cdot \sin \alpha$$



R. Hook - po 1.olejová lampa
Kapalina zvyšuje účinek
světla

Imerzní objektiv:

Paprsek přecházející ze skla do imerzního prostředí svůj směr nemění a může se podílet na tvorbě obrazu.

Imerzní prostředí - kapalina o stejném n jako krycí sklíčko.

Často cedrový olej ($n = 1,52$).

Imerze umožňuje korigovat některé opt. vady mikroskopu.

**větší index lomu
vyšší úhel α
vyšší numerická apertura
nižší rozlišovací mez**

$$NA = 1,2 - 1,4$$

Pro žlutozelené světlo:


$$\text{Rozlišovací mez} = 0,4 \mu\text{m}$$

Cedar Elm
Ulmus crassifolia

Optické vady (aberrace) objektivů:

- Otvorová vada (kulová, sférická)
Čočky objektivu nejsou tenké:
různý lom paprsků od optické osy
Bodový předmět zobrazen jako úsečka

- Barevná vada (chromatická)
Je způsobena optickou disperzí (závislost indexu lomu na vlnové délce světla).
Bodový předmět zobrazován na různá místa optické osy v závislosti na vlnové délce světla.



Korekce vad

Kombinacemi vhodných spojných či rozptylných čoček z různých materiálů o různém n.

Rozlišení objektivů dle stupně korekce vad:

Achromáty – barevná vada korigována pro 2 barvy světla (červené a modrozelené), otvorová pro žluté

Semiapochromáty – barevná vada korigována pro 2 barvy blíže oběma koncům viditelného světla

Apochromáty – barevná: nejméně pro 3 barvy, otvorová pro 2. Nejdokonalejší objektivy pro bílé světlo

Planachromáty a planapochromáty – korigované i zklenutí zorného pole. Význam pro mikrofotografii.


Okuláry - typy dle účelu mikroskopie

- **Huygensův** - 2 čočky. Slabé achromáty
- **Ortoskopické** - nezkrslují zorné pole, mají přesně stejné zvětšení v celém zorném poli. Zejména k měřicím účelům.
Achromáty, planapochromáty
- **Kompenzační** - kompenzují zbytkové chromatické vady.
Apochromáty
- **Periplanatické** - odstraňují astigmatickou vadu silněji zvětšujících objektivů. Planapochromáty.
- **Brillovy** - dioptrické
- **Širokoúhlé** - průměr zorného pole až 2,5 cm
- **Projektivy** - mikrofotografie

Varianty optického mikroskopu




• 1) Mikroskopie v temném poli – pro zvýšení kontrastu



- preparát silný pro průchod paprsků
- pozorování v odražených paprscích
- upravený kondenzor osvětluje preparát zesponu (čočka uprostřed zacloněná) – objekt svítí

metoda na pozorování velmi malých objektů (prvoci, bakterie) a jejich struktur zaživa

• 2) Stereomikroskopie – 2 mikroskopy se samostatnými




- objektivy a okuláry - jejich optické osy svírají určitý úhel
- plynulá změna zvětšení bez zaostření (operační mikroskopy)

• 3) Mikroskopy pro mikrofotografování, pro pořizování videozáznamu s digitálními kamerami, projekční mikroskopy, mikroskopy s mikromanipulátory

Speciální optické mikroskopy

zobrazení struktur lišících se vzájemně absorbcí např. UV, IR světla




- fázově kontrastní mikroskop

1953 – Nobelova cena za objev – Frits Zernike (1888 – 1966)

- interferenční mikroskop
 - diferenční interferenční kontrast dle Nomarského (DIC)




- polarizační mikroskop
- UV mikroskopie
- fluorescenční mikroskop





Fázový kontrast I.


- Klasický světelný mikroskop:
 - **detaily objektů** nejsou rozeznány vzhledem k malému kontrastu mezi strukturami s podobnou propustností světla

- Různé části prep. - různý index lomu a ohyb paprsků




možnost pozorování živých objektů v nativním stavu bez barvení



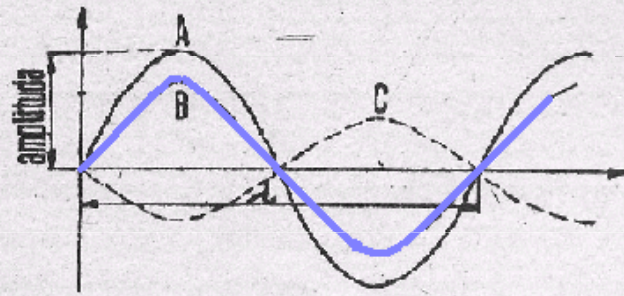

Obr. 7. Průchod světla absorbovujícím objektem

A - světelná vlna dopadající na objekt, B - světelná vlna po průchodu zbarveným objektem, C - světelná vlna po difrakci v objektu, (B vzniká interferencí A a C)

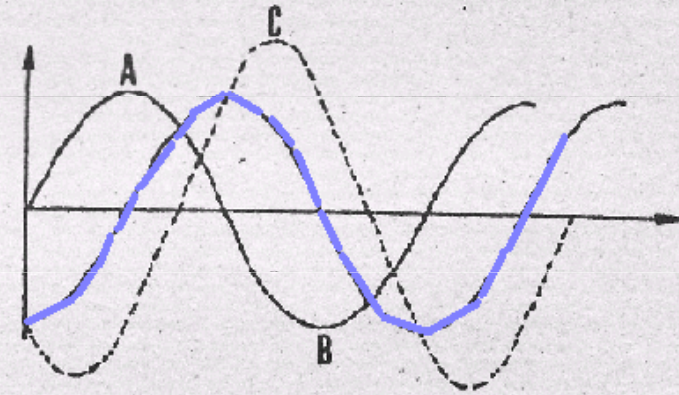


Obr. 8. Průchod světla transparentním objektem

A - světelná vlna dopadající na objekt, B - světelná vlna po průchodu transparentním objektem, C - světelná vlna po difrakci v objektu, (B vzniká interferencí A a C)

V **husté absorbovující části preparátu:**

vidíme ji jako světlou; dojde k částečné absorpci vlnové délky a ke změně amplitudy což zachytíme jako změnu intenzity světla.



$$B = A + C$$

Vlna C je oproti původní vlně A po difrakci posunuta o 180° .


Při průchodu světelné vlny **transparent. objektem** se vlna zpozdí, nemění však

intenzitu ani amplitudu, ale posune se její fáze - často o 90° .

Mikroskop zvýší změnu ve fázi mezi původní vlnou A a vlnou po difrakci C na 180° - obě se pak po interferenci co nejvíce ruší.

Pozn: posun fáze je v závislosti na rozdílu indexu lomu dané struktury a okolí, na délce optické dráhy a na vlnové délce světla.

Fázový kontrast II





- Princip:

V kondenzoru - kruhová clona (zatemnělý střed)

Paprsky projdou vzorkem - na fázových objektech dojde k odchýlení některých paprsků z původního směru (vlivem ohybu, rozptylu, lomu).

V objektivu - čtvrtfázová destička, také tvar mezikruží. Na ni dopad paprsků, co nezměnily směr při interakci s fázovými objekty, ty posunuty, ostatní paprsky (se změněným směrem) destičku minou, nejsou posunuty.




→ Rozdíly ve fázi světla převedeny na změny kontrastu


Fázový kontrast III.

Contrast


Three views of *Paramecium caudatum* (food vacuoles contain stained yeast cells)




low contrast



optimum contrast



high contrast




A

B

(left) *Bacillus thuringiensis* with endospores: (A) bright field; (B) phase contrast (400x)

(right) Pseudopodium of *Chaos (Pelomyxa) carolinensis*: (C) bright field; (D) darkfield (100x)




D




BioEd Online



Epiteliální buňka



Bacillus megaterium



Obraz je vytvářen interferencí paprsků fázově posunutých i neposunutých

- Pozitivní fázový kontrast: objekty tmavší vůči pozadí (fázově posunuty paprsky se změněným šířením)
- Negativní fázový kontrast jsou-li objekty oproti pozadí relativně světlejší (fázově posunuty paprsky nevychýlené ze svého směru)

Interferenční mikroskop

- **Princip:** pracuje se **2 koherentními** (interference schopnými) **paprsky**,
 1. prochází objektem
 2. vedle objektu

Obraz: vzniká interferencí obou oddělených paprsků.


Výhoda: možnost přímého měření indexu lomu objektů.

Varianta interferenčního mikroskopu:

Mikroskopy s diferenčním interferenčním kontrastem dle Nomarského (DIC)

Hlavní součásti:

Polarizátor srovnává vlny, jež jsou v různých rovinách
Nomarského destička v kondenzoru je hranol, jež zpracovává polarizované světlo tak, že na preparát jdou dva paprsky souběžně vedle sebe. V analyzátoru vidíme 3D obraz v závislosti na **různém n** různých částí buňky. Zvýrazněním i malých rozdílů vznikne **plastický obraz povrchu buňky**.



Bacillus megaterium


Bacillus cereus

Sporosarcina ureae

- Princip: svazek polarizovaného světla je po průchodu preparátem štěpen polarizačním filtrem na 2 nepatrně posunuté svazky (nastává dvojlom).

Takto se vytvoří i dva nepatrně posunuté obrazy, navzájem „kolmo polarizované“.

Oblasti obrazů s fázovým posunem (způsobeného fázovými objekty preparátu) se přesně nekryjí a místa překryvu různého fáz.posunu jsou interferencí zviditelněna změnou jasu či barevným obrysem, v závislosti na použití monochromatického / polychromatického světla.



Výhoda: citlivé i na velmi malou změnu optické dráhy paprsků

(optická dráha je součinem indexu lomu a geometrické dráhy paprsku v daném prostředí)

Polarizační mikroskop

- zviditelnění opticky aktivních nebo dvojlom vykazujících struktur
- Princip: spojení konvenčního mikroskopu a polarimetru.
- Optickou aktivitou se projevují i některé složky cytoplazmy i proudění cytoplazmy.

UV mikroskopie

- Princip: optika mikroskopu musí být z křemenného skla (dobře propouští UV). Obraz nepozorujeme okem, je zviditelněn na luminiscenčním stínítku a je fotografován.
- Kratší vlnová délka UV = vyšší rozlišovací schopnost, té obvykle ale dosaženo není. Optika má korigovány vady pro jedinou vlnovou délku - takovou, co je přítomna ve zdroji UV záření.
- Výhoda: přímé pozorování struktur propouštějících viditelné, ale pohlcujících UV světlo (bílkoviny, DNA).

Fluorescenční mikroskop

Mycobacterium phlei
Auramin-rodamin

Využívá schopnosti některých látek po ozáření světlem o kratší vlnové délce emitovat viditelné světlo o delší vlnové délce.

Využito dlouhovlnné UV a přilehlá oblast viditelného spektra emitovaného halogenovými lampami.

UV světlu je přizpůsobena optika kondenzoru, zbytek optického systému totožný s běžným optickým mikroskopem.

Přidány filtry (bariérový) chrání lidské oko před zbytkovým UV.

Fluorescenci vykazují:


někt. složky živé hmoty i bez obarvení (látky s aromatickým jádrem či heterocyklem - např. amk. tryptofan), většinu preparátů však barvíme fluorescenčními barvivy na zákl. specifické interakce s buněčnými strukturami. Mnohdy je fluorescenční barvivo (fluorochrom, fluorescenční sonda) navázáno na protilátku specifickou pro určitou bílkovinu v cytoplasmě, tak lze selektivně zviditelnit složky cytoskeletu eukaryotických buněk, chromatin, membránové bílkoviny apod.

- Fluorescein
- DAPI
- Calcofluor
- Akridinová oranž

Schéma a princip fluorescenčního mikroskopu

Schéma fluorescenčního mikroskopu Olympus


- 1 – vysokonapěťový zdroj
- 2 – schránka s výbojkou
- 3 – iluminátor (osvětlovač)
- 4 – objektiv
- 5 – otočná kazeta na kostky s filtry
- 6 – okulár
- 7 – univerzální kondenzor



Filtre indukované - (excitace a emisní) lze vyrobit pomocí 7

Schéma principu fluorescenční mikroskopie


1. Rtuťová výbojka
2. Excitační filtr
3. Zrcátko 30% průhledné
4. Objektiv
5. Preparát
6. Bariérový filtr - dle spektra fluoresc. barviva, propustí jen světlo V



Princip fluorescenčního mikroskopu
Otočná kostka s filtry a zrcátkem.
Zrcátko rozdělí excitační a emitované světlo

Příklad s filtry:

Složené světlo po průchodu budícím filtrem redukováno na světlo modré, ost. pohlceno. Modré světlo dopadá na buňky s fluoresc. barvivem, to vysílá paprsky o delší vlně (žluté). Modré je pohlceno bariér.filtrem. **V temném poli svítí žluté buňky.**



Doposud zmiňované optické mikroskopy (optický + varianty a speciální mikroskopy) **vytvářejí obraz okamžitě, jako spojitý celek.**

Optické mikroskopy **vytvářející obraz postupně, z jednotlivých bodů (pixelů)**


= **nesou informaci z úzkého světelného paprsku:**

1. laserový řádkovací (rastrovací, skenovací) konfokální mikroskop

- Rušivé světlo z vrstev nad a pod rovinou ostrosti odstraněno z dráhy k detektoru zábranou s malým otvorem – **výsledek: perfektně ostrý obraz.** Paprsek se po objektu posouvá a obraz jednotlivých bodů se skládá v PC. Posunem paprsku do jiné hloubky lze vytvořit optické řezy a skládat je do 3D obrazu.

- Význam: možnost pozorování i relativně silných preparátů, včetně nativních.

- Konfokální mikroskop lze upravit i pro konfokální fluorescenční mikroskopii



2. barevný řádkovací mikroskop „s letící stopou“

- místo mechanického řádkovacího systému používá jasnou bílou světelnou stopu, která přebíhá po řádcích na obrazovce osciloskopu.
- Výhody: výborné rozlišení, vysoký kontrast (úpravou jasu zdrojové světelné stopy v závislosti na absorbanci preparátu)

3. optická skenovací mikroskopie v blízkém poli NFOS

- velmi úzký světelný paprsek prochází po řádcích velmi tenkým preparátem a jsou měřeny změny jeho intenzity.
- Výhody: rozlišení 10 - 100x vyšší než u klasického světelného mikroskopu. Výhodou oproti elektronové mikroskopii (viz dále) je, že vzorek nemusí být umístěn ve vakuu ale lze jej pozorovat např. ve vodném prostředí.


Elektronová mikroskopie (EM)

- Zobrazení předmětů pomocí urychlených elektronových svazků - elektrony mají vlnovou délku de Broglieových hmotnost.vln
- Urychlením lze dosáhnout stotisíckrát kratších vlnových délek:
Rozlišovací schopnost pak ($\sigma = \lambda / n * \sin\alpha$): velmi malá λ
- Vlivem velkých optických vad použitých čoček (magnetické) poměrně malá numerická

apertura - řádově setiny.

Rozlišovací mez: desetiny nm (mlk)

Dělení EM dle způsobu zobrazování
transmisní
emisní
odrazové (v praxi málo používané)
řádkovací (skenovací či rastrovací)




Another casualty in the War of the Atoms.



Elektronový mikroskop

Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

- V biologické praxi:
Z 5 000 - 1000 000 ×
rozlišení: desetiny nm (větší molekuly)
- Struktura objektu: průchodem el.svazku
- Elektronový paprsek: ze žhaveného kovového vlákna
- Proti rozptylu elektronů: v tubusu EM vysoké vakuum
- Čočky vytvářeny obvykle rotačně symetrickým elmag. polem
- Konečný obraz pozorujeme nepřímo, projekcí na luminiscenční stínítko



Nevýhody: speciální postupy pro fixaci a barvení; vakuum; vysoký tlak, jako „barviva“: soli a oxidy těžkých kovů, nutno rozlišit artefakty vzniklé zpracováním preparátu.

Rastrovací elektronová mikroskopie


(skenovací, řádkovací, Scanning Electron Microscope - SEM)

- velmi úzký paprsek elektronů je vychylovacím systémem nucen přejíždět po povrchu preparátu po řádcích
- Rozlišovací schopnost SEM o 1-2 řády menší než TEM, ale **možnost pozorování objektů s komplikovanou 3D strukturou** (signál totiž nese informaci o sklonu povrchu v místě dopadu svazku elektronů) **výsledkem je obraz s vysokou hloubkou ostrosti**

Nevýhody: pokovování povrchu preparátu, složitá fixace.
Problém rozlišení artefaktů vzniklých zpracováním preparátu

Skenovací tunelová elektronová mikroskopie (scanning tunneling electron microscopy, STM)

- Nad povrchem preparátu se pohybuje velmi tenký kovový hrot, ke kterému „tunelují“ elektrony z povrchu preparátu (tunelový efekt - jev kvantové mechaniky, kdy částice pronikají oblastí, na překonání níž by dle zákonů klasické mechaniky neměli dostatek energie)
- Zobrazuje se elektronová hustota na povrchu preparátu s rozlišením na úrovni rozměrů atomů.
- Výhody: Vzorky nemusí být ve vakuu, ale např. i ve vodném prostředí.



The background of the slide is a grayscale image of a historical scientific manuscript page. It features several detailed diagrams and handwritten text. At the top, there are diagrams of mechanical or optical components, possibly related to microscopy or acoustics, with various parts labeled with letters like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. The text is written in a cursive script, likely Latin or German. The overall appearance is that of an old scientific treatise or notebook.



Akustická mikroskopie

- Hyperzvuk proniká v kapalinách i pevném prostředí do hloubky jednotek až desítek mikrometrů.
- Pozorování preparátů neprostupných pro elektrony a viditelné světlo.
- Informace o mechanických vlastnostech prostředí.

Barvení buněk



- Gramovo barvení – barvení bakterií jako identifikační metoda
- Hans Christian Joachim Gram (1884)
 - 1) Bazické barvivo --- 2)voda ---- 3)Lugolův fixační roztok --- 4)voda --- 5)aceton, ethanol
 - 6)voda --- 7)safranin (dobarvení)



Gramnegativní typ

buněčné stěny:

peptidoglykan 10%, 2nm,
porózní výplň mezi
cytoplazmatickou membránou
a vnější membránou.

Barvivo se v porózní
vrstvě nenaváže,
odmývá se.

Grampozitivní typ

buněčné stěny:

peptidoglykan 40nm, 90%,
hydrofobní struktura.

Mezi polymerem je voda.

Do hydratované vrstvy se

dostává barvivo krystalové

violeti, Lugolův roztok

fixuje přímo na strukturách.



Organické rozpouštědlo

poté dehydratuje vrstvu.


Barvivo zůstává pevně

vázáno, **nedobarví se dál**

safraninem.



Field of View and Light Intensity

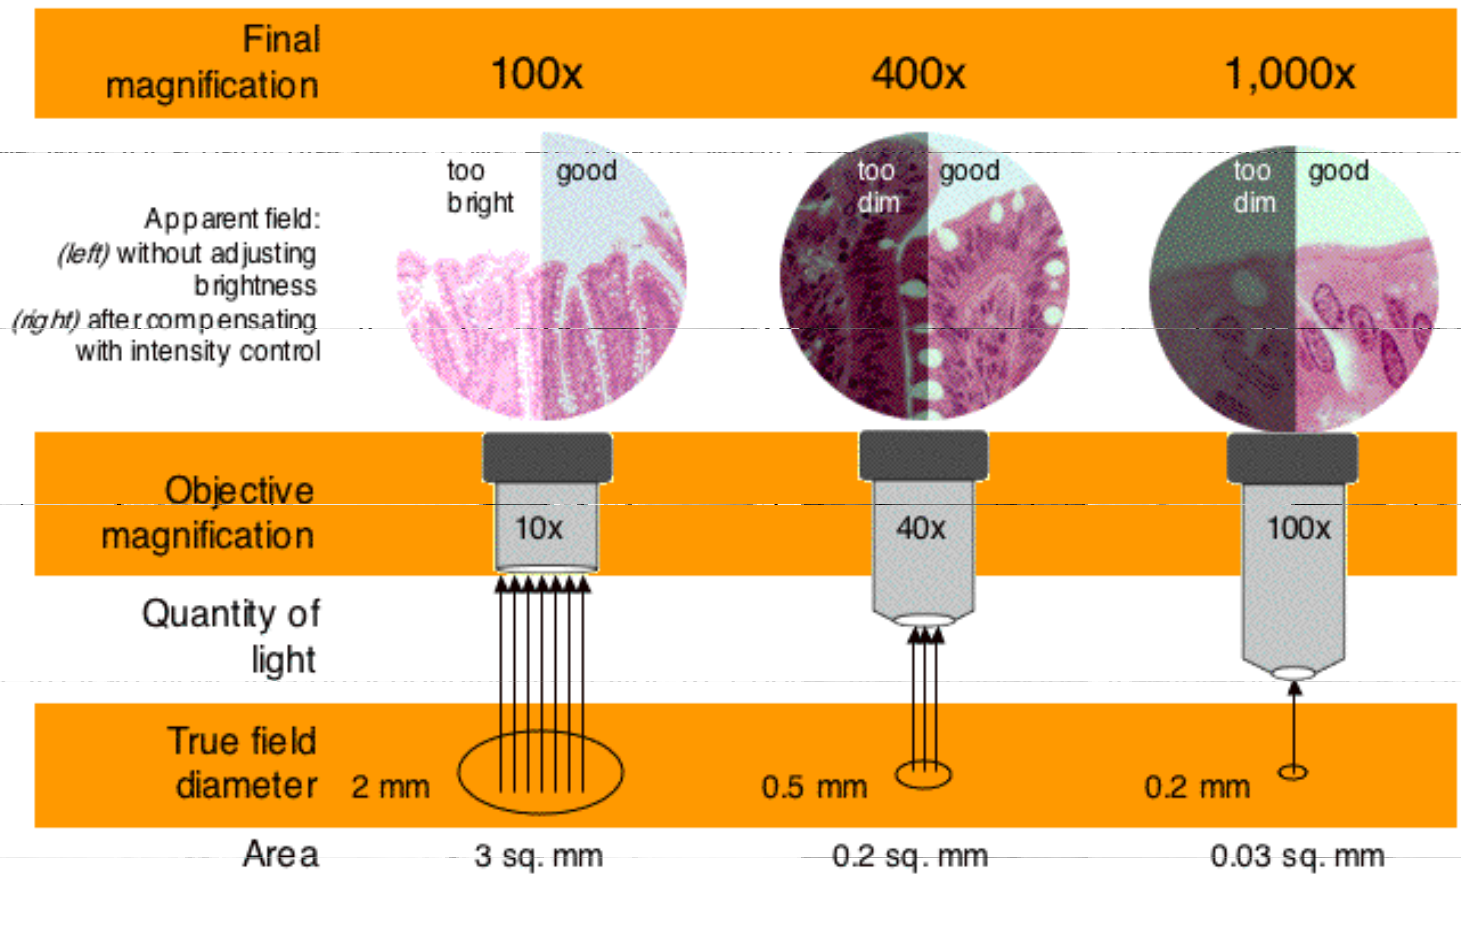

BioEd Online

at all.

a ember

in bacteria, very


in the 4x to area in 2.5 mm

m. The vely,

tion

Table 2-1 Comparison of Various Types of Microscopes

| Type of Microscope | Maximum Useful Magnification | Resolution | Description |
|------------------------------------|------------------------------|------------|---|
| Brightfield | 1,500× | 100–200 nm | Extensively used for the visualization of microorganisms; usually necessary to stain specimens for viewing |
| Darkfield | 1,500× | 100–200 nm | Used for viewing live microorganisms, particularly those with characteristic morphology; staining not required; specimen appears bright on a dark background |
| Ultraviolet | 2,500× | 100 nm | Improved resolution over normal light microscope; largely replaced by electron microscopes |
| Fluorescence | 1,500× | 100–200 nm | Uses fluorescent staining; useful in many diagnostic procedures for identifying microorganisms |
| Phase contrast | 1,500× | 100–200 nm | Used to examine structures of living microorganisms; does not require staining specimens |
| Nomarski differential interference | 1,500× | 100–200 nm | Used to examine structures of microorganisms; produces sharp, multicolored image with three-dimensional appearance |
| Confocal | 1,500× | 100–200 nm | Used to examine structures of microorganisms and individual microorganisms within mixtures of various types of microorganisms; uses fluorescence staining; produces blur-free image; used to produce three-dimensional images |
| Transmission electron (TEM) | 500,000–1,000,000× | 1–2 nm | Used to view ultrastructure of microorganisms, including viruses; much greater resolving power and useful magnification than can be achieved with light microscopy |
| Scanning electron (SEM) | 10,000–1,000,000× | 1–10 nm | Used for showing detailed surface structures of microorganisms; produces a three-dimensional image |



Obrazová dokumentace a zpracování obrazu

- Zařízení
- Kompresce a formáty obrazu
- Pojmy
- Programy - analýza obrazu (LUCIA)

Zajímavé adresy a odkazy

- <http://www.gate2biotech.cz/nejdokonalejsi-elektronovy-mikroskop-ve-sluzbach-ustavu-molekularni-genetiky-av-cr/>
- <http://micro.magnet.fsu.edu/cells/bacteriacell.html>
- <http://www.micro-scope.de/toc.html>
- <http://w3.uniroma1.it/MEDICFISIO/microscopy.htm>
- <http://www.euronet.nl/users/warnar/leeuwenhoek.html>



Zdroje:

- Campbell N.A. a kol. (2006): Biologie, Computer press, Brno
- Čech S. a kol. (1998): Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů, LFMU, Brno
- **Hrazdira.I., Mornstein V. (2001): Lékařská biofyzika a přístrojová technika, Neptun, Brno**
- Rosypal a kol. (1999): Úvod do molekulární biologie, Brno