


3) Bipotenciometrické titrace

Dvojice polarizovatelných elektrod

Udržuje se konstantní proud

Závislost vloženého napětí na objemu přidávaného titračního činidla

Kde je u biamperometrie minimální proud, musí být u bipotenciometrie vloženo větší napětí

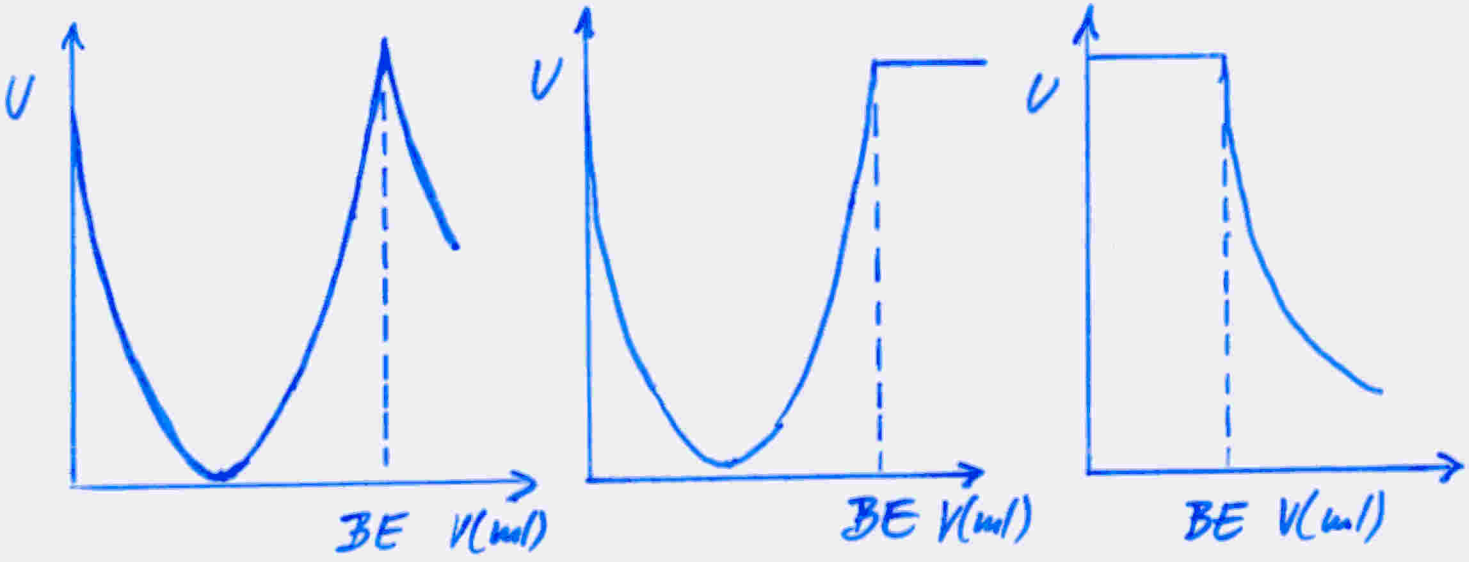

titrace reverzibilního systému reverzibilním

reverzibilního ireverzibilním

ireverzibilního reverzibilním

ELEKTROGRAVIMETRIE

COULOMETRIE

úplná přeměna stanovované látky na jinou formu v rozdílném oxidačním stupni, průchodem proudem.

