

Bazotest (Test aktivácie bazofilov) - Výsledky

Referenčné hodnoty

Negatívna kontrola:

CD63 0-15 %

CD203c 0-15 %

Pozitívna kontrola:

CD63 15-100 %

CD203c 15-100 %




Alergén:

CD63 0-15 % (pozitivita > 15%)




CD203c 0-15 % (pozitivita > 15%)

Pacient č.1

Negatívna kontrola

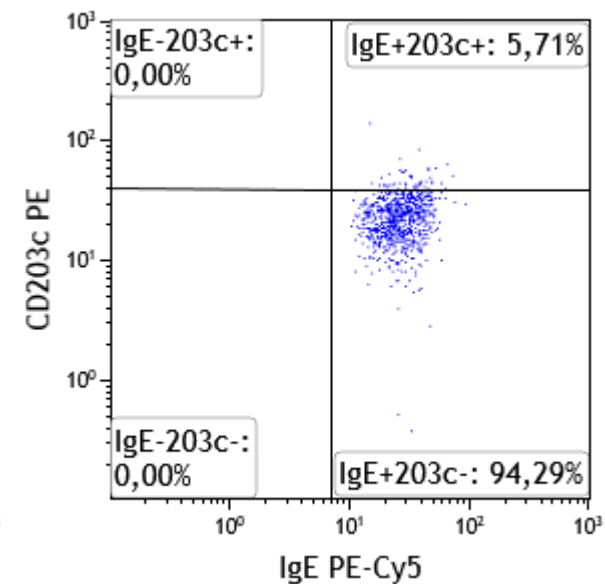
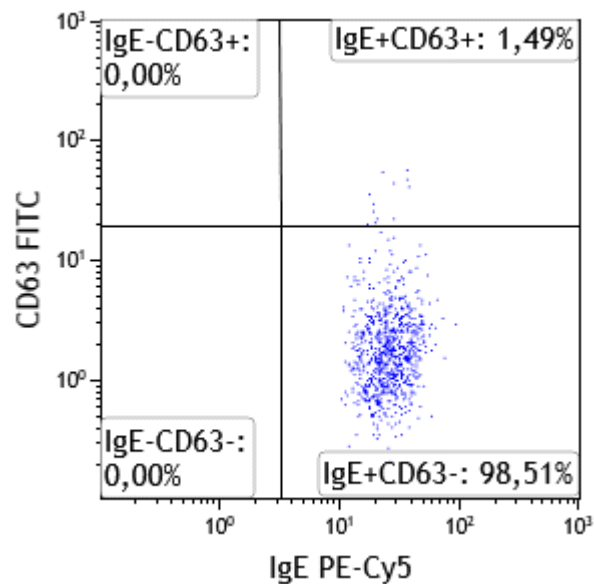
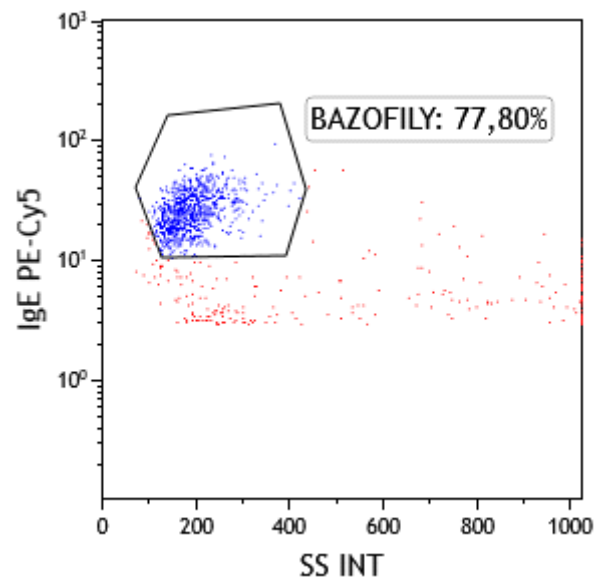


Pozitívna kontrola

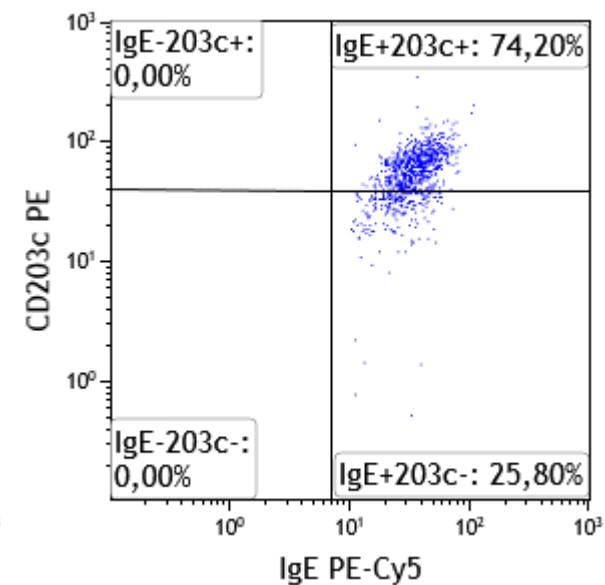
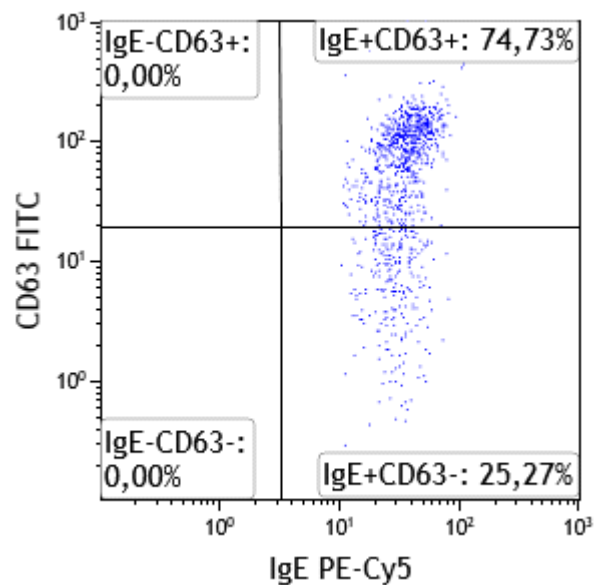
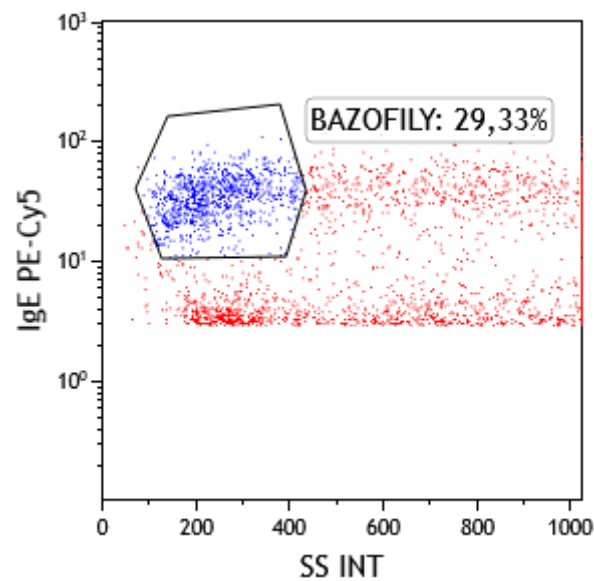


Pacient č.1

Včela

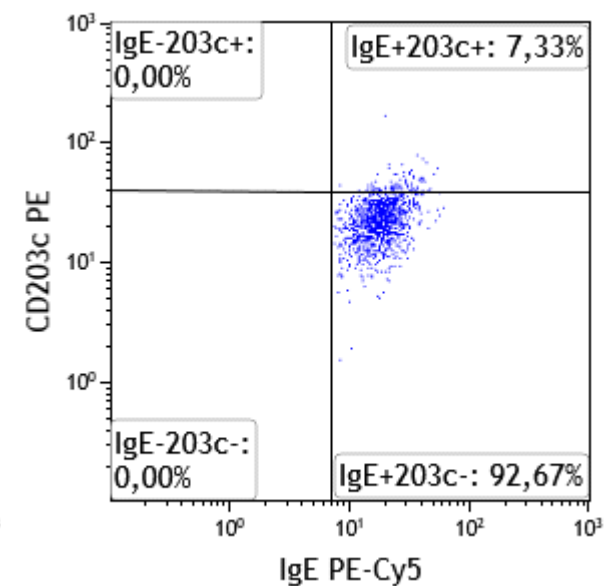
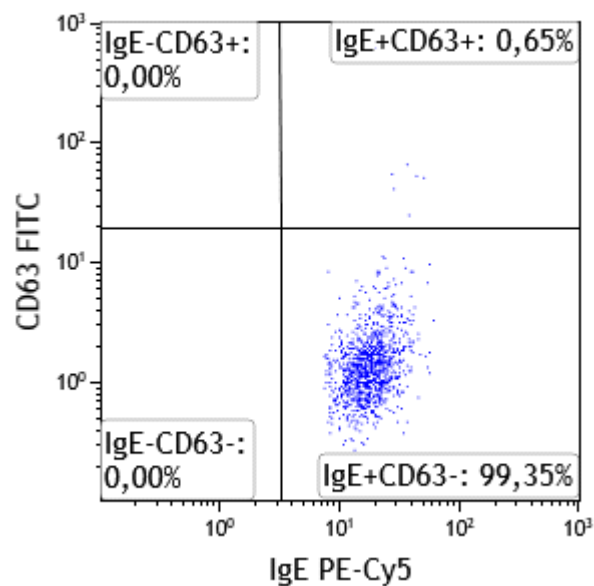
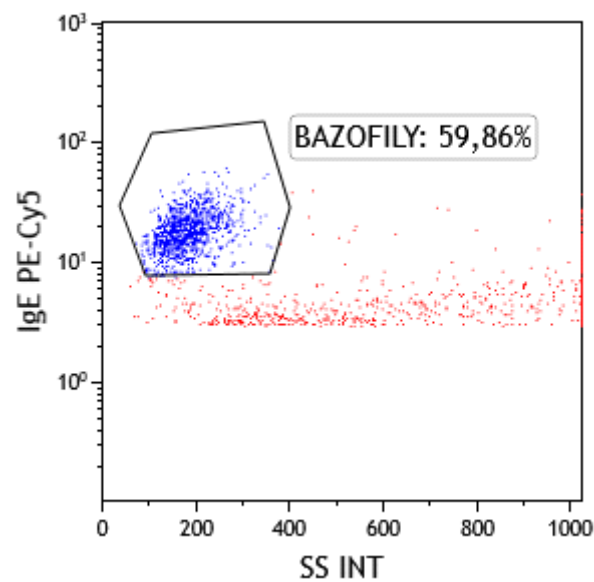


Osa

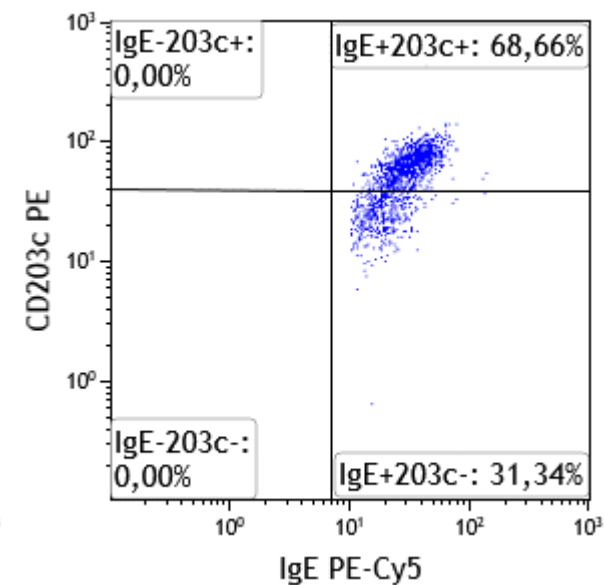
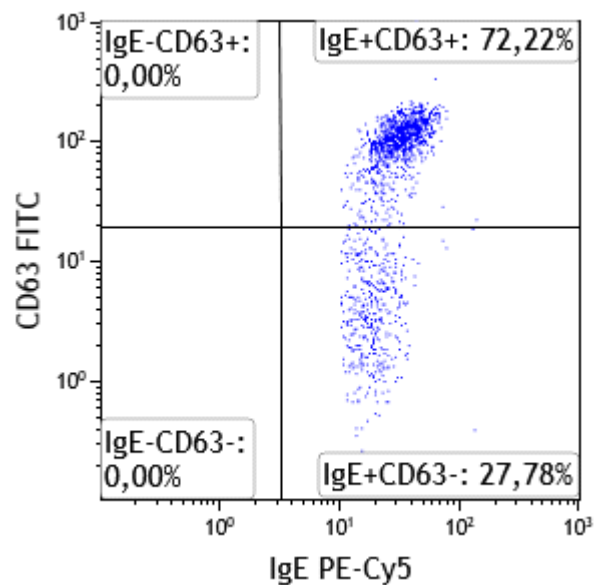
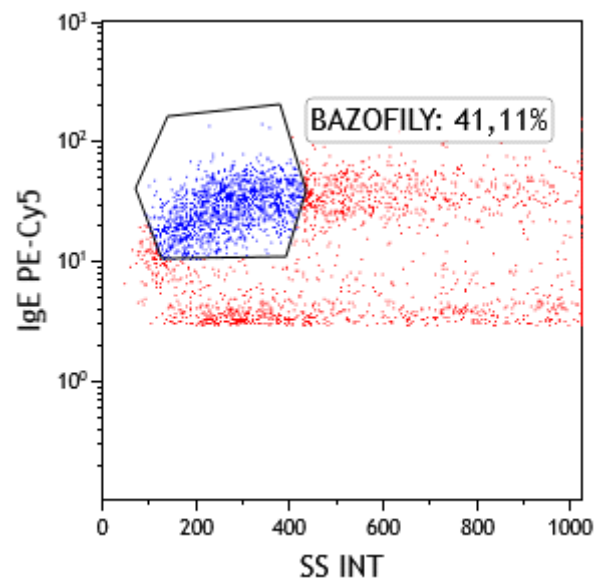


Pacient č.2

Negatívna kontrola

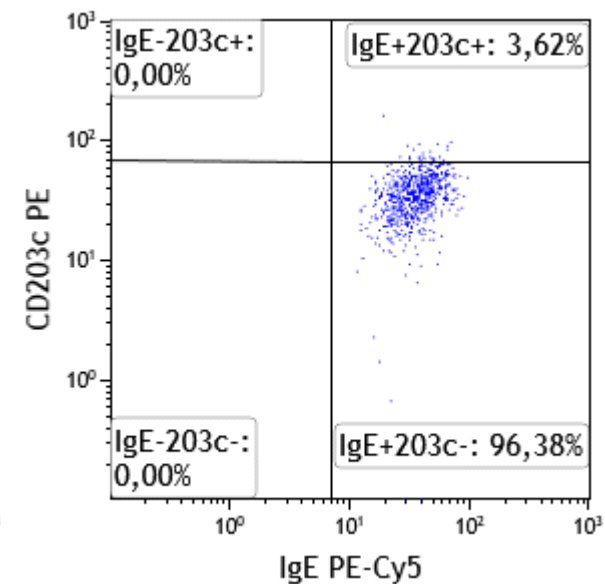
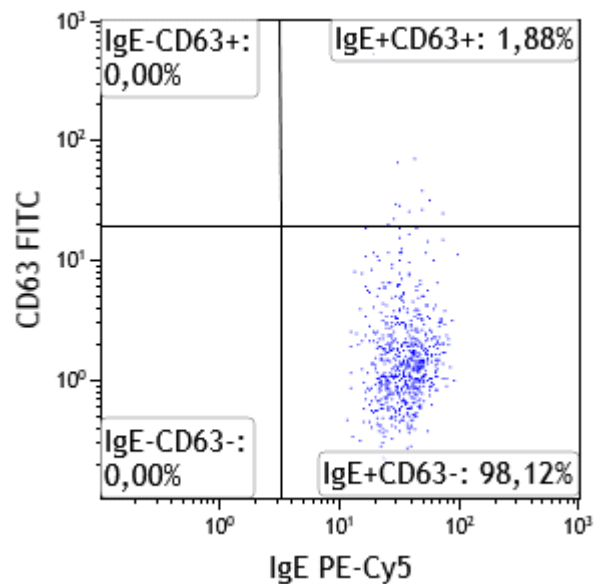
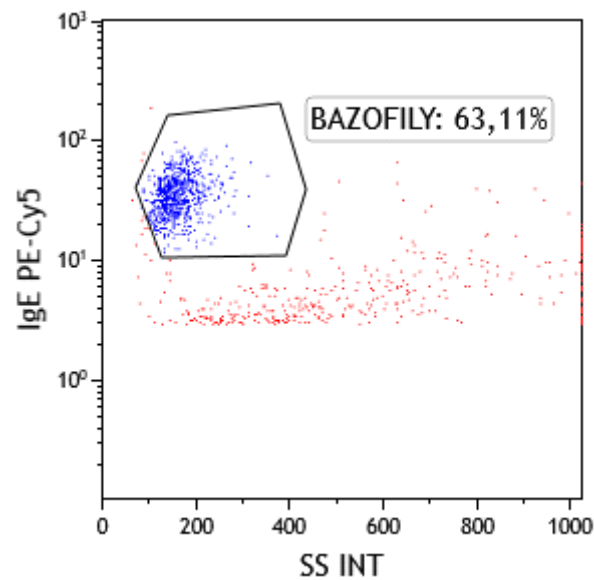


Pozitívna kontrola

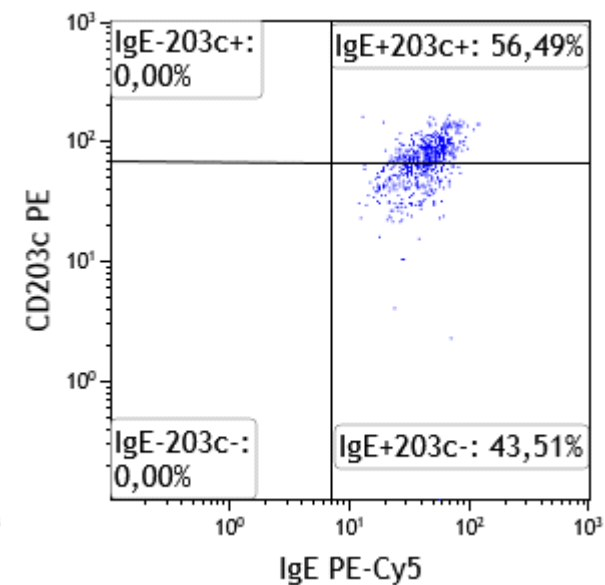
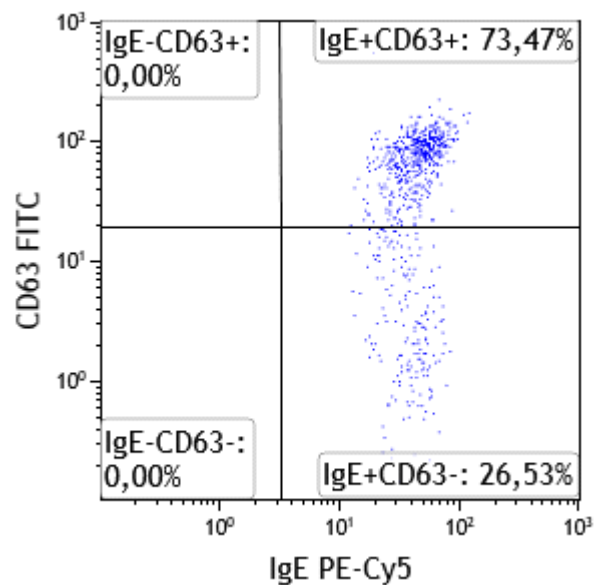
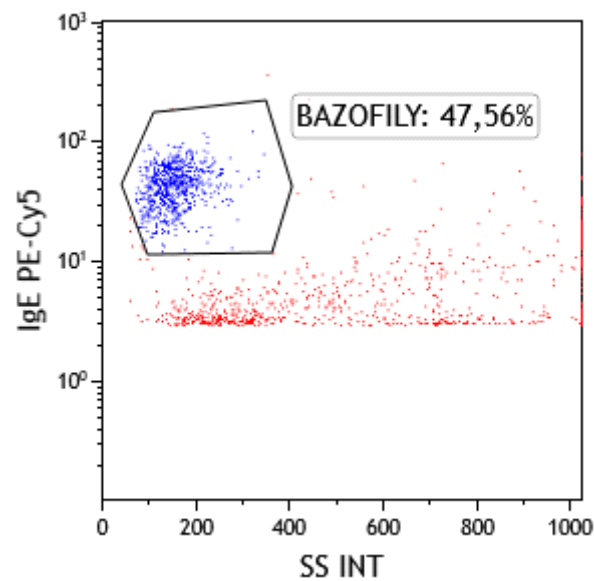


Pacient č.2

Včela

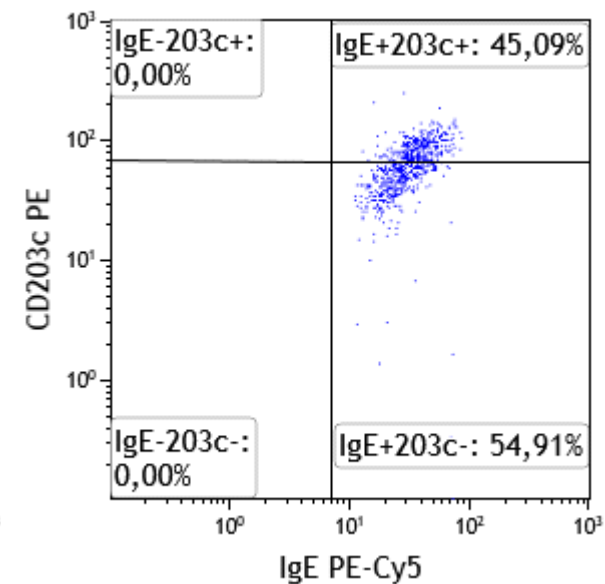
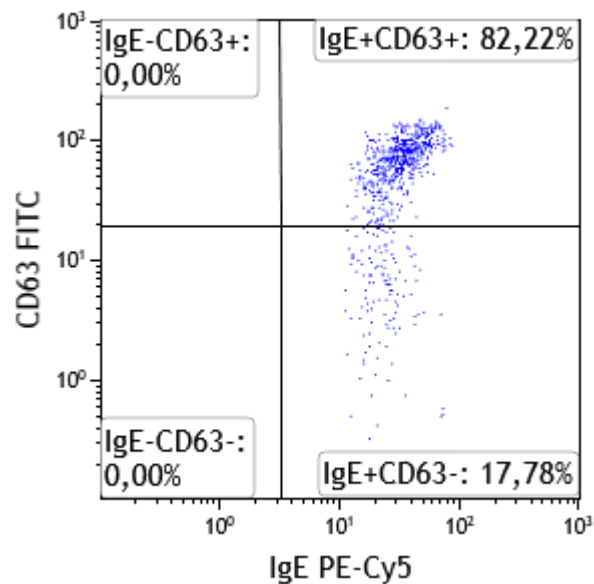
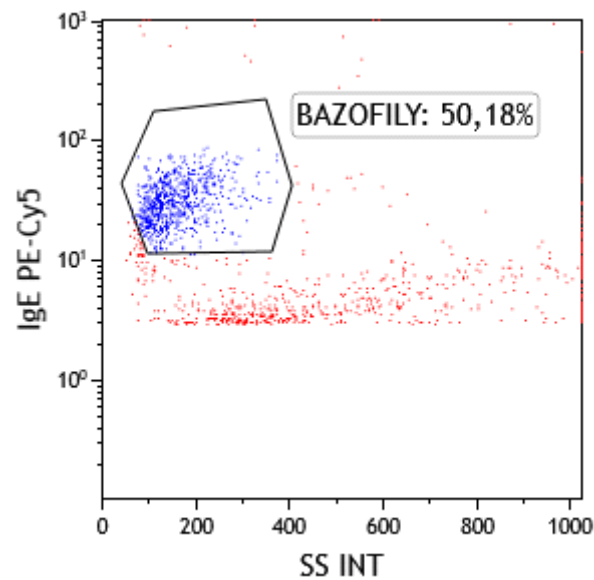


Osa

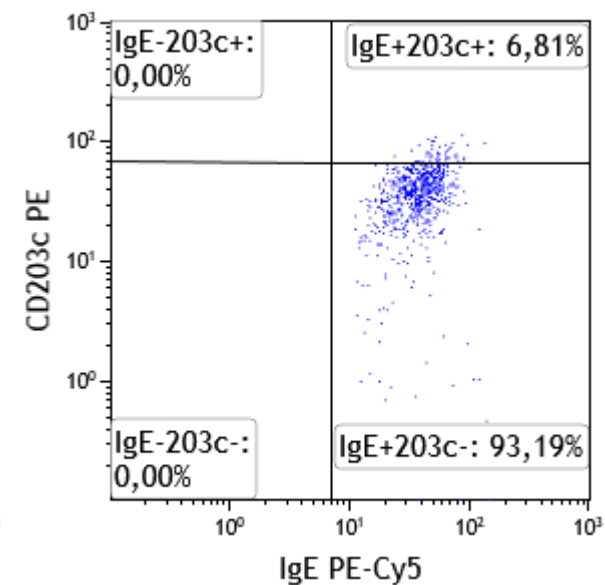
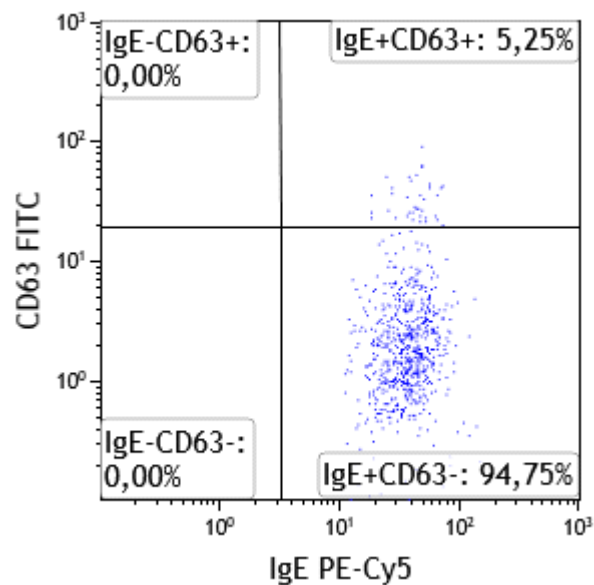
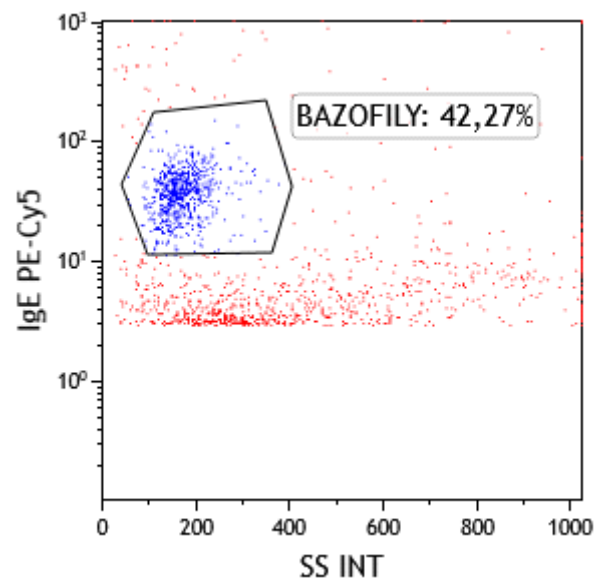


Pacient č.3

Negatívna kontrola

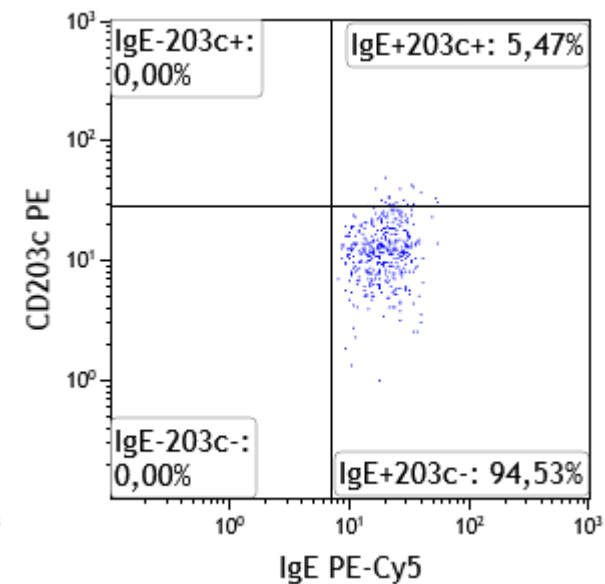
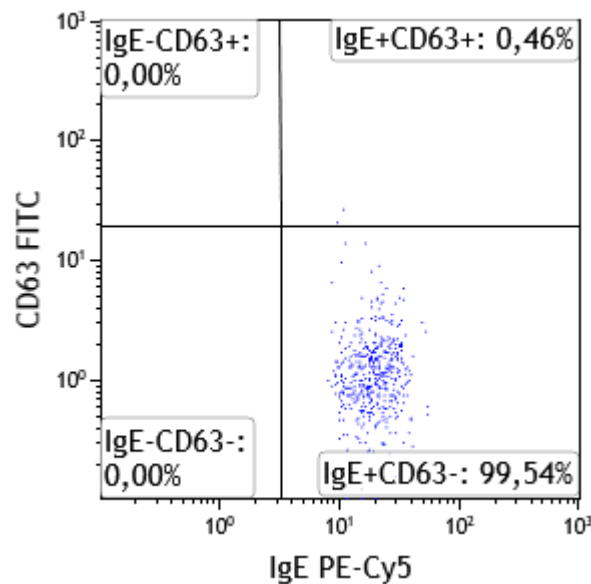
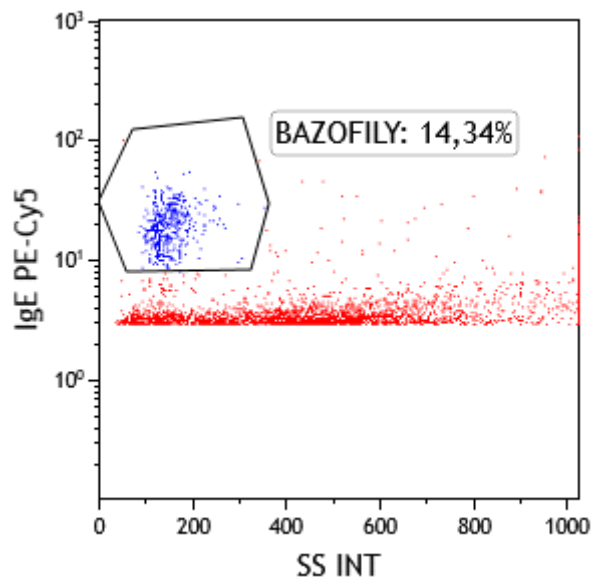


Pozitívna kontrola

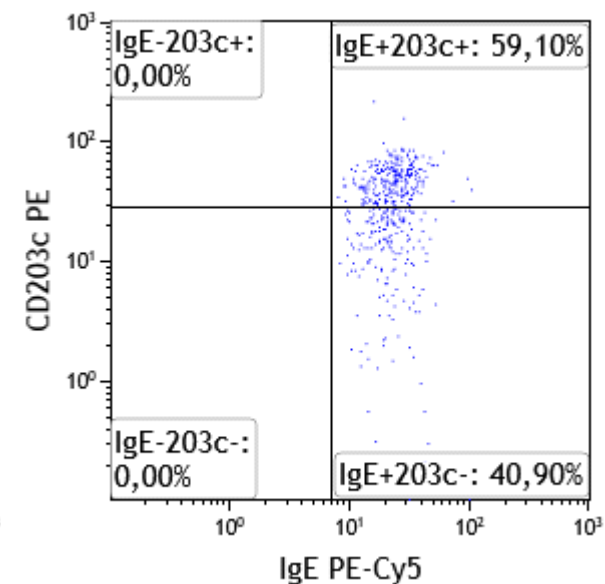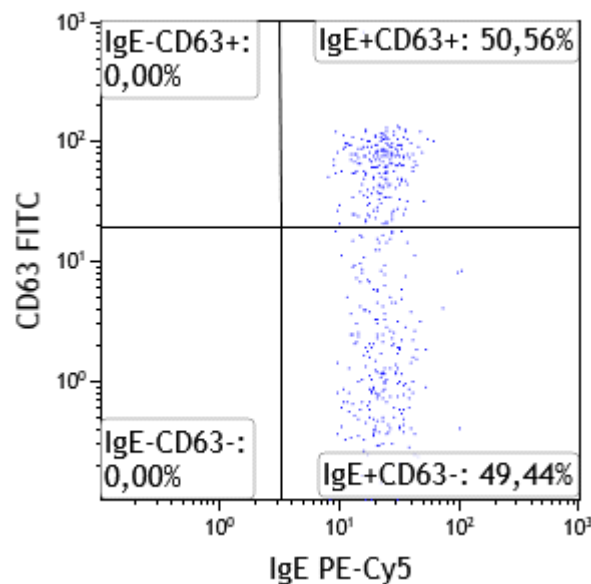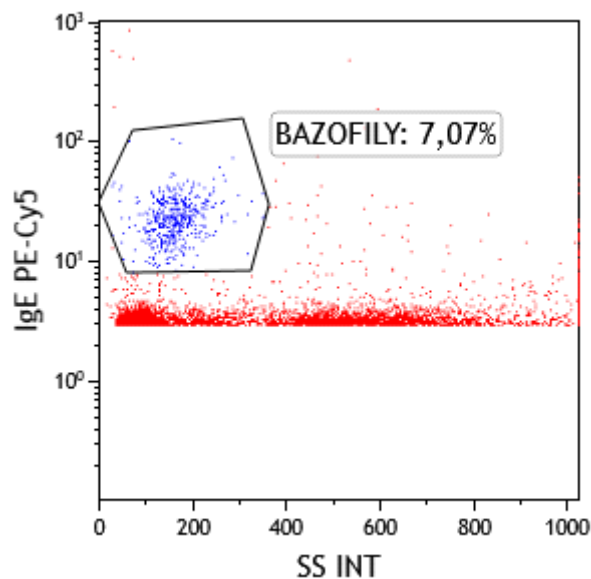

Pacient č.3

Včela

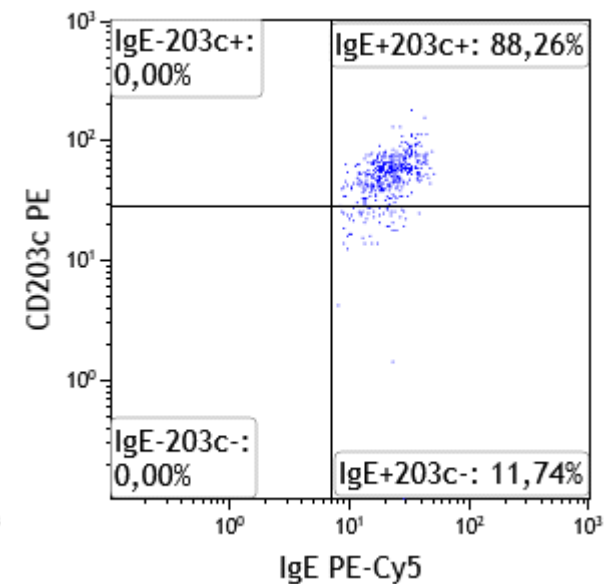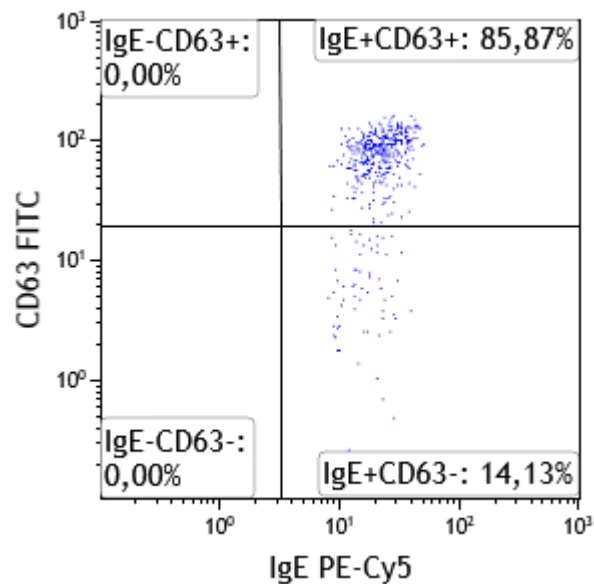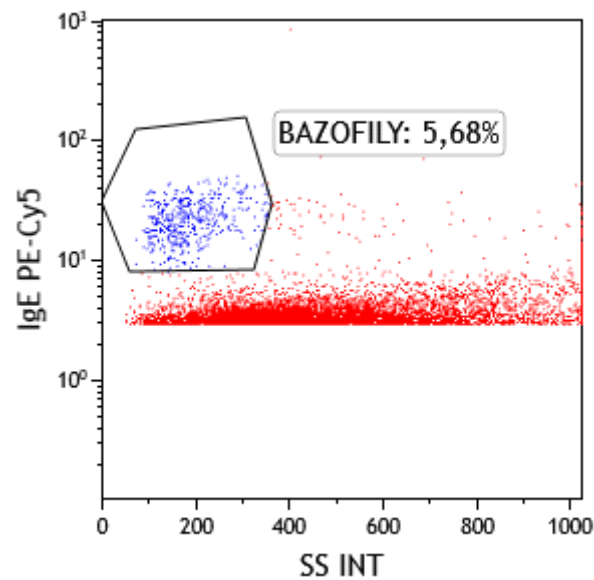

Osa

