

Rutinní koagulační testy

Interpretace výsledků

Zavřelová J.

Antitrombin

Stanovení funkční aktivity - fotometricky

→ princip

- ➔ 1/ inkubace ředěné vyš. plazmy s nadbytkem
 - trombinu
 - (F Xa)
- ➔ v přítomnosti heparinu
- ➔ za vzniku komplexu
 - trombin -AT-heparin
 - (F Xa - AT - heparin)
- ➔ a zbytkového trombinu (F Xa)

Antitrombin

➔ 2/ stanovení zbytkového

- trombinu
- (F Xa)

➔ pomocí specifického chromogenního substrátu

- end point (A)
- kineticky ($\Delta A/min$)

➔ vyjádření výsledků v %

➔ odečet z kalibrační křivky (lin/lin závislost)

Stanovení antigenu - imunochemicky

➔ - LIA, ELISA, EID

Kalibrace - antitrombin

→ kalibrační materiál

 ➔ komerční

→ vyšetření

 ➔ různých ředění výchozí kalibrační plazmy s
 udanou hladinou antitrombinu

→ kalibrace tří...více bodová

→ závislost lin/lin

Antitrombin - klinický význam

➔ klinický význam

➔ snížení

➔ normální hodnoty: 80 – 120 %

➔ zvýšené hodnoty bez klinického významu(> 120%)

➔ vyšetření dalších ředění vyšetřované plazmy

➔ běžně se neprovádí

➔ jen pro event. snížení vlivu zbarvení plazmy

Antitrombin - klinický význam

- ➔ snížení AT
- ➔ vrozený nedostatek
- ➔ získaný nedostatek
 - ➔ snížená syntéza
 - ➔ zvýšené ztráty
 - ➔ zvýšená spotřeba (DIC, TEN, rozsáhlé operace)
 - ➔ jiné příčiny (těhotenství, kontraceptiva)

D-Dimery

Specifické štěpné produkty fibrinu

→ marker aktivace koagulace i fibrinolýzy

→ metody semikvantitativní

➔ latexaglutinační (hemaglutinační)

➔ imunofiltrace

→ metody kvantitativní

➔ LIA

➔ ELISA

➔ EID

Kalibrace – LIA D-Dimery

→ vyšetření

- ➔ více standartních materiálů s různým hladinou D-Di
- ➔ načtení kalibrace čárovým kódem

- kalibrace vícebodová
- závislost nelineární (**polynom**)

→ vyjadřování výsledků **v mg/l** (norma < 0,5 mg/l)

- ➔ klinický význam zvýšení

→ omezení – rozsah kalibrace (např. 0 - 4 mg/l)

- ➔ nutnost provedení **vyšetření dalších ředění**

D-Dimery - klinický význam

→ Zvýšení D-Di

- ➔ TEN, DIC
- ➔ poranění, po operaci
- ➔ zánět
- ➔ primární hyperfibrinolýza
- ➔ trombolytická léčba
- ➔ hepatopatie
- ➔ odvržení transplantovaných štěpů
- ➔ fyziologicky
 - těhotenství, porod, menstruace, fyzická zátěž

D-Dimery - klinický význam

→ Zvýšení D-Di

- ➔ vysoká senzitivita testů
- ➔ nízká specifita testů
- ➔ význam má sledování dynamiky změn

→ Negativní výsledek přínosnější

- ➔ negativní prediktivní hodnota (96-98%)

FDP

Fibrin/fibrinogen degradační produkty

→ průkaz aktivace fibrinogenolýzy / fibrinolýzy

→ metody semikvantitativní

➔ latexaglutinační

- v séru
 - odběr do spec. zkumavek s trombinem a reptilázou
- v plazmě

➔ metody kvantitativní

- LIA
- EID

Stanovení solubilního fibrinu

Komplexy FM/oligomerů s fibrinogenem, FDP

→ průkaz aktivace koagulace

→ metody přímé

➔ parakoagulační

- etanolgelifikační test
- protaminsulfátový test

➔ hemaglutinační

➔ LIA

→ metody nepřímé

➔ fibrinopeptid A... (ELISA)

Etanolgelifikační test

- průkaz přítomnosti solubilních komplexů FM
- parakoagulační test
 - ➔ sledování tvorby gelu po přídavku 50% etanolu k vyšetřované plazmě (20 °C)
- Ovlivnění výsledku
 - ➔ odběr (aktivace) - falešná pozitivita
 - ➔ čas zpracování (do 30 min) - ↑falešná negativita
 - ➔ teplota (20 °C) - ↑ negativní, ↓ pozitivní

EGT - klinický význam

- DIC
- TEN
- sepse
- metastázující karcinomy
- SLE

Monitorování léčby

→ Antikoagulační léčba

➔ kumariny

- PT (INR)

→ Antitrombotická

➔ UFH

- APTT (R)
- (anti Xa, anti IIa)

➔ LMWH

- anti Xa
- (anti IIa)

Stanovení heparinu anti Xa (IIa)

- ➔ Princip: měření schopnosti heparinu katalyzovat inhibici F Xa (IIa) antitrombinem
 - ➔ inkubace ředěné plazmy s nadbytkem F Xa (IIa)
-inhibiční působení komplexu AT-heparin na F Xa (IIa)
 - ➔ měření zbytkového F Xa (IIa) po přídavku chromogenního substrátu
 - ➔ vyjádření výsledků v IU/ml (kIU/l) odečtením z kalibrační křivky
- ➔ Provádění: preventivní/ léčebné podávání LMWH /UFH

Kalibrace heparin antiXa/Ila

→ kalibrační materiál

↳ komerční (pro LMWH a/heparin)

→ vyšetření

↳ 3-4 kalibrační plazmy s udanou různou hladinou
anti Xa (Ila)

→ kalibrace tří...více bodová

→ závislost lin/lin ($\Delta A/\text{min}$ na IU/ml)

→ vyjadřování výsledků IU/ml (kIU/l)

Jiná antitrombotika – anti Xa

→ Bemiparin (Zibor)

- ➔ LMWH s vyšším poměrem antiXa/antilla
- ➔ vyjádření výsledků IU/ml (kIU/l)

→ Fondaparinux (Arixtra)

- ➔ pentasacharid
- ➔ vyjádření výsledků µg/ml (mg/l)

→ Rivaroxaban (Xarelto), Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana)

- ➔ přímé inhibitory F Xa
- ➔ vyjádření výsledků µg/l

Přímá antitrombotika – anti IIa

→ Dabigatran (Pradaxa)

- ➔ přímý inhibitor trombinu (IIa)
- ➔ sledování inhibice konstantního množství trombinu

→ Koagulační metoda (ředěný TT) set Hemoclot Thrombin inhibitors

- ➔ ve směsi ředěné vyšetřované plazmy a normální plazmy
 - koagulační čas je přímo úměrný koncentraci dabigatranu

→ Fotometrická metoda

- ➔ v ředěné vyšetř. plazmě po přídavku chromogenního substrátu
 - $\Delta A/min$ je nepřímo úměrná koncentraci dabigatranu

→ Vyjádření výsledků $\mu\text{g/l}$

Kalibrace jiná antitrombotika

→ kalibrační materiál

- ➔ komerční pro jednotlivé léky (s výjimkou Ziboru)

→ vyšetření

- ➔ 3-4 kalibrační plazmy s udanou různou hladinou léku

→ kalibrace tří...více bodová

→ závislost lin/lin

- ➔ antiXa $\Delta A/min$ na IU/ml, mg/l, $\mu g/l$..

- ➔ antilla sec/ $\mu g/l$, $\Delta A/min/ \mu g/l$

Globální testy

- Doba krvácení
- Euglobulinová lýza
- Analýza PFA
- Trombelastografie
- TGA
- Konzumpce protrombinu
- Doba srážlivosti
- Rekalcifikační čas

Doba krvácení

Globální test primární hemostázy

- měří se doba, za kterou dojde k zástavě krvácení v místě dle možnosti standardního vpichu nebo řezu
- metoda dle Duke - standardní řez do ucha
 - ➔ norma < 270 s
- metoda dle Ivyho - řez na předloktí pomocí firemních nožíků při zatažení paže tonometrem na 40 mm Hg sloupce
 - ➔ např. Surgicutt norma 120 - 480 s

Doba krvácení - klinický význam

Prodloužení DK

- trombocytopenie
- trombocytopatie
- von Willebrandova choroba
- porucha cévní stěny
- afibrinogenémie
- ovlivnění léky (salicyláty)

Euglobulinová lýza

Globální test fibrinolytického systému

→ měří se čas potřebný k rozpuštění koagula euglobulinové frakce (EF) plazmy (norma > 180min)

➔ příprava EF plazmy precipitací vyšetř. plazmy za specifických podmínek (pH = 5,2)

- EF se skládá z fibrinogenu, fibrinolytických enzymů a z protrombinu (ev. trombinu), neobsahuje inhibitory fibrinolýzy

➔ rozpuštění precipitátu (zvýšením pH)

➔ vznik koagula EF po přídavku Ca^{2+}

➔ sledování rozpouštění koagula (cca po 15 min)

Euglobulinová lýza

Ovlivnění výsledku:

- odběr
 - ➔ aktivace
- čas zpracování
 - ➔ do 30 minut
- koncentrace fibrinogenu
 - ➔ hypofibrinogenémie
- rozpuštění precipitátu

Euglobulinová lýza- klinický význam

→ zkrácení

- ➔ DIC (sekundární hyperfibrinolýza)
- ➔ primární hyperfibrinolýza
- ➔ trombolytická léčba
- ➔ cirhóza
- ➔ zvýšená duševní a tělesná zátěž
- ➔ novorozenecký syndrom

→ prodloužení

- ➔ podezření na hyperkoagulaci

Tromboelastometrické vyšetření

- kontinuální monitorování procesu krevního srážení a následné lýzy v podobě grafického záznamu = tromboelastogramu
- klasická tromboelastometrie
 - ➔ sledování oscilace kyvety se srážlivou krví, ve které je zavěšen trn připojený k indikátoru světla
- rotační tromboelastometrie
 - ➔ sledování oscilace trnu v pevné kyvetě s krví

Rotační tromboelastometr




Tromboelastometrie


krev



aktivátor

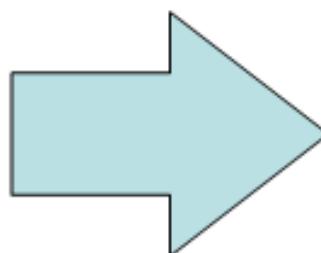


Kontinuální
sledování pevnosti
krevní sraženiny

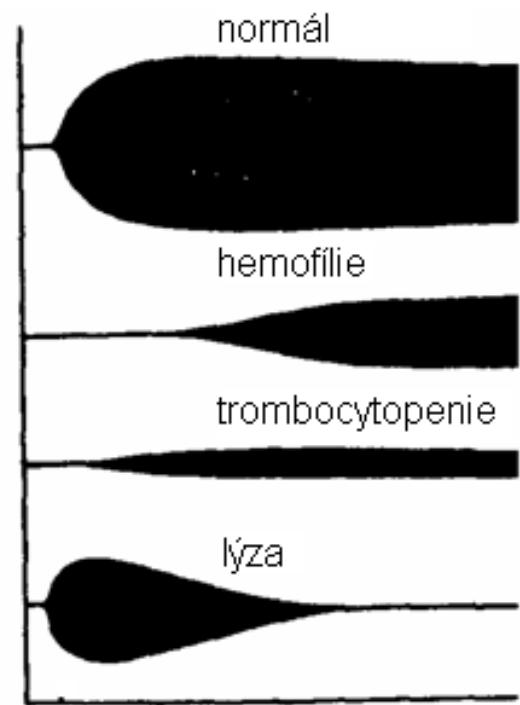

Tromboelastometrie

- schopnost krevní sraženiny tvořit mechanické spojení mezi kyvetou a trnem
- rotační pohyb (kyvety nebo trnu)
 - ➔ brzděný tvořící se krevní sraženinou
 - ➔ je převáděn na amplitudu
 - ➔ je mírou pevnosti sraženiny
- záznam amplitud v čase
 - ➔ trombelastograf
 - ➔ symetrická křivka
 - nad a pod základní linií

roTEM analýza: parametry

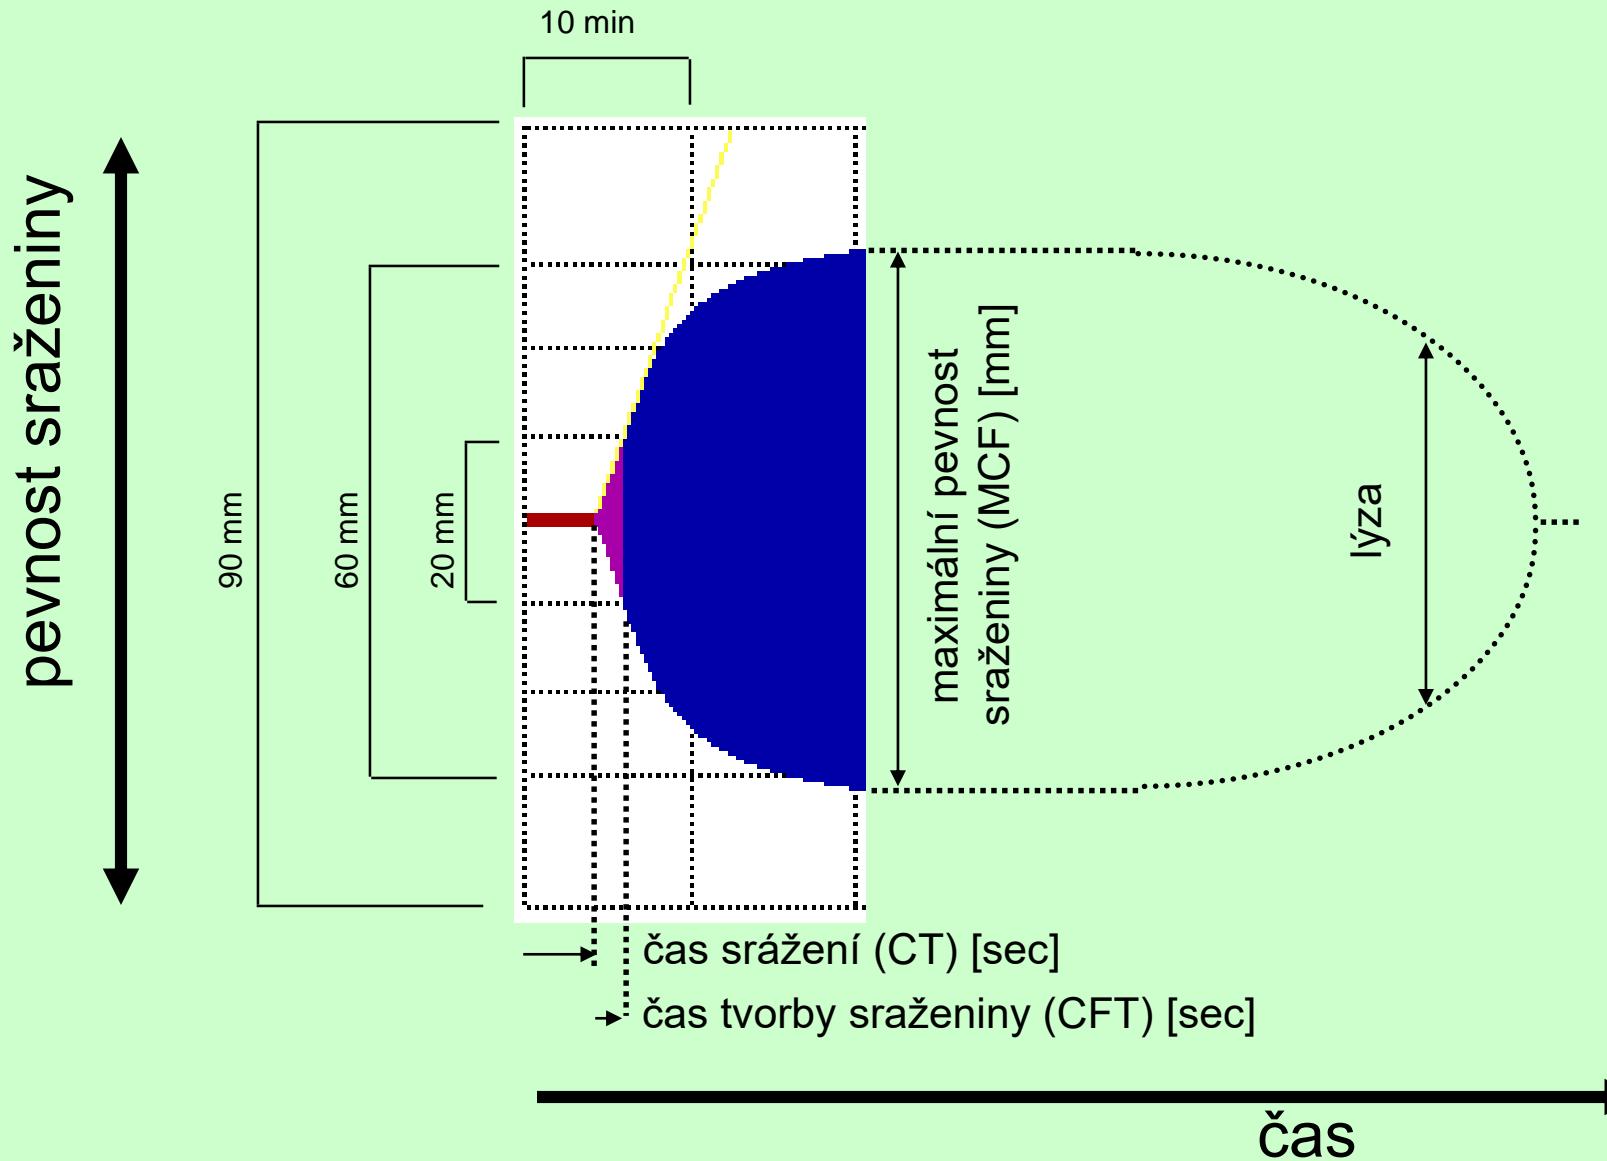

Klinický význam TEM

→ Poskytuje informaci o

- ➔ tvorbě trombinu indukované aktivací vnějšího nebo vnitřního koagulačního systému
- ➔ obsahu fibrinogenu a trombocytů
- ➔ odpovídající polymerizaci sraženiny
- ➔ rozpouštění fibrinu

→ Výhody

- ➔ jednoduchost provedení vyš. z plně citrátové krve
- ➔ dostupnost výsledku v krátkém časovém intervalu


→ Nevýhody

- ➔ použití k hrubé orientaci o stavu hemostázy
- ➔ zejména k akutní analýze na operačních sálech a jednotkách intenzivní péče

Vyšetření PFA

- kvantitativní měření primární hemostázy zahrnující adhezi, degranulaci a tvorbu hemostatické zátky měřené v citrátové plné krvi
- sledování tvorby destičkového trombu, který postupně vyplňuje otvor v membráně
 - ➔ potažené bud kolagenem a epinefrinem
 - ➔ nebo kolagenem a ADP
- výsledek je čas potřebný k dosažení kompletního uzávěru otvoru membrány

Vyšetření PFA

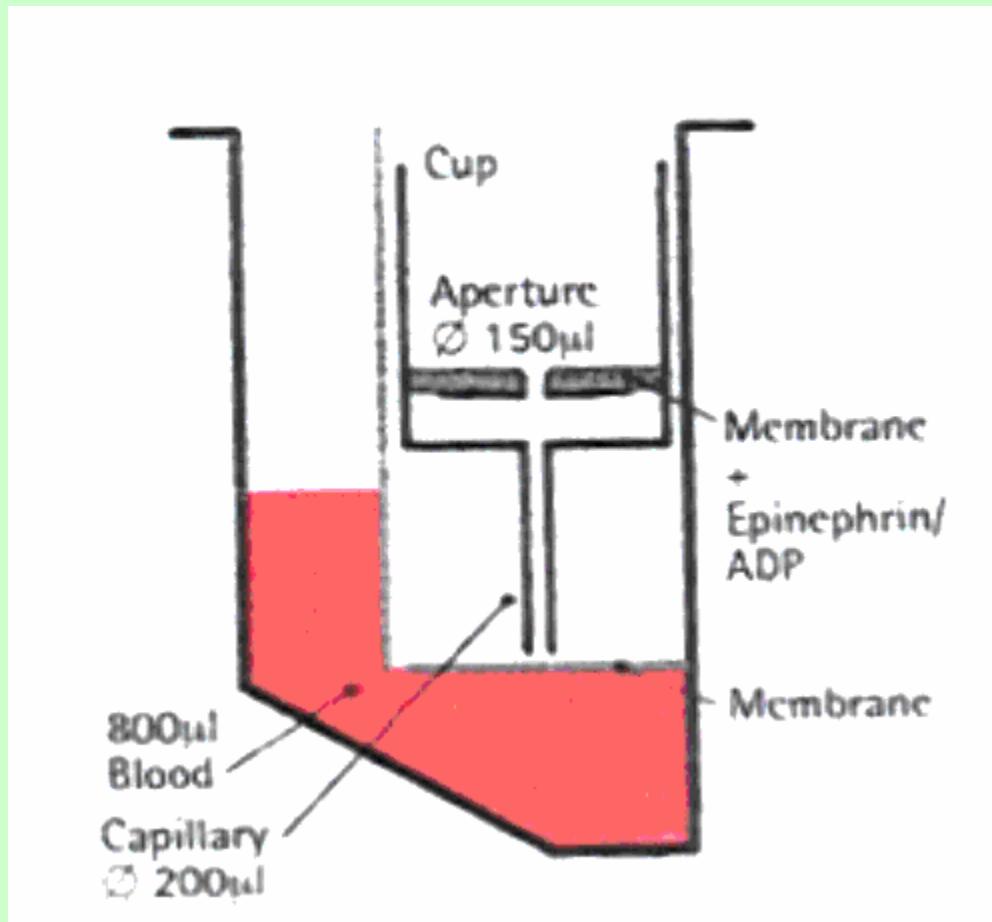

Vyšetření PFA

SIEMENS

PFA-100® Princip testu

In Vivo hemostáza

Endotel
Kolagenová vlákna
vWF
Fibrinogen
Trombocyty
Erythrocyt

PFA-100®

- 40 mbar
Epinephrin nebo ADP
otvor 150µm
Membrána
kolagen vWF
průtok
kapilára 200µm
Erytrocyt
Trombocyt

PFA - klinický význam

- přeoperační screening
- diagnostika vrozených a získaných trombocytopenií
- diagnostika vWF choroby (typ 1)
- sledování účinnosti léčby

Trombin generační test (TGT, TGA)

→ Globální test hemostázy

- ➔ speciální přístroj **fluorometr**
- ➔ vyšetření citrátové plazmy (PPP nebo PRP)

→ Princip

- ➔ k vyšetř. plazmě je přidán **fluorogenní substrát**
- ➔ **trombin** vznikající aktivací koagulační kaskády směsí PL (jen u PPP), TF a Ca^{2+} přeměňuje fluorogenní substrát na fluorofor, jehož signál je zaznamenáván fluorometrem
- ➔ při měření pacienta musí být použit **trombinový kalibrátor**




Ceveron®Alpha
(Technoclone,
Medista)



Grafické znázornění průběhu TGA

- Lag Phase (iniciační fáze) [min]
čas aktivace koagulačního systému
- Peak time [min]
- Peak Thrombin (výška píku) [nM]
maximální koncentrace trombinu
- Velocity Index (Slope) [nM/min]
strmost křivky=peak thrombin / peak time
- Inactivation phase
pokles tvorby trombinu
- Area Under the Curve (AUC – plocha pod křivkou) [nM]
celkové množství vygenerovaného trombinu

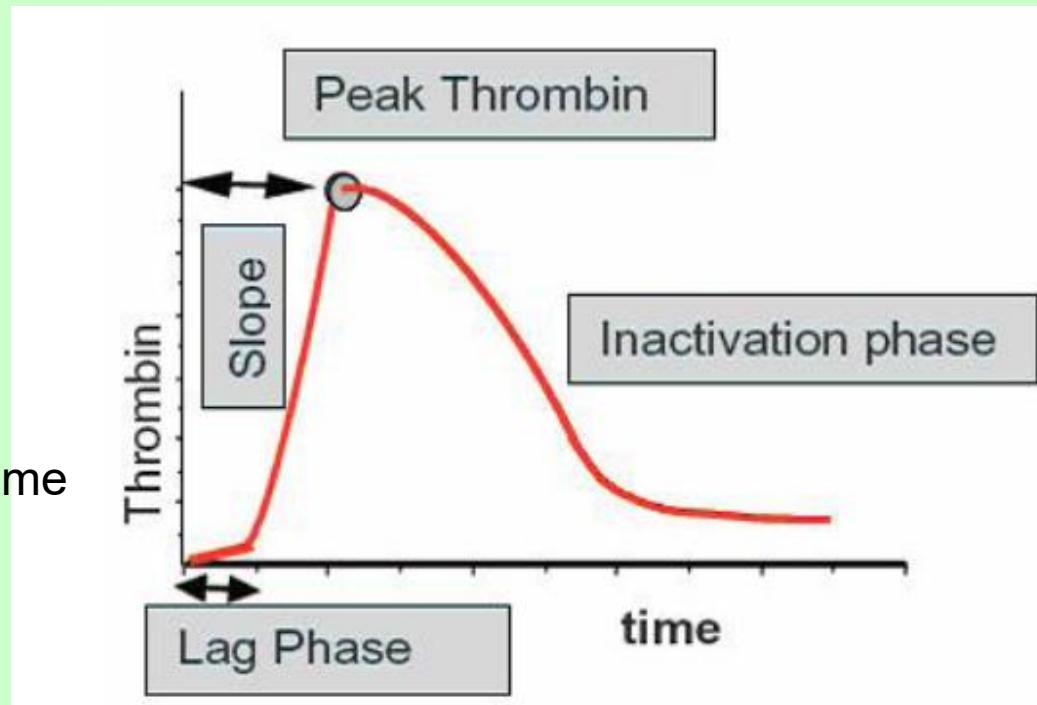


TGT – klinický význam


- ➔ vhodná metoda pro posouzení globální funkce hemostázy
- ➔ získání úplného obrazu trombotické či krvácivé tendencie u pacientů
 - ➔ s vysokým rizikem trombózy
 - ➔ s vysokým rizikem krvácení přínosná při
- ➔ využití při monitorování léčby hemofiliků s inhibitorem, monitorování antikoagulační léčby


Konzumpce protrombinu


- vyšetření destičkové i plazmatické funkce krve
- stanovuje se zbytkové množství protrombinu v séru po vysrážení krve za standartních podmínek
 - ➔ odběr (3 skleněné zkumavky, množství krve)
 - ➔ zpracování (ihned po odběru)
 - ➔ 4 hodiny 37 °C
 - ➔ vlastní vyšetření zbytkového protrombinu v séru
 - inkubace séra s Ca²⁺tromboplastinem
 - stanovení koagulačního času po přídavku fibrinogenu (norma > 30 s)


Interpretace základních koagulačních testů

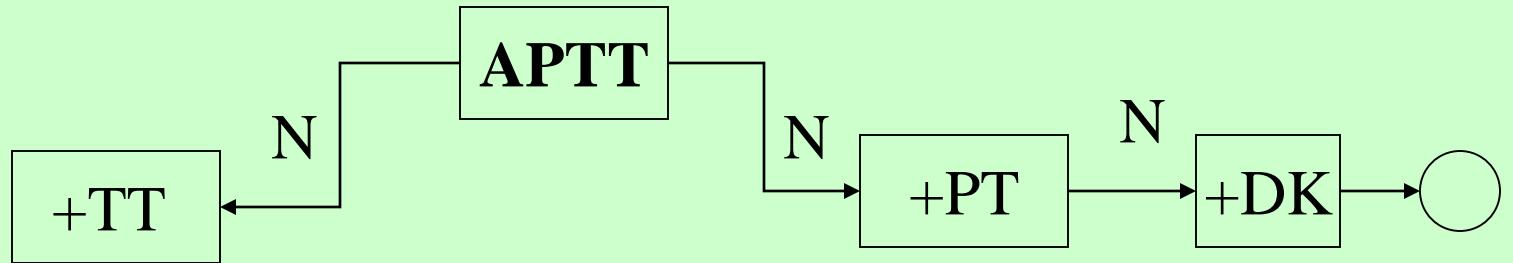


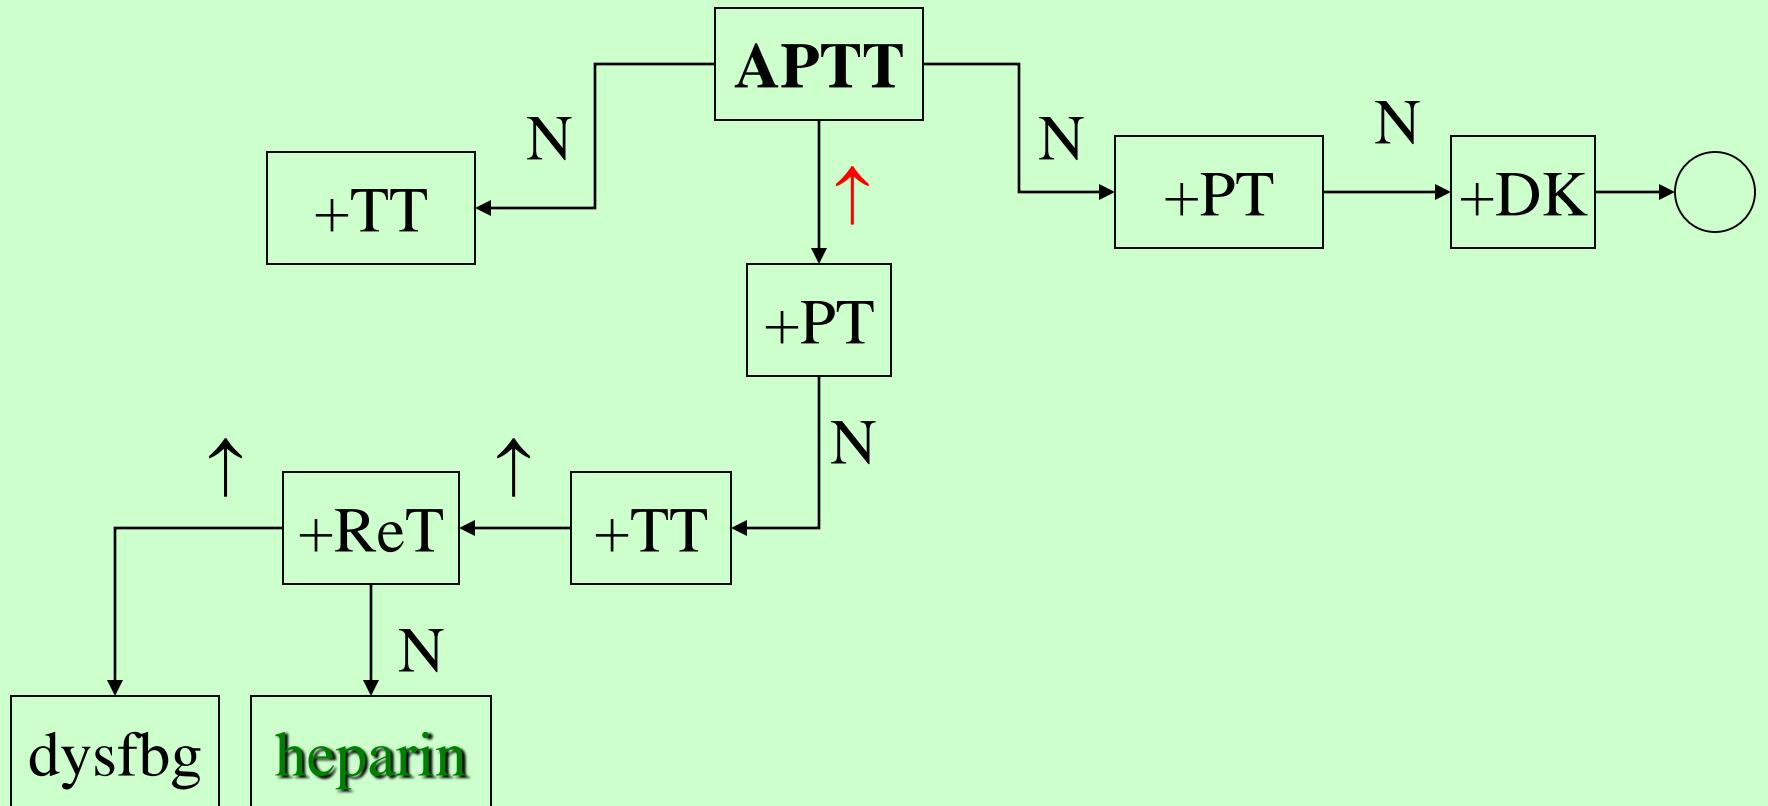

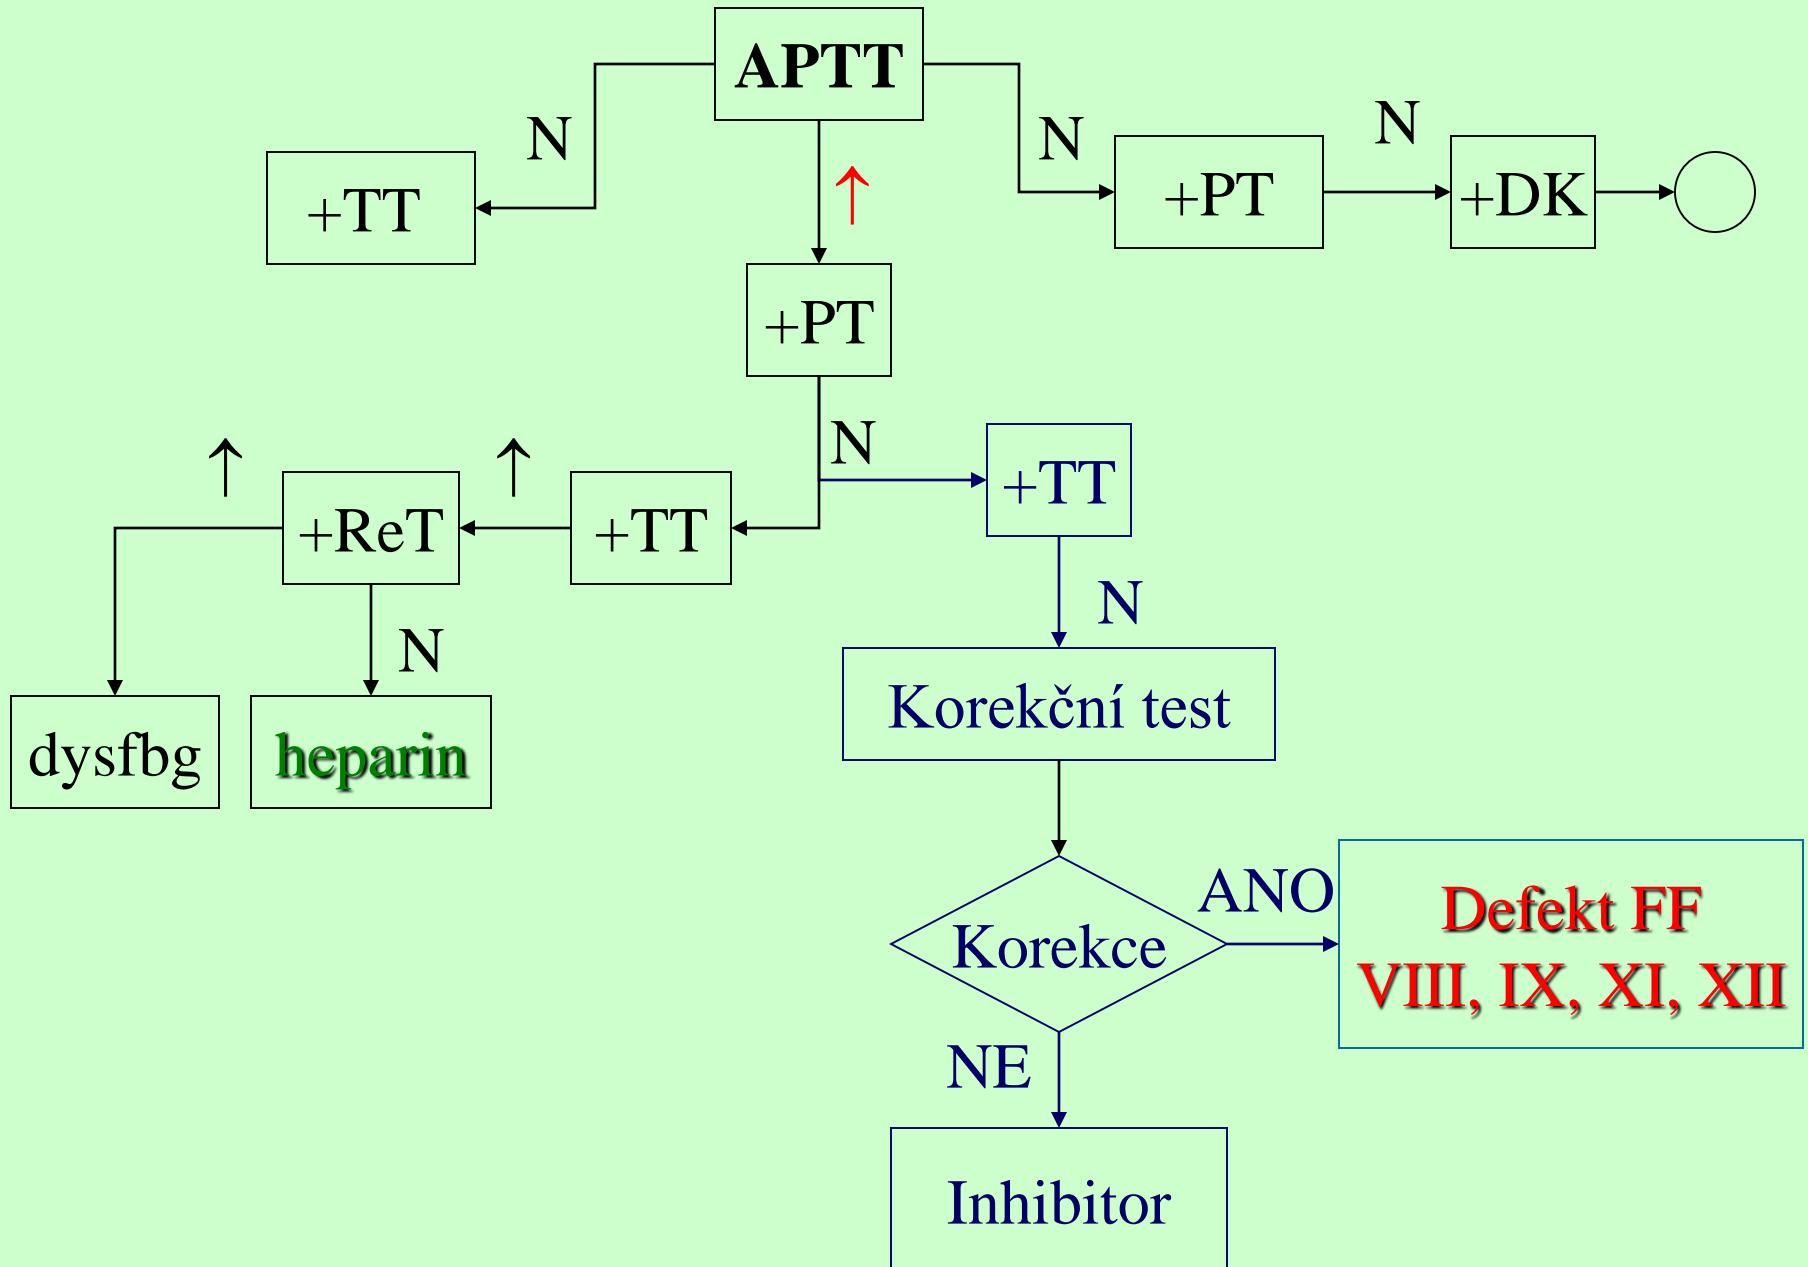

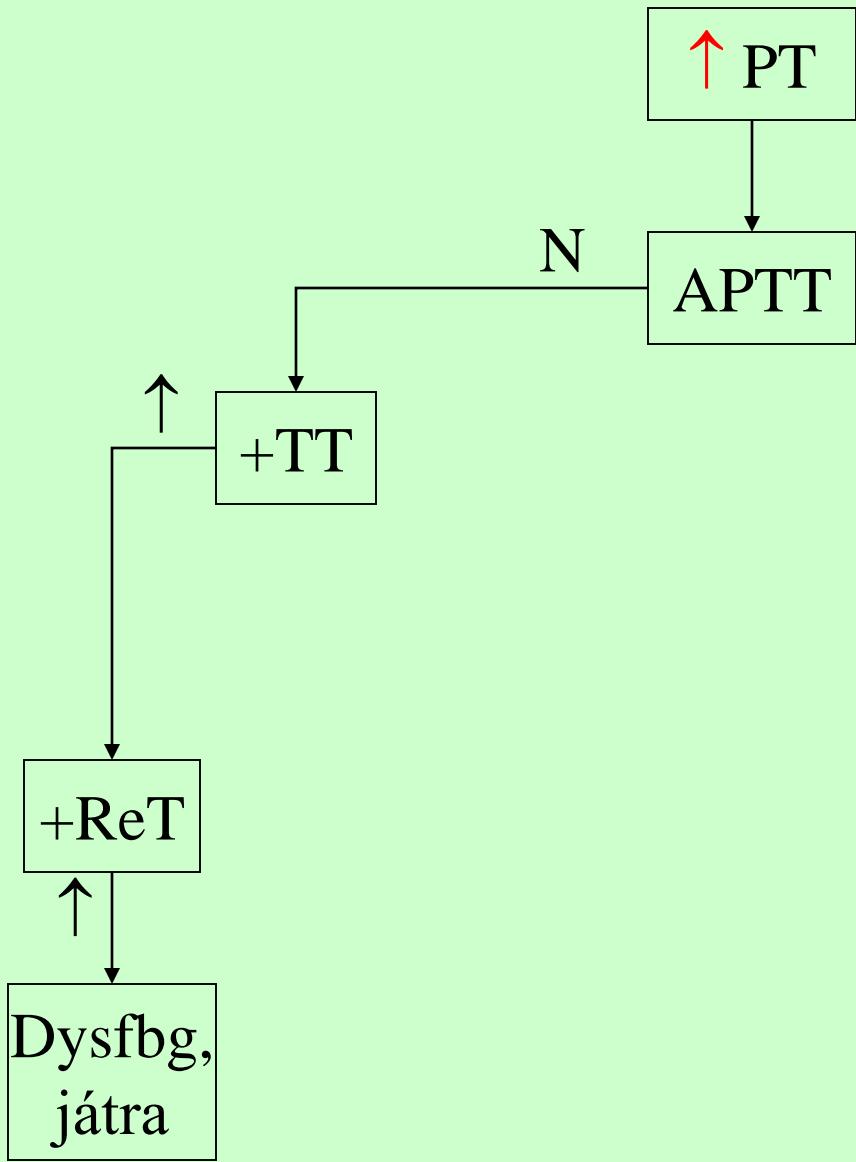

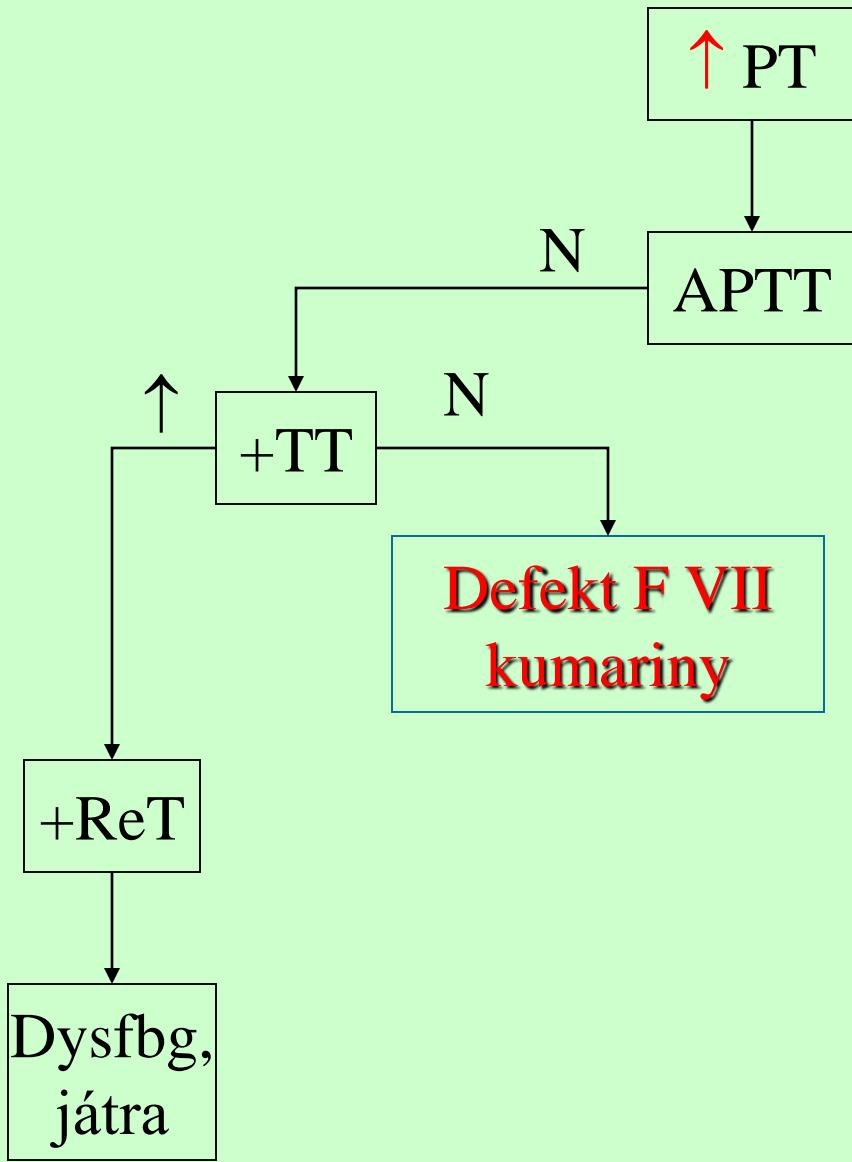

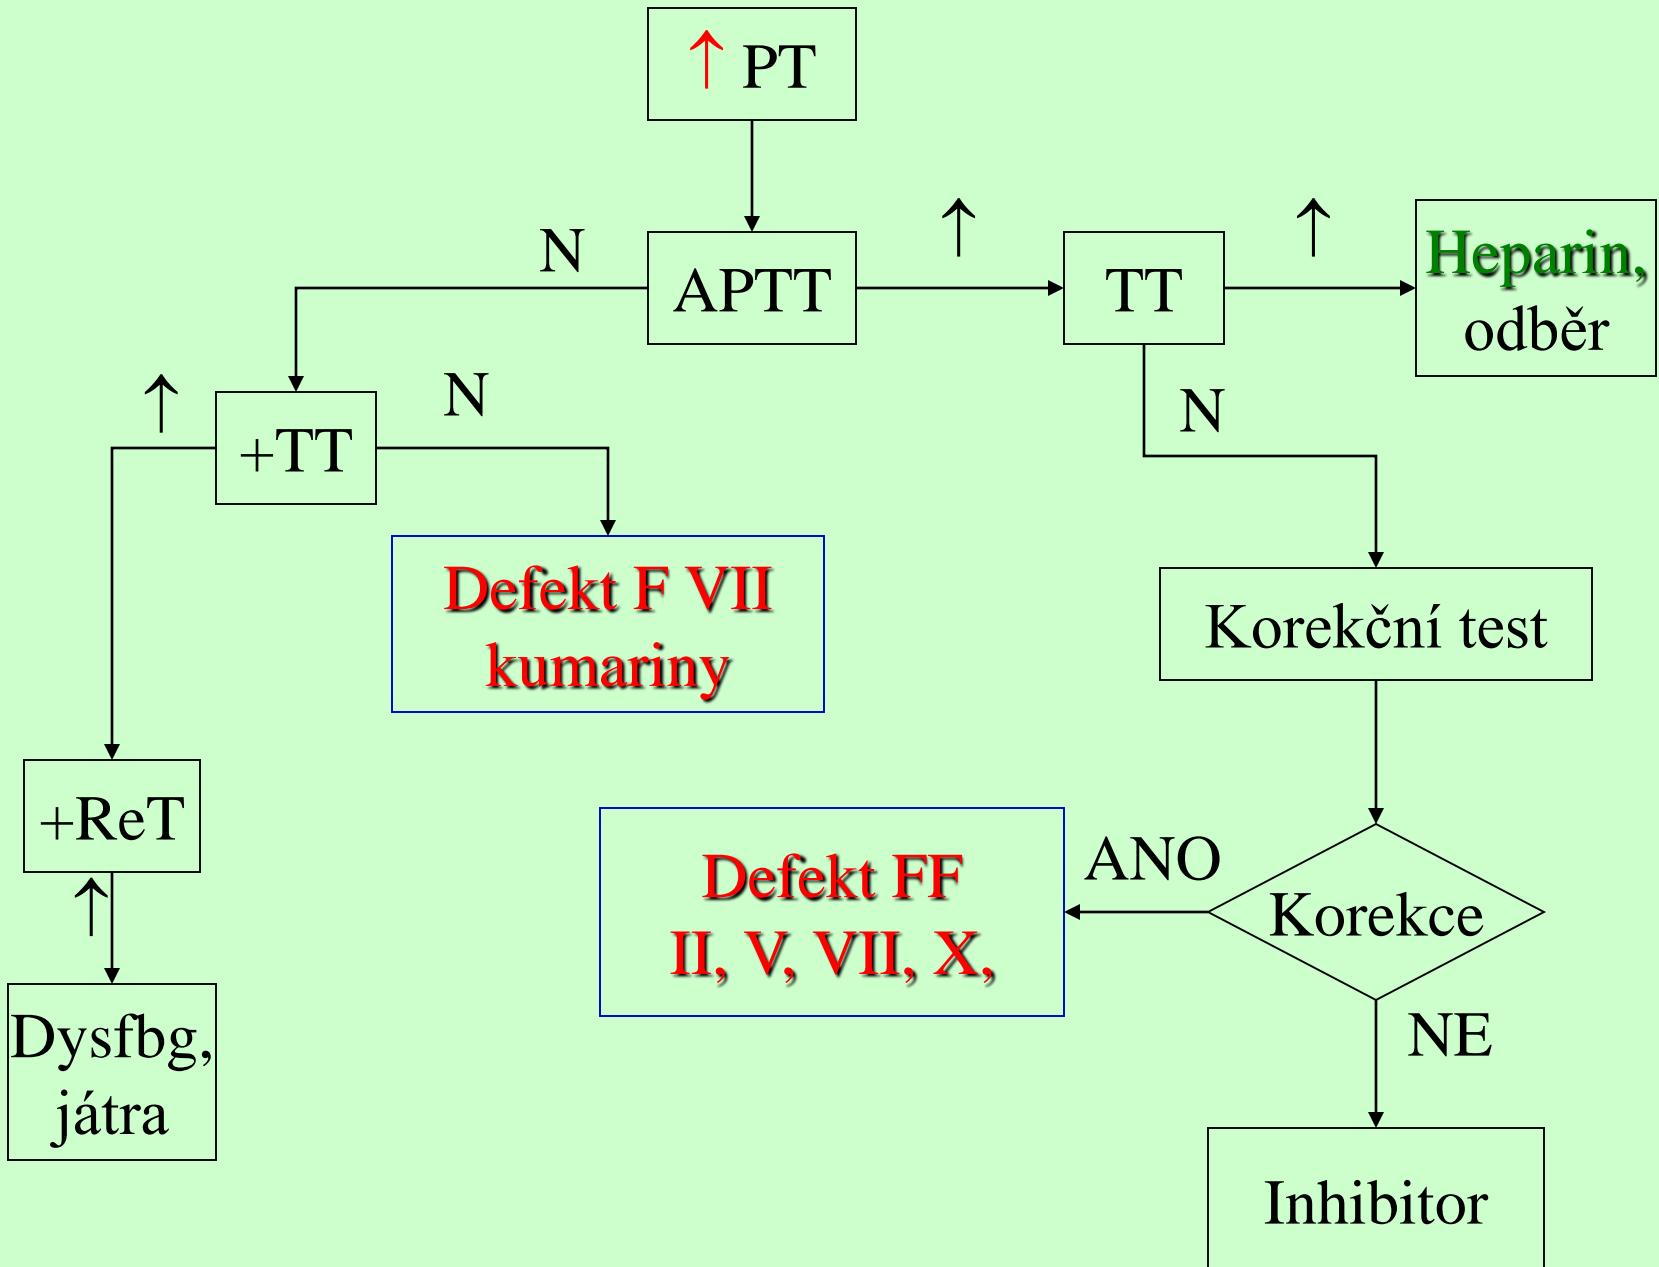

Prodloužené PT

APTT

prodloužené

Trombinový čas

prodloužené

viz.TT

v normě

v normě

deficit F VII

zahájení léčby kumariny

Korekční test

korekce

vrozený deficit
FF II,V,X


získaný deficit


částečně/bez korekce

FF II,V, VII,X
(jater. choroby, DIC)

FF II,VII,X a V v normě
(kumariny, deficit vit.K,
jater. choroby, DIC)

inhibitor:
specifický
nespecifický

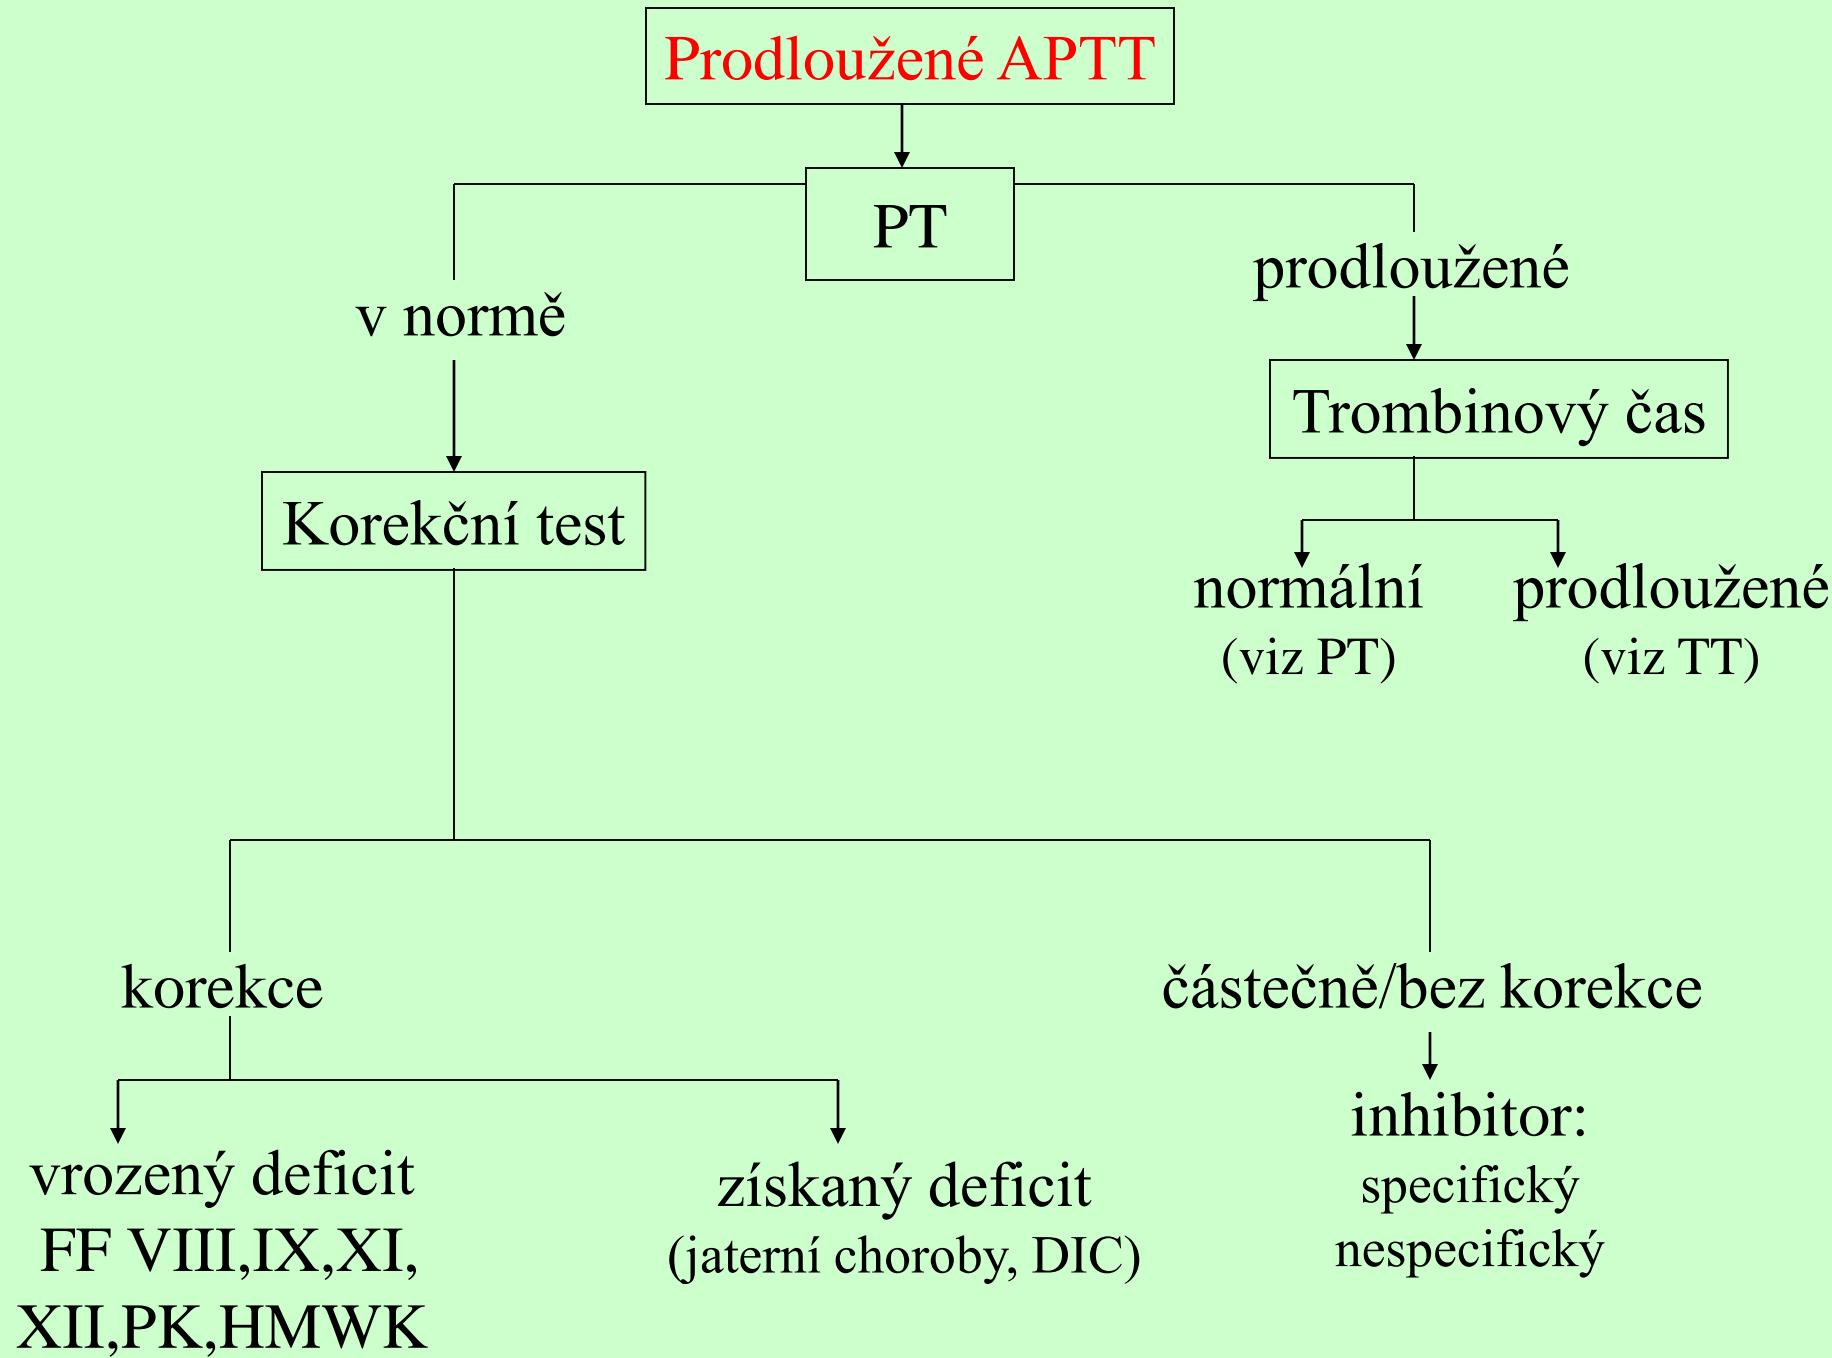

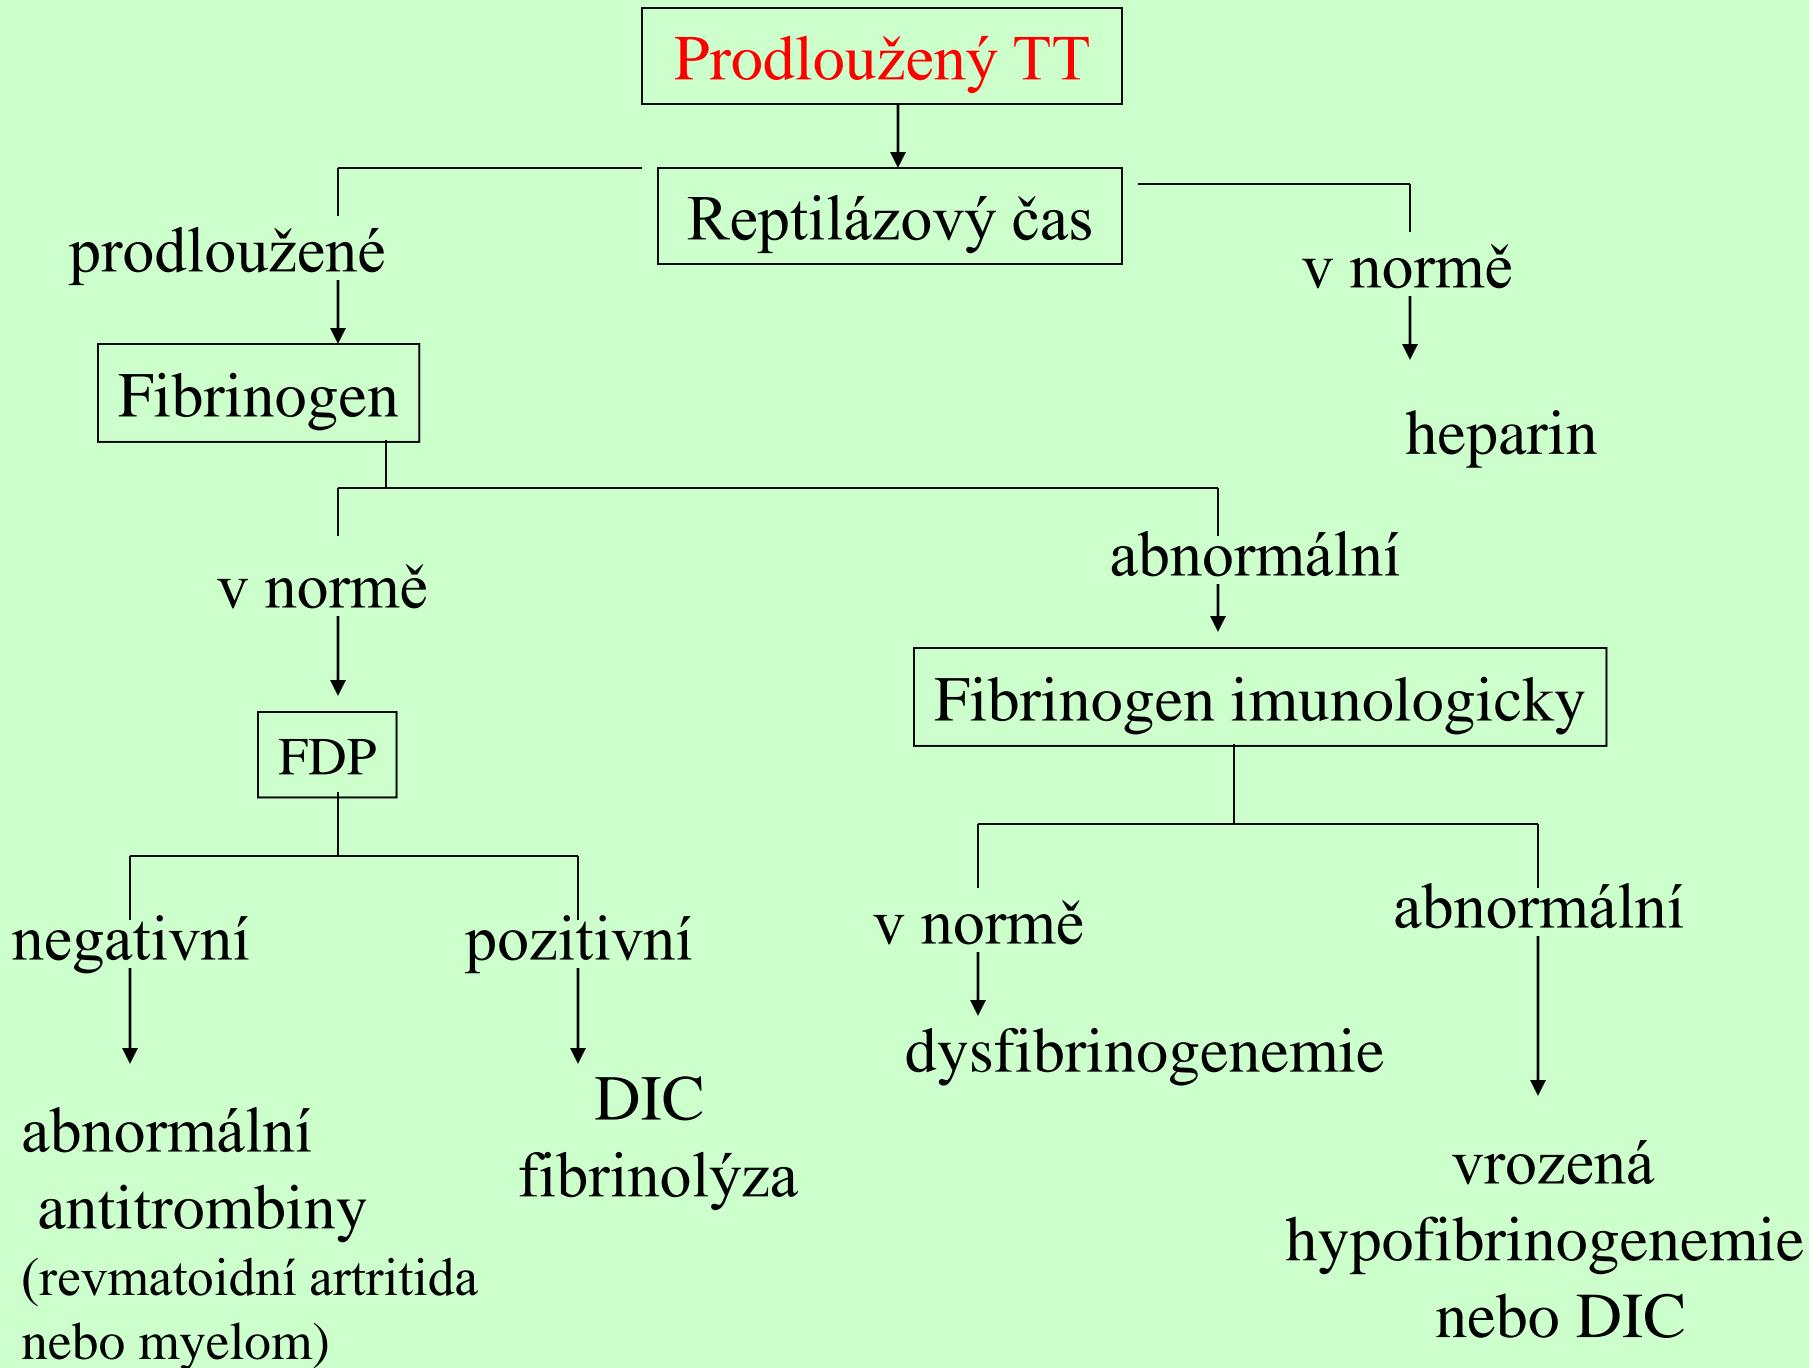

Prodloužená DK

Počet trombocytů

zvýšený

v normě

snížený

Trombocytóza

APTT

Trombocytopenie

v normě

prodloužené

Funkce trombocytů

v normě

abnormální

v normě

abnormální

izolované
prodloužení DK

dysfunkce
trombocytů

vWF

dys-, hypo-, afi-
fibrinogenemie

variabilní

„varianty“ vWF choroby

abnormální

von Willebrandova choroba

PT
norma

APTT
norma

TT
norma

→ A) + **trombo** i **DK** norma

Příčiny:

- ➔ inic. DIC

Doplňující vyšetření:

- ➔ AT

→ B) +↑DK, **trombo** norma

Příčiny:

- ➔ v.Willebr. choroba
- ➔ trombastenie, jiné trombocytopatie

Doplňující vyšetření:

- ➔ F VIII, vWF:RCO/Ac, vWF:Ag
- ➔ funkce trombo

→ C) +↓ **trombo**, DK N/↑

Příčiny:

- ➔ trombocytopenie
- ➔ trombocytopatie
- ➔ inic. DIC

Doplňující vyšetření:

- ➔ počet trombo
- ➔ vyšetření funkce trombo

PT

patol

APTT

norma

TT

norma

Příčiny:

- ➔ snížení F VII
- ➔ snížení FF protrombin.
komplexu
- ➔ kumariny
- ➔ novorozenecký

Doplňující vyšetření:

- ➔ F VII
- ➔ anamnéza, další vyš.
(biochem.)
- ➔ anamnéza

PT

norma

APTT

patol

TT

norma

Příčiny:

- ➔ snížení FF F VIII,IX,XI,XII
- ➔ v.Willebr. choroba
- ➔ specifický/nespecifický inhibitor
- ➔ novorozenecký

Doplňující vyšetření:

- ➔ F VIII, IX, XI, XII
- ➔ F VIII,VWF:RCo/Ac,VWF:Ag
- ➔ průkaz inhibitoru

PT

norma

APTT

norma

TT

patol

Příčiny:

- ➔ heparin
- ➔ poruchy polymerizace fibrinu
- ➔ dysfibrinogenémie

Doplňující vyšetření:

- ➔ reptilázový čas
- ➔ fibrinogen, FDP
- ➔ fibrinogen (LIA)

PT

patol

APTT

patol

TT

norma

Příčiny:

- ➔ komplexní koag. porucha
různé geneze
- ➔ snížení FF II, V, X
- ➔ inhibitor F V
- ➔ léčba kumariny
- ➔ novorozenecký

Doplňující vyšetření:

- ➔ fibrinogen, trombocyty,
D-Dimery, bioch.
- ➔ F II, V, X
- ➔ průkaz inhibitoru
- ➔ anamnéza

PT

patol

APTT

norma

TT

patol

Příčiny:

- ➔ kombinovaná koagulopatie

Doplňující vyšetření:

- ➔ fibrinogen, FF, FDP, biochemie

PT

norma

APTT

patol

TT

patol

Příčiny:

- ➔ heparin
- ➔ kombinovaná koagulopatie

Doplňující vyšetření:

- ➔ reptilázový čas
- ➔ FF, fibrinogen

Interpretace výsledků

	Heparin UFH	Kumariny	Defekt FF vnitř.syst.	Defekt F VII	Defekt FF II,V, X
PT	N, (↑)	↑↑	N	↑	↑
APTT	↑	↑	↑	N	↑
Fbg	N	N	N	N	N
TČ	↑↑	N	N	N	N