

# ELISA

---

Enzyme-linked immunosorbent assay

*David Zeman*

# ELISA – historie

první neizotopová varianta imunoanalýzy

---


- E. Engvallová, P. Perlmann (Švédsko) 1971: Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Quantitative assay of immunoglobulin G. *Immunochemistry* 8: 871-874. *Pozn.: stejně jako R. Yalowová a S. A. Berson v případě RIA (1959) si princip nedali patentovat (významné historické memento, zejména pro dnešní dobu!)*
- S. Avraemas, B. Guilbert (Francie) 1971: A method for quantitative determination of cellular immunoglobulins by enzyme-labeled antibodies. *Eur J Immunol* 1: 394-396.

# ELISA – charakteristika, varianty

---

- Heterogenní imunoanalytická metoda
- Jeden z imunoreaktantů je zakotvený na pevnou fázi (**immunosorbent**), zpravidla stěny jamek mikrotitrační destičky (96 jamek – řádky A-H, sloupce 1-12)
- Jeden z imunoreaktantů je značený enzymem (**E**nzyme-linked)
- V posledním reakčním kroku je přidán substrát pro příslušný enzym
- Koncentrace analytu je úměrná množství vzniklého produktu, který poskytuje signál
- Sendvičová (nejčastěji, nejnižší detekční limit; typicky přímá úměra mezi koncentrací analytu a signálem)
- Kompetitivní (přímá/nepřímá; typicky nepřímá úměra mezi koncentrací analytu a signálem)

## Schéma pracovního postupu sendvičové (vlevo) a kompetitivní (vpravo) ELISA

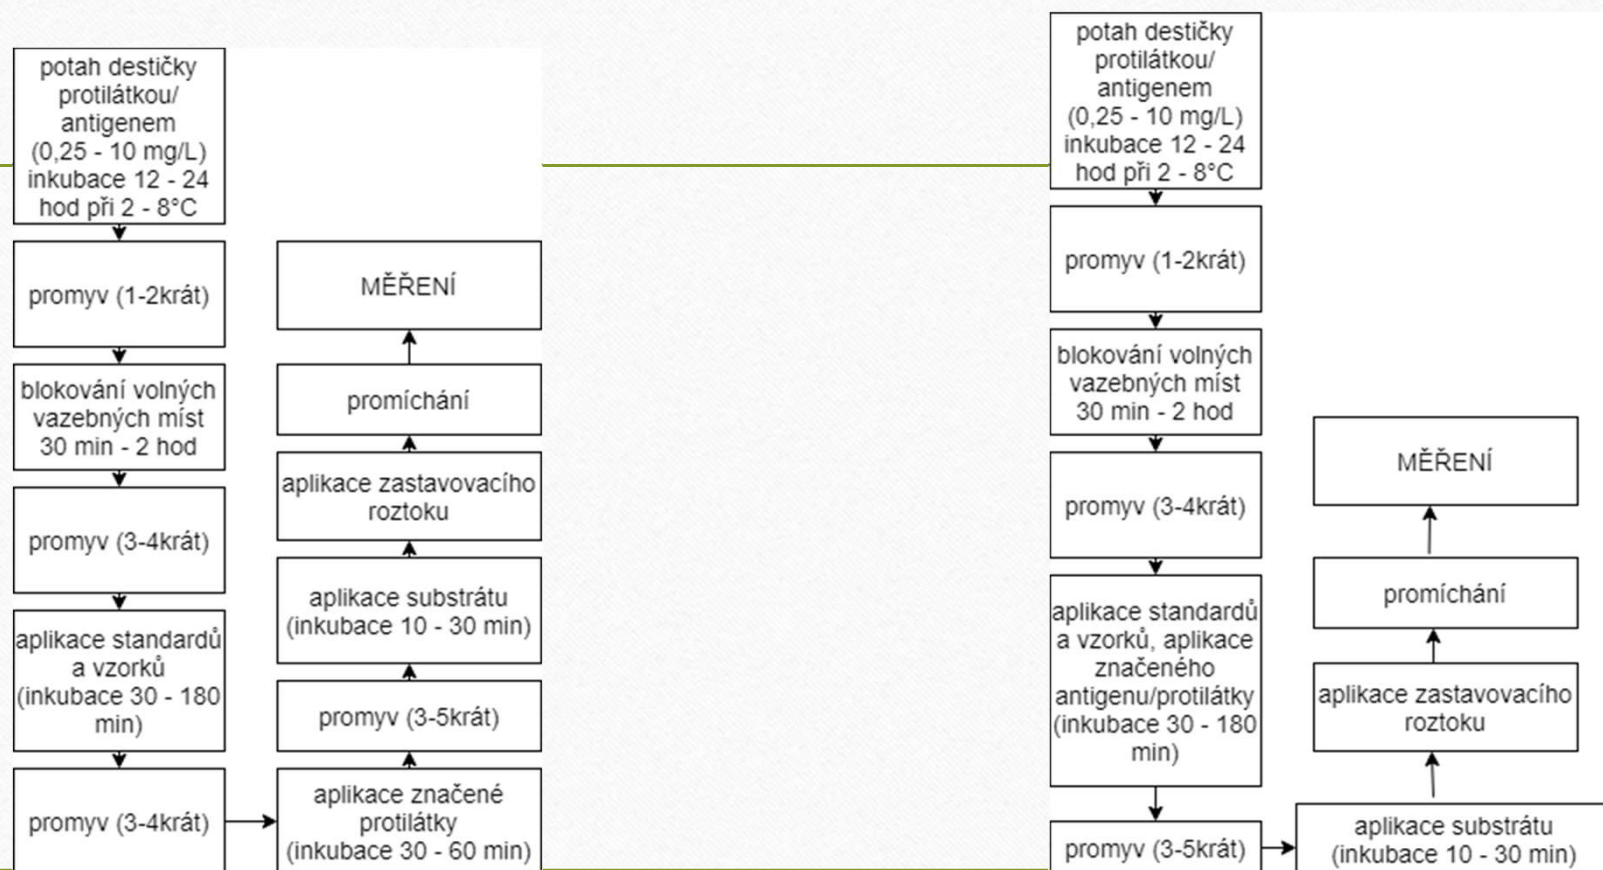

# Amplifikace signálu: systém biotin-(strept)avidin

---

- Protilátka značená biotinem (M.h. 244 Da) lze snadno konjugovat s proteiny v místě jejich volných aminoskupin); na jednu molekulu protilátky se může vázat několik molekul biotinu → amplifikace signálu
- Konjugát avidin (M.h. 68 kDa)-HRP nebo streptavidin-HRP
- Interakce (nekovalentní) avidinu s biotinem je velmi silná ( $K_d = 10^{-15}$  mol/L)
- 1 molekula avidinu (streptavidinu) obsahuje 4 vazebná místa pro molekulu biotinu
- Vaječný avidin je glykoprotein o  $pI$  10,5 – cave nespecifické elektrostatické interakce
- Streptavidin (ze *Streptomyces avidinii*) –  $pI$  v neutrální oblasti, neobsahuje sacharid
- Neutrální avidin – částečné odstranění sacharidů a snížení  $pI$  – redukce nespecifických vazeb
- Bližší informace viz katalogy produktů, např. firma Vector Laboratories, [www.vectorlabs.com](http://www.vectorlabs.com)

## Roztoky pro ELISA testy

Použití roztoku	Název roztoku	složení
Potah destičky	PBS pH 7,4	NaCl 8,0 g; KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 0,2 g; Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 1,1 g; KCl 0,2 g; H <sub>2</sub> O ad 1 L
	Na-karbonátový pufr, pH 9,6	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 1,6 g; NaHCO <sub>3</sub> 2,4 g; H <sub>2</sub> O ad 1 L
	0,1M bikarbonátový pufr, pH 9,6	NaHCO <sub>3</sub> 8,4 g; H <sub>2</sub> O ad 1 L
Promývání	PBS/Tween 20 0,05%, pH 7,4	Tween 20 0,5 mL; PBS ad 1 L
	Fyziologický roztok/Tween 20 0,1%, pH 7,5	NaCl 9,0 g; Tween 20 1,0 mL; H <sub>2</sub> O ad 1 L
Blokování volných vazebných míst	PBS/BSA 2%, pH 7,4	BSA 2g; PBS ad 100 mL
	PBS/kasein 0,1%, pH 7,4	Kasein 0,1 g; PBS ad 100 mL
	PBS/sušené mléko 2%, pH 7,4	Sušené mléko 2 g; PBS ad 100 mL

# Enzymy a substráty

Enzym	M.h. (kDa)	pH optimum	substrát	Detekční limit pro enzym (mol/L)	Detekční limit pro enzymem značený IgG (µg/L)
Křenová peroxidasa (HRP) EC 1.11.1.7	44	5 - 7	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> /ABTS (c)	10 <sup>-13</sup>	16,0
			H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> /oPD (c)	10 <sup>-14</sup>	2,0
			H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> /TMB (c)	2·10 <sup>-15</sup>	0,3
			H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> /HPPA (f)	10 <sup>-15</sup>	0,3
Alkalická fosfatasa (ALP) EC 3.1.3.1	86 (druhá odlišnost – 58 /garnát/ až 140 /skot/)	9 - 10	pNPP (c)	2·10 <sup>-13</sup>	43,0
			MUP (f)	2·10 <sup>-13</sup>	0,5
β-galaktosidasa EC 3.2.1.23	465,4 (homotetramer)	6 – 8	oNPG (c)		350,0
			MUG (f)		1,0
Glukosaoxidasa EC 1.1.3.4	160	4 - 7	S peroxidasou spřažená reakce; přídavek glukosy, peroxidasy a substrát pro peroxidasu		

(c) = chromogenní, (f) = fluorogenní substrát. ABTS = 2,2'-azino-di(3-ethylbenzthiazolin)-6-sulfonát; HPPA = kyselina 3-(*p*-hydroxyfenyl)propionová; MUG = 4-methylumbelliferyl-β-D-galaktopyranosid; MUP = 4-methylumbelliferylfosfát, oNPG = *o*-nitrofenyl-β-D-galaktopyranosid; oPD = *o*-fenylendiamin, pNPP = *p*-nitrofenylfosfát; TMB = 3,3',5,5'-tetramethylbenzidin

## Substrát – zastavovací roztok - měření

Substrát	Stop roztok	Vlnová délka měření
ABTS	1M kyselina citrónová + 0,05% NaN <sub>3</sub>	405 nm
oPD	2,5M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	490 nm
TMB	2,0M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	370 nm (bez stop roztoku) 450 nm (po zastavení reakce)
pNPP	3M NaOH	405 nm
oNPG	1M Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	405 nm



# Nelineární kalibrace

---

- Závislost koncentrace stanovované látky na signálu získaném v ELISA testu (zpravidla optické denzity) NENÍ lineární
- V každé analytické sérii je nutné zařadit několik standardů (nejméně 4)
- Existuje několik modelů kalibrační závislosti:
  - point-to-point: jednotlivé body kalibrační křivky jsou propojeny úsečkami
  - 4-parametrová (popř. 5-parametrová) – sigmoida
  - kvadratická funkce
  - kubická funkce

## Nelineární kalibrace – kvadratický polynom, kubický polynom a 4-parametrová logistická funkce

---


- $OD = a + b \cdot conc + c \cdot conc^2$
- $OD = a + b \cdot conc + c \cdot conc^2 + d \cdot conc^3$
- $OD = \frac{a-d}{[1+(conc/ )^b]} + d$

V polynomech jsou  $a$ ,  $b$ ,  $c$  a  $d$  koeficienty.

Ve 4-parametrovém modelu je  $a$  dolní asymptota,  $b$  směrnice v inflexním bodě,  $c$  koncentrace v inflexním bodě a  $d$  horní asymptota.

$OD$  je optická denzita,  $conc$  je koncentrace analytu.

# Zjednodušené schéma ELISA testů pro detekci volných lehkých řetězců typu kappa ( $\kappa$ LC): nepřímá kompetitivní (vlevo); sendvičová (vpravo)

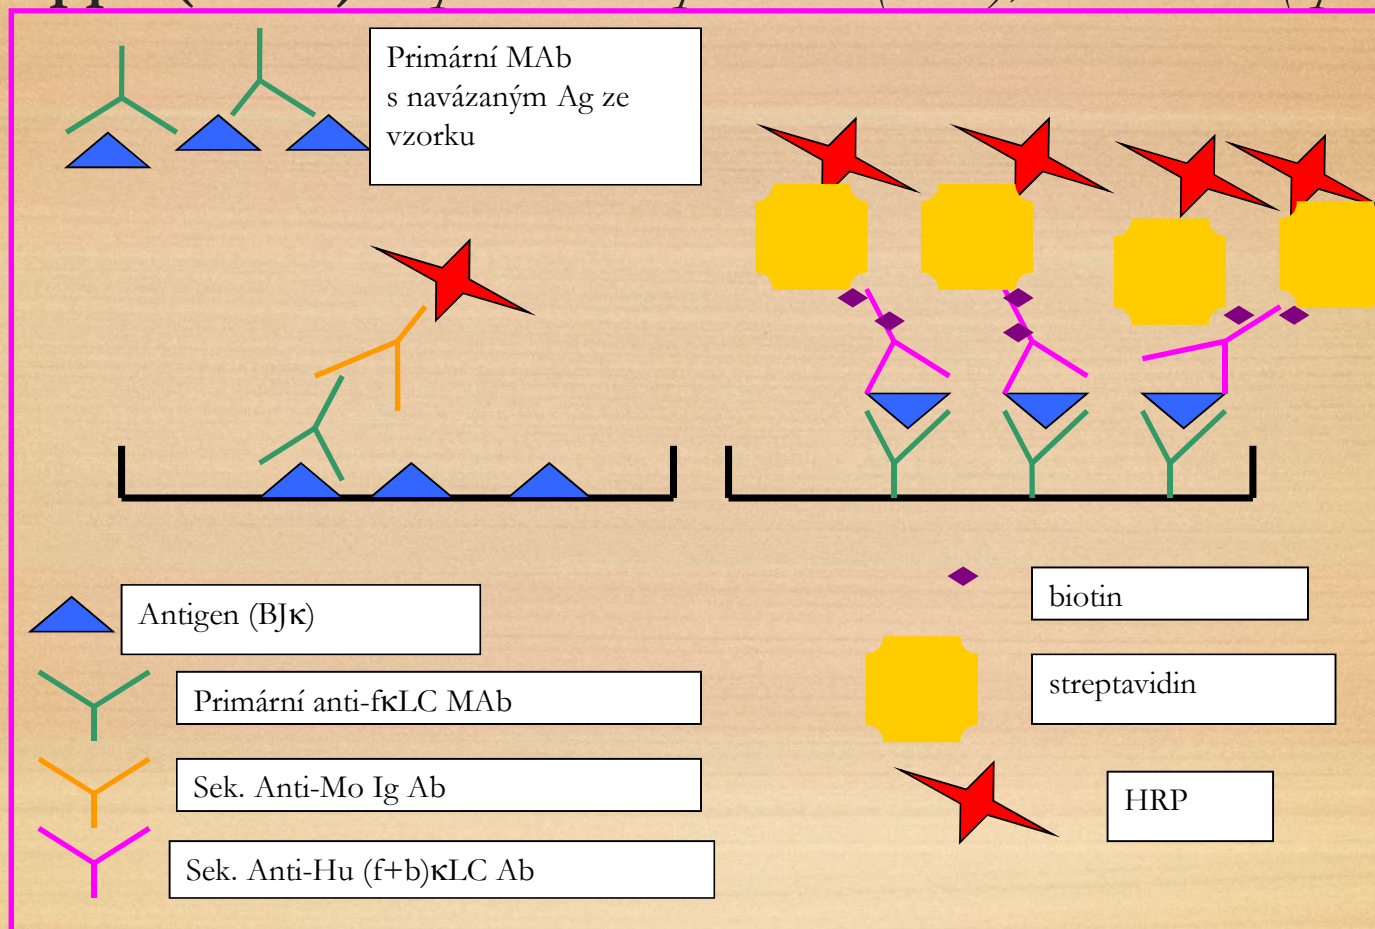

# Kalibrace

- Kalibrátor č. 1 o koncentraci 2,56 mg/L a dále ředění dvojkovou řadou až k 0,01 mg/L (popř. 0,005 mg/L)
- 9- (10-)bodová sigmoidní kalibrační křivka za použití rovnice

$$A = C + [(D-C)/(1+e^{-2(\alpha+\beta*x)})]$$

A ... absorpance při 492 nm (proti referenční vlnové délce 620 nm)

C a D ... dolní a horní asymptota kalibrační křivky

$\alpha$ ... posun lineární části kalibrační křivky v systému souřadnic


$\beta$  ... směrnice lineární části kalibrační křivky

X ... log koncentrace f<sub>k</sub>LC (μg/L)


Koncentrace počítány z rovnice kalibrační křivky po vyjádření x pomocí programu Microsoft Excel

# Kalibrační křivky a křížové reakce v nepřímém kompetitivním a sendvičovém ELISA testu

Nepřímá kompetitivní ELISA: kalibrace fKLC (modře);  
křížová reakce: IVIgG (fialově)

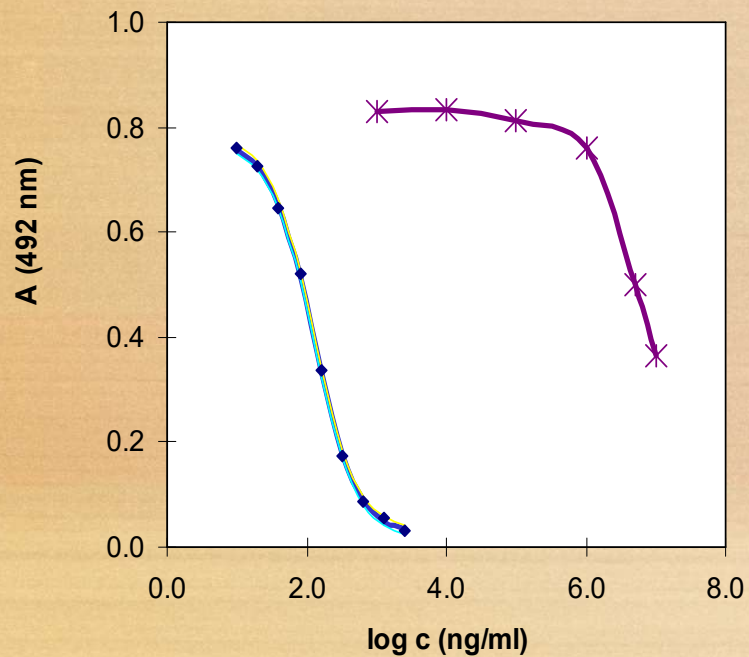


Sendvičová ELISA : kalibrace  
fKLC (modře), křížová reakce: IVIgG (fialově)

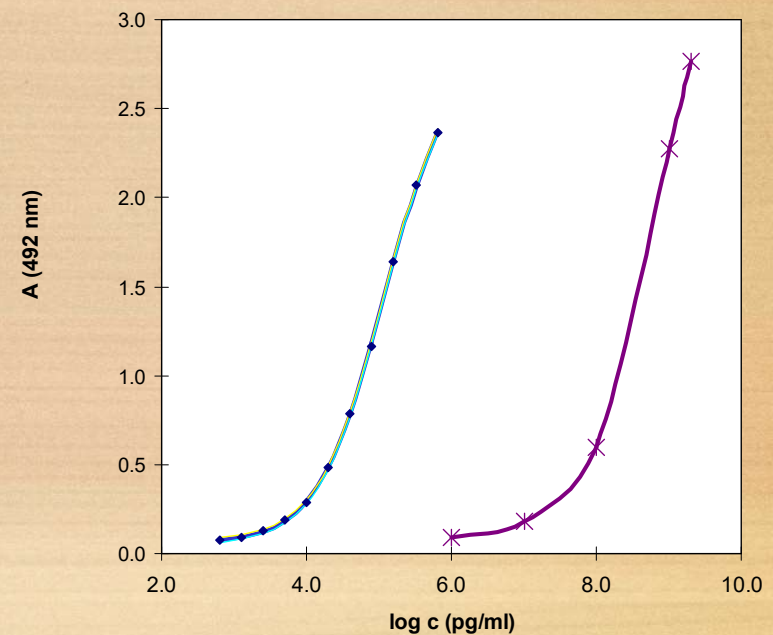


# Srovnání variant použité nepřímé kompetitivní ELISA metody


Srovnání mezi preinkubací s MAb (plná modrá křivka) a převrstvením vzorku MAb (čárkovaná červená křivka)

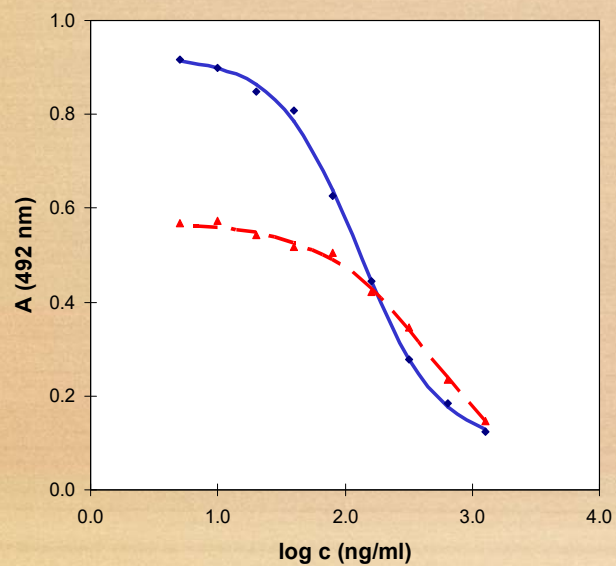

Srovnání standardní metody (plná modrá křivka) a metody s biotin-streptavidinovou amplifikací (čárkovaná červená křivka)

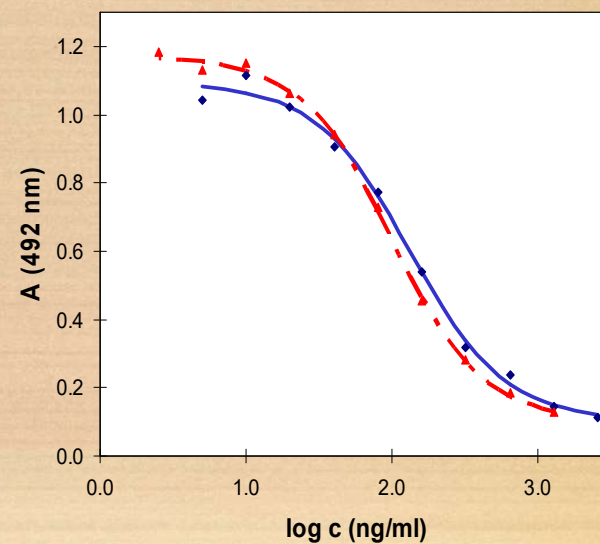

Koncentrace fκLC získané standardní ELISA metodou a metodou s biotin-streptavidinovou amplifikací v 11 vzorcích CSF, séra a moči

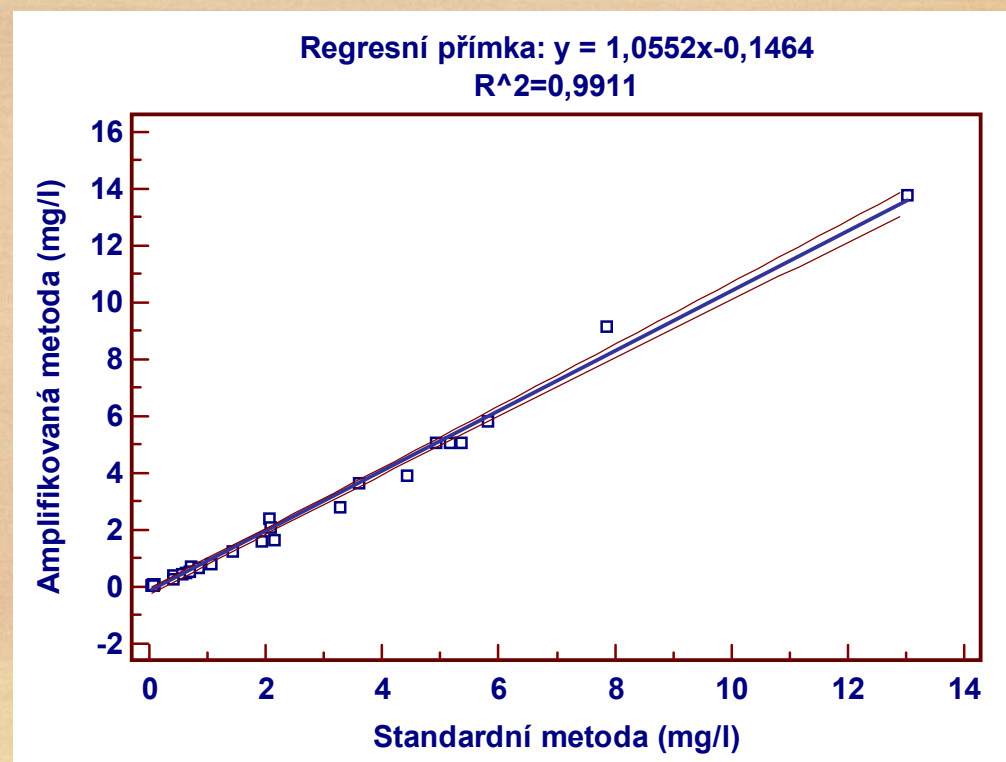



# Analytické charakteristiky metody:

## I50 a detekční limit

(n = 14)	<b>Průměr</b> (mg/l)	<b>SD</b> (mg/l)	<b>Rozmezí</b> (mg/l)
<b>I50</b>	0,133	0,024	0,095 – 0,169
<b>Detekční limit = <math>D - 0,1*(D-C)</math></b>	0,024	0,008	0,012 – 0,041




# Vazebná křivka

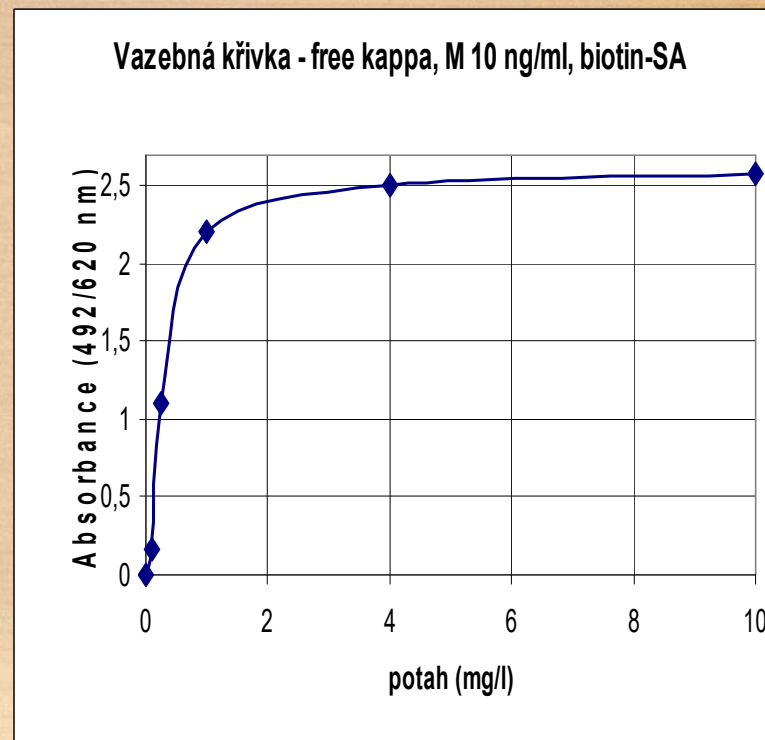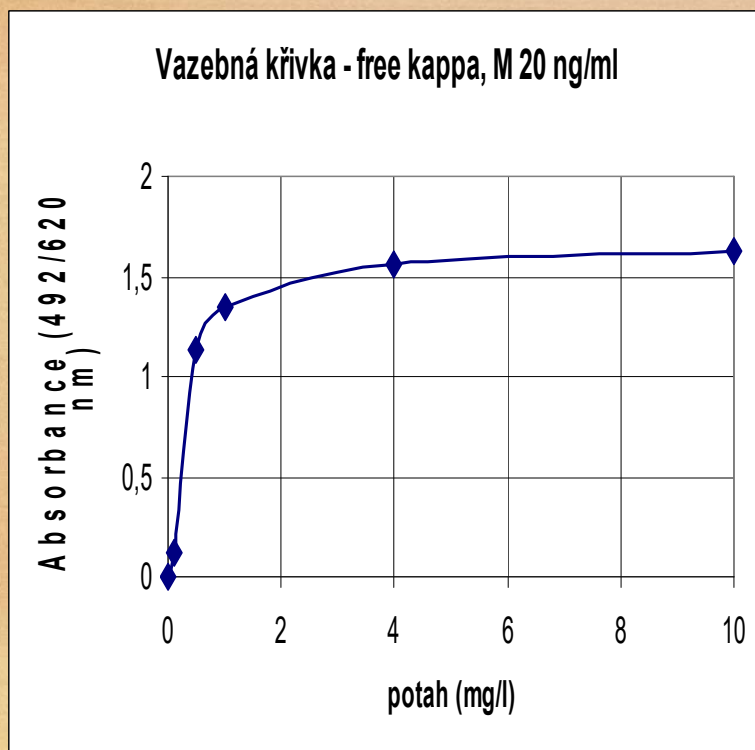

## MRZ reakce – kalibrační křivka modifikovaná přídavkem 5. kalibrátoru

- s použitím původní čtyřbodové křivky řada vzorků neměřitelně nízkých, zejm. u anti-measles IgG
- OD 4×ředěného nejnižšího kalibrátoru  $> 10 \times (\text{OD blanku} + 3 \text{ SD})$  – ověřeno opakovaně pro všechny používané kity (measles, rubella, VZV, EBV)
- arb.j. znásobeny  $\times 10$  (vzhledem k logaritmické ose koncentrací)

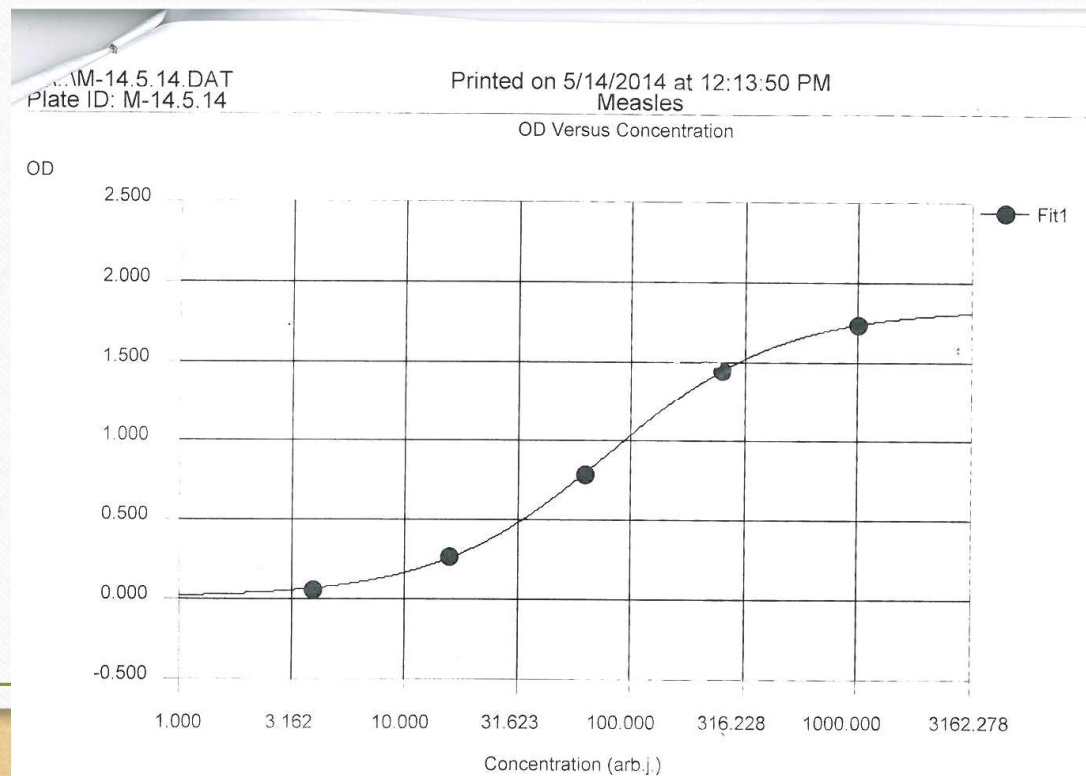

# ELISA - instrumentace

---

promývačka



ELISA reader iMark (Bio-Rad)



## Automatizace: ELISA analyzátor DSX (Dynex)

---

