

Regulační diagramy (Control charts, Shewhart's diagrams)

- diagram spolu s horní nebo/a dolní regulační mezí, do kterého se zakreslují hodnoty nějakého statistického ukazatele pro řadu výběrů nebo podskupin, obvykle v časové posloupnosti nebo v pořadí čísel výběrů
- používá se jako grafická pomůcka umožňující oddělit náhodné příčiny variability procesu od systematických příčin


Představení regulačních diagramů

- Když něco produkujete systematickým způsobem - náhodné chyby, které se vyskytnou, vedou k normálnímu (Gaussovskému) rozdělení výsledků


průmyslový výrobek nebo **analytický výsledek**

vycházejíce ze **stejného zdroje** vlivu nebo variace


- Například, předpokládejme, že daný proces je závislý na 3 zdrojích variace (3 různé operace), a každý z nich je náhodného charakteru
- Spojme body zdroje A**
- Ted' body zdroje B**
- A body zdroje n**
- Výslednice všech zdrojů má normální rozdělení

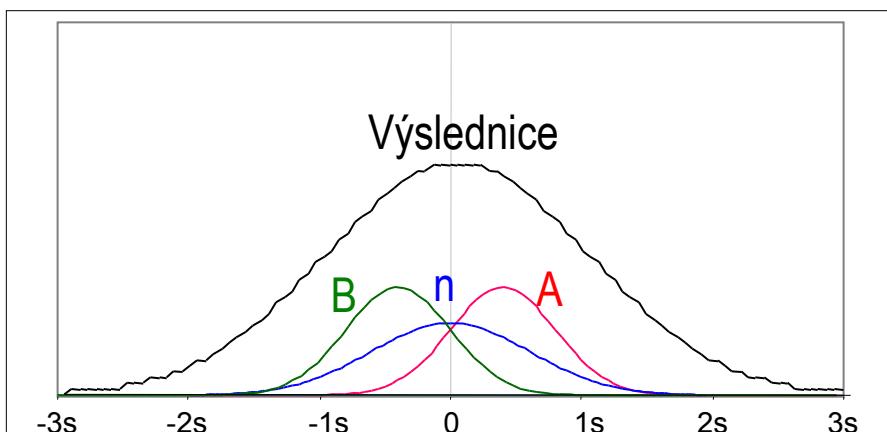


- O výrobě říkáme, že je pod kontrolou, pokud výrobky (výsledky) splňují charakteristické vlastnosti normálního rozdělení

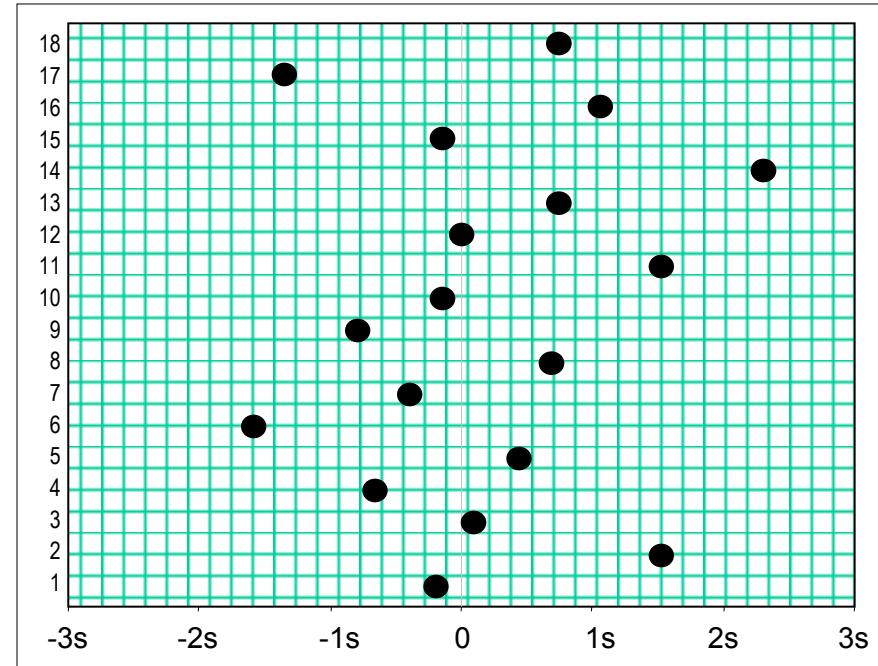


- Nyní do grafu zakreslit výsledky v chronologickém pořadí, tj. jeden po druhém, v pořadí, ve kterém jsou získávány ...

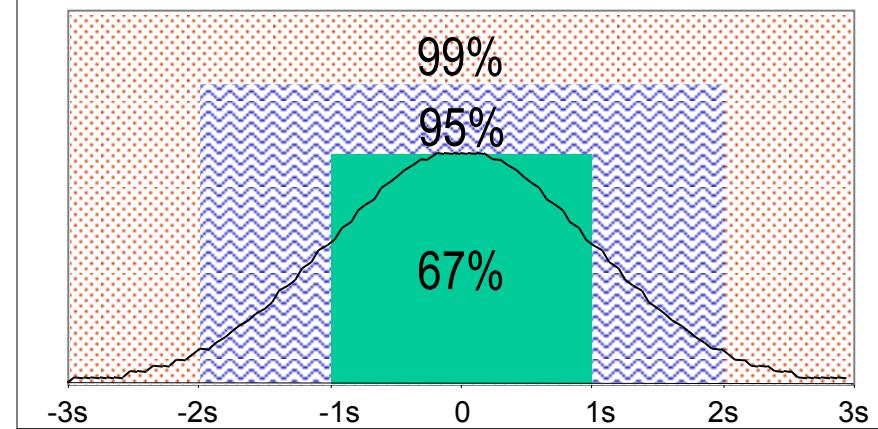

- Nyní graf a diagram otočme tak, že body jsou vkládány do diagramu z levé strany na pravou
- (x-ová osa znázorňuje čas)
- Jelikož předpokládáme, že více než 99% bodů leží na ploše od **-3s** do **+ 3s**, každý bod spadající mimo tyto hranice s velmi vysokou pravděpodobností nebude zapříčiněn náhodným rozptylem zdrojů ...
- Tyto čáry se nazývají **akční meze** nebo **regulační čáry**

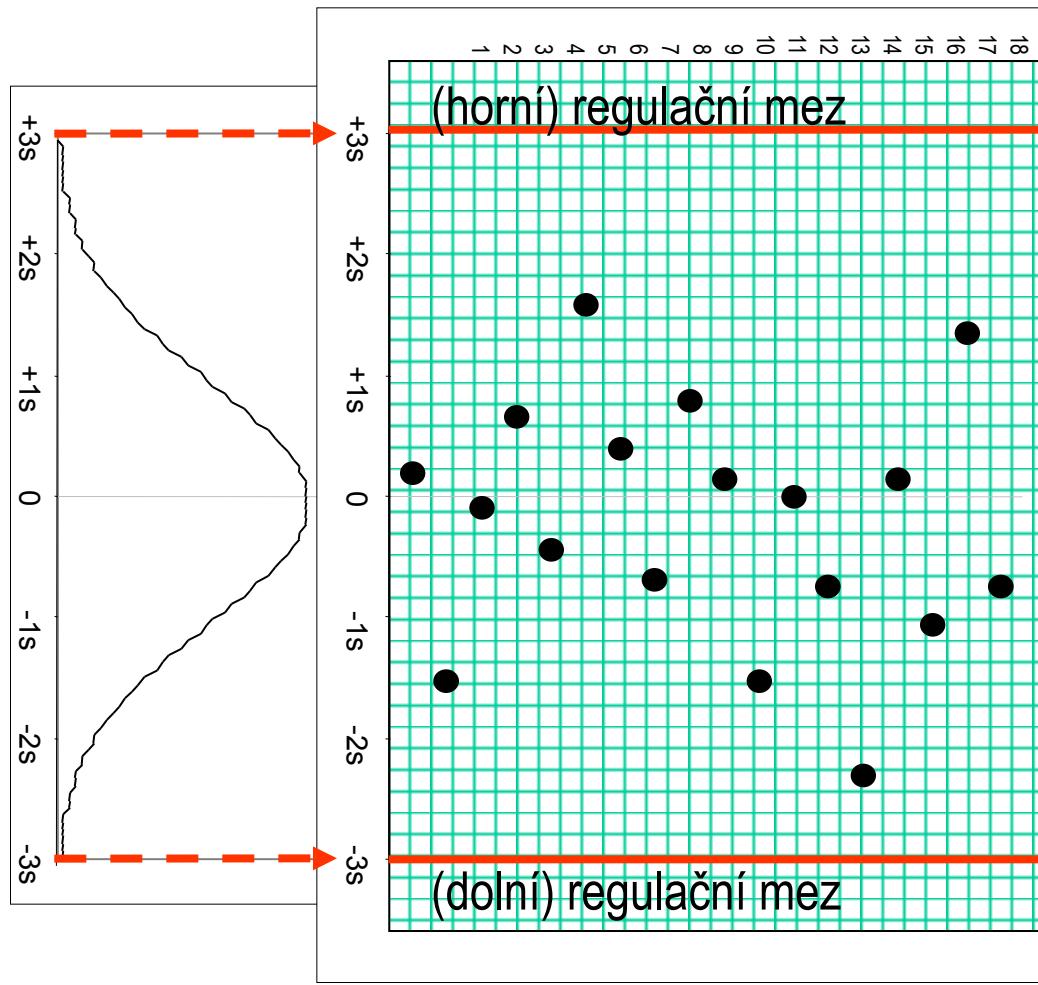

- ▶ Podobně, pravděpodobnost, že jeden bod padne mimo plochy od $-2s$ do $+2s$ je 5%, ale pravděpodobnost, že 2 po sobě následující body (nebo 2 z 3 po sobě následujících bodů) padnou mimo této plochy je velice malá
- ▶ Je obecně zaužíváno zakreslit čáry podél bodů $-2s$ a $+2s$
- ▶ Tyto čáry se běžně nazývají výstražné meze

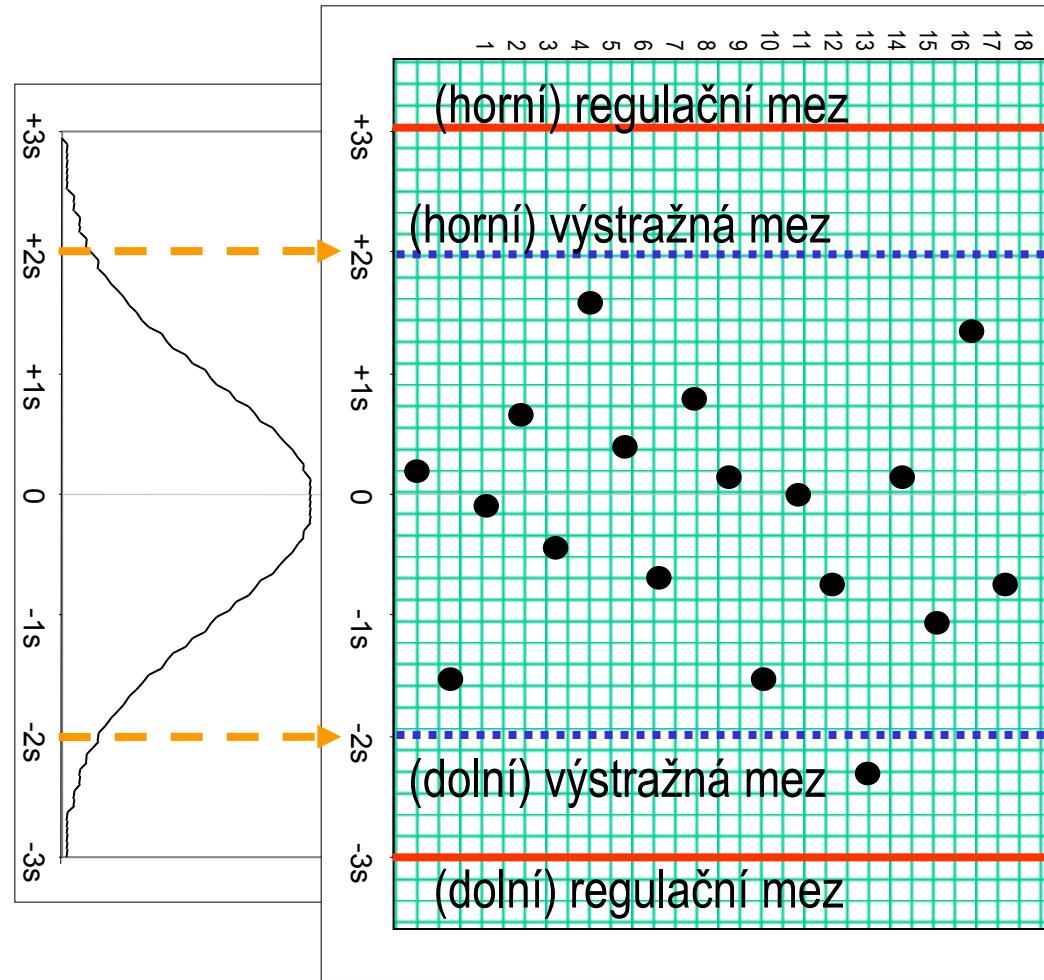

Typy regulačních diagramů (RD)

- Existují dva způsoby hodnocení výsledků kontrolních vzorků pomocí regulačních diagramů v závislosti na použitých metodách:

Jestli je systematicky použitý stejný počet (**několik**) kontrolních vzorků pro skupinu (nebo za den) **analýz**, pak je na místě zvažovat průměrný kontrolní vzorek a regulovat tento průměr pomocí **regulačního diagramu pro průměr**

Jestli je použitý jenom **jeden kontrolní vzorek** (nebo **několik**, ale **počet se mění** od série k sérii, nebo ze dne na den), pak je na místě zvažovat každý kontrolní vzorek samostatně. V tomto případě by měl být použitý **regulační diagram individuálních hodnot**




Rutinní vzorek




Kontrolní vzorek

Kontrola na základě průměru

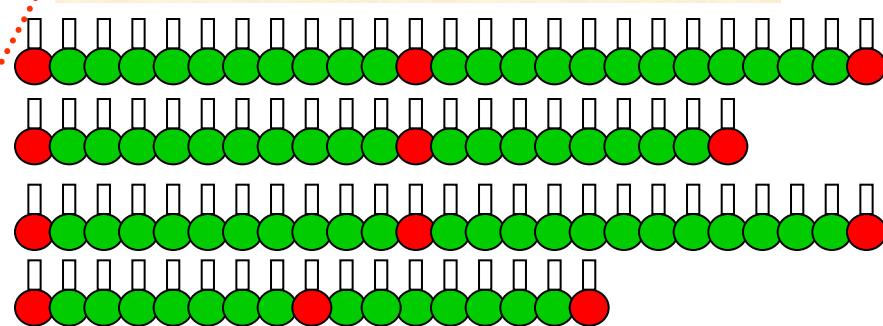


Individuální kontrola

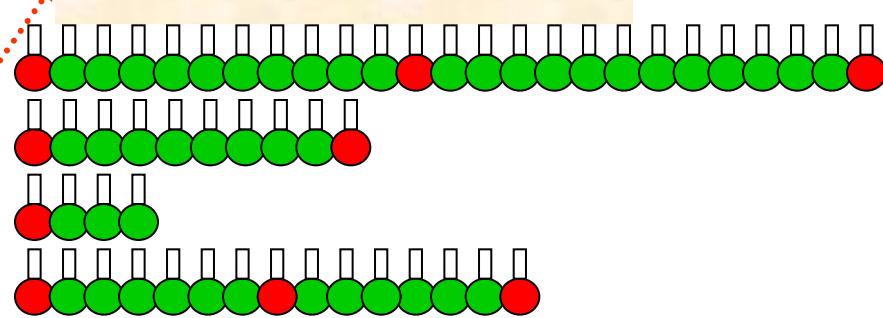

Regulační diagramy individuálních hodnot

- Regulačné diagramy individuálních hodnot získáme zakreslením hodnot kontrolních vzorků (QC) v pořadí, v jakém jsou analyzovány


Údaje	Ukázka
1	10
2	13
3	9
4	9
N	

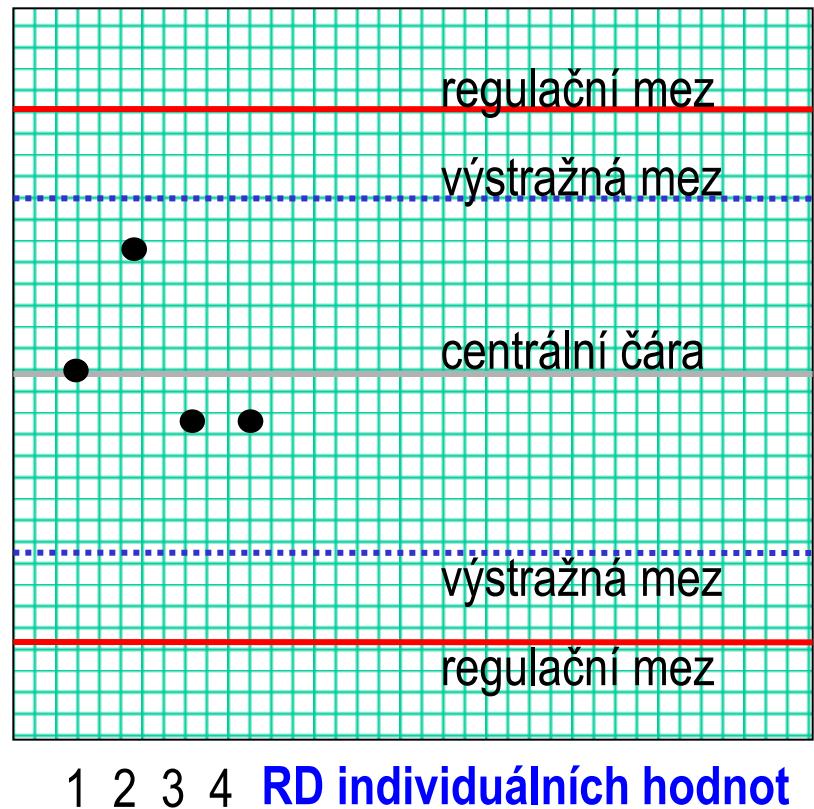

Meze diagramu

- Vzhledem k množství shromážděných údajů by měl být pro stanovení mezí aplikován zvláštní přístup
- Pokud jsme získali **malý počet údajů** (tj méně než 50 bodů) , pak můžeme říci , že skutečná hodnota parametrů (průměr , směrodatná odchylka) je neznámá, a vzhledem k dané situaci by měla být stanovena tolerance ; korekce jsou vytvářeny pomocí normálního rozdělení a meze by měly být převzaty z **Tabulky neznámých parametrů**
- Když máme **dostatečné množství údajů** , abychom mohli s jistotou říci , že skutečná hodnota parametru je známa (tj více než 50 bodů) , pak by měly být meze převzaty z Tabulky známých parametrů založené na normálním rozdělení

Meze X-R' diagramů

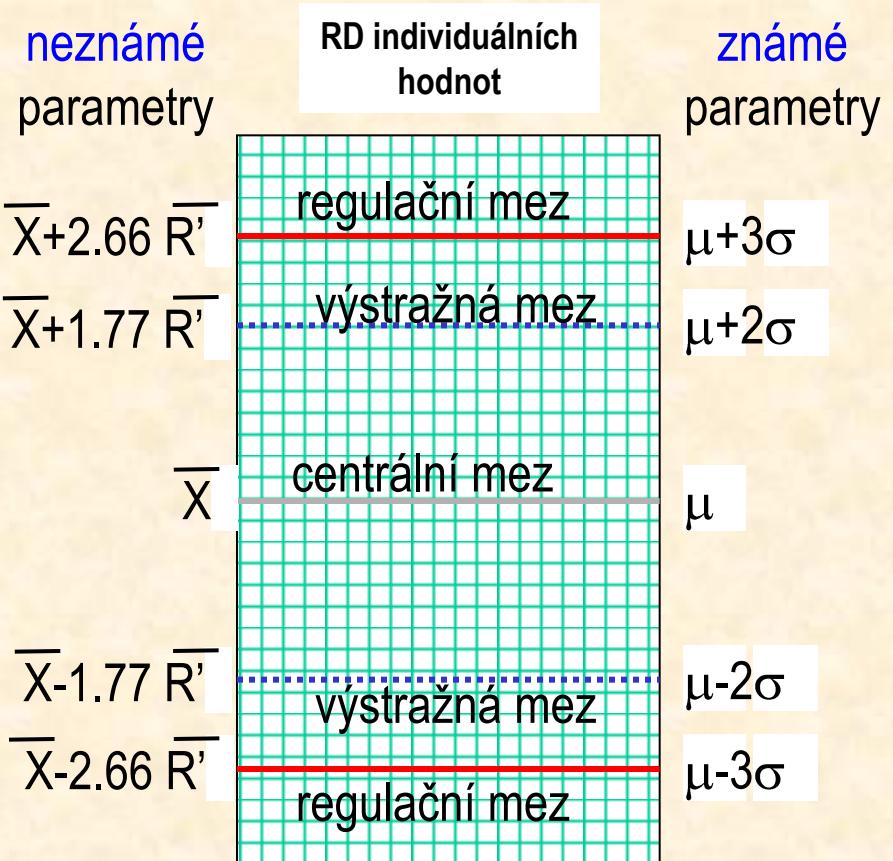

\bar{X} = průměr bodů

μ = 'skutečný' průměr

σ = 'skutečná' směrodatná odchylka



\bar{R}' = průměrná hodnota klouzavého rozsahu bodů

POZNÁMKA: Směrodatná odchylka může být stanovena z rozsahu: $\sigma = R / d_2$


Pravidla hodnocení (Xm&X diagramy)

- V procesu **hodnocení** je vhodné rozdělit regulační diagram na **3 zóny**:

centrální zóna
od $-1s$ do $+1s$

výstražná zóna
od $-1s$ do $-2s$
a od $+1s$ do $+2s$



regulační zóna
od $-2s$ do $-3s$
a od $+2s$ do $+3s$

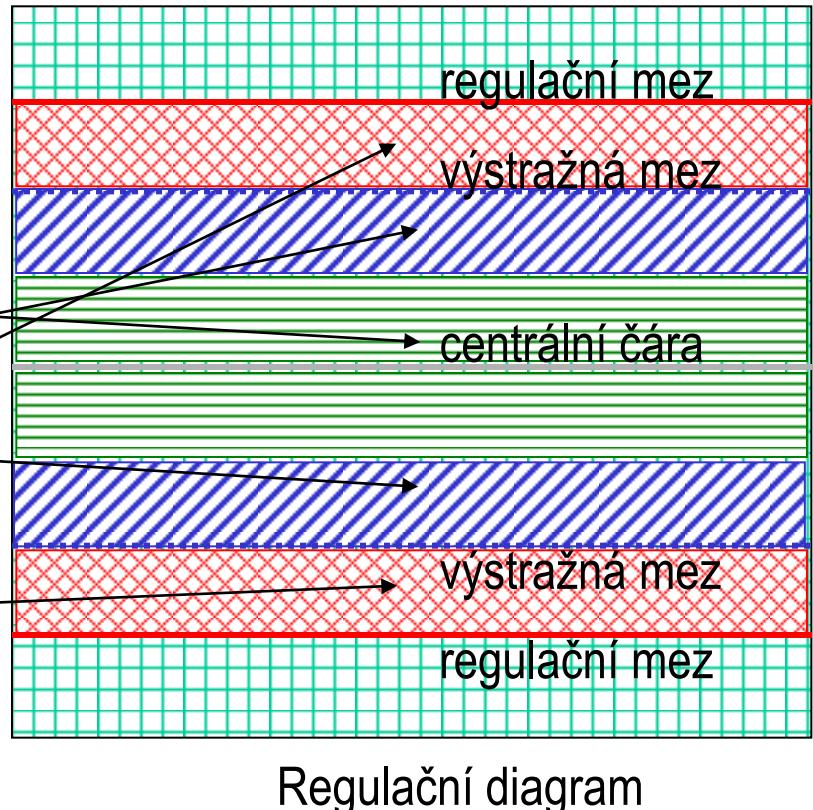

- Pravidla pro hodnocení popsána na nasledujících stránkách jsou založena na normálním rozdělení a byla převzata z literatury



Pravidla hodnocení (Xm&X diagramy)

- 1 bod mimo regulační zónu
- 6 po sobě nasledujících bodů stoupá nebo klesá

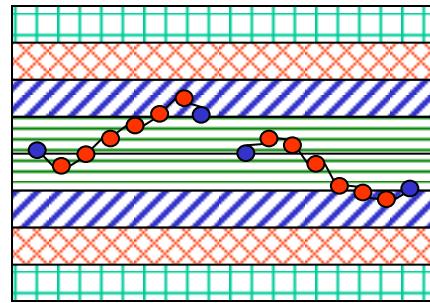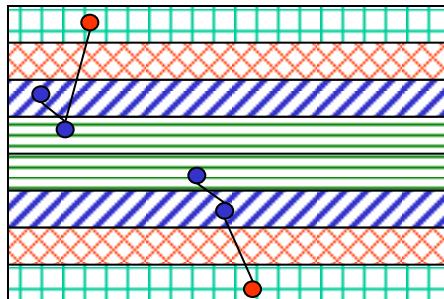


=> trend

- 2 ze 3 po sobě následujících bodů v regulační zóně
- 9 po sobě následujících bodů na jedné straně regulační čáry

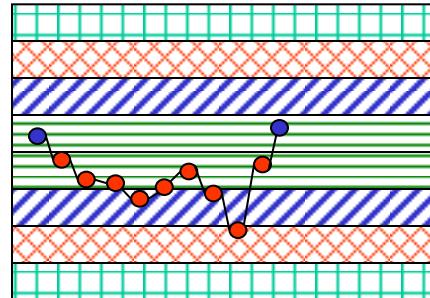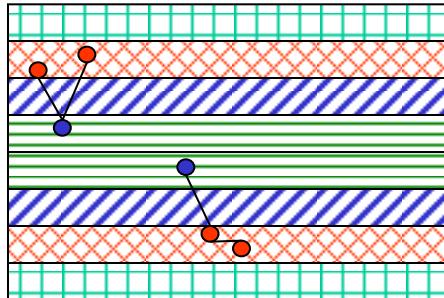


=> posun v průměrné
nebo střední hodnotě

- 14 po sobě následujících bodů střídavě stoupá nebo klesá

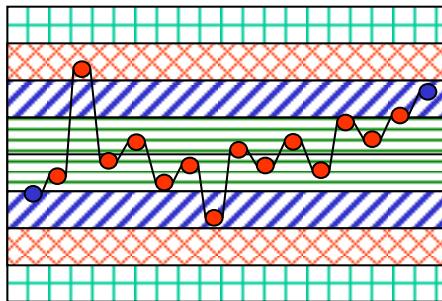


=> cyklický jev
nebo přechodné série

- 15 po sobě následujících bodů v centrální zóně

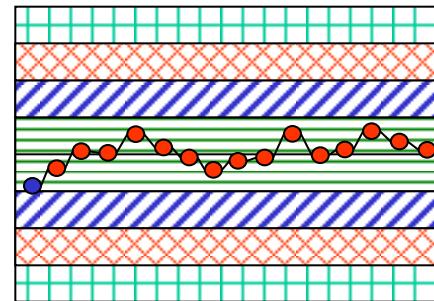


=> zlepšení
přesnosti = menší
směrodatná odchylka

- 4 z 5 po sobě následujících bodů ve výstražné zóně nebo mimo ní

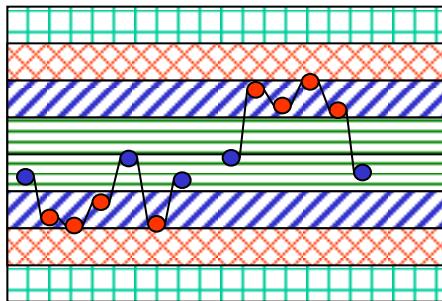

- 8 po sobě následujících bodů nad nebo pod centrální zónou

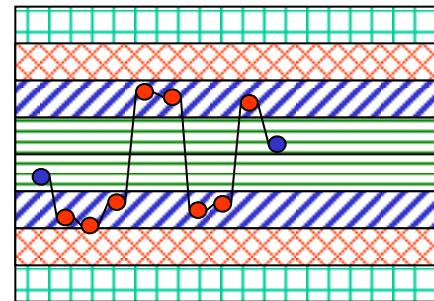

=> 2 různé
základní soubory