

Elektroforéza

Rozdělení proteinů na základě pohyblivosti v el. poli

K realizaci je nutné mít:

- Stejnosměrný el. proud
- Speciální elektroforetické vany
- Vhodný pufr a nosič (dříve papír, acetátcelulóza, agar) nyní agaróza polyakrylamidový gel

Elektroforéza v imunologii

molekuly s (–) nábojem → **k anodě (+)**

(+) nábojem → **ke katodě (–)** proti zrychlení působí **odpor prostředí**
pohyblivost molekul je dána:

1. velikosti povrchového náboje

- elektrochemicky se uplatňují pouze *skupiny na povrchu globule* ~ **KONFORMAČNÍ STRUKTURA**
- velmi silně se mění *vlastnosti při denaturaci* ~ na povrch se dostanou další skupiny → **mění se elektrochemické vlastnosti**

2. velikosti molekul

- větší se pohybují pomaleji ~ **odpor prostředí**
- záleží i na *velikosti síta nosiče*

3. tvaru molekul

- *kulovité* se pohybují *rychleji*

4. podmínkami prostředí

- * typ nosiče ~ *agaróza, polyakrylový gel* *
- hodnota pH tlumivého prostředí /pufru/
- * iontové složení prostředí

- 2 způsoby elektroforézy:
- • volná ~ volný elektrolyt, elektrody volně v roztoku
- - po vypnutí proudu molekuly difundují zpět
- → nákladné a nepřesné
- • zónová ~ zvýšení viskozity prostředí, ve kterém se elektroforéza provádí
- (ve vodě větší rychlosť difuze než ve škrobu)
- - vytváří se tedy **pórovité gely** - škrob, acetylcelulóza, agar, polyakrylamid, agaróza
- - *směs bílkovin se nanese do míst startu, pustí se el. proud* → **bílkoviny se detekují**

PÓROVITÉ NOSIČE jsou ponořeny **do vodivého roztoku /pufru/**

- funkce: přenos el. proudu
- udržování konst. pH → dělené molekuly během elektroforézy nemění náboj
- elektroforéza globulinů**
- kvalitativní a kvantitativní určení, popř. i pro separaci
- dělení:*
 - podle náboje
 - podle velikosti molekul (M_r)

Imunoelektroforetické metody

- kombinace metod elektroforetických a imunodifúzních
- Bílkoviny se dělí v závislosti na molekulové váze a elektrickém náboji jednotlivých molekul v přítomnosti vDělení séra
- - jednotlivé obloučky znamenají jednotlivé bílkoviny
- → detekce až 35 sérových proteinů
- hodného pufru a na vhodném nosič..

ELEKTROFORÉZA

nosič elektroforézy

-

katoda



jamka pro sérum pacienta

+

anoda

ELEKTROFORETOGRAM

-



START

+

DENZITOMETRIE

-

+

imunoglobuliny

γ
globuliny

C3, C4, C5 komplement
 β -lipoprotein
transferin

β
globuliny

α_2 -makroglobulin
haptoglobin

α_1 -antitrypsin

α
globuliny

albumin

Elfo sérových proteinů




Při běžné elfo se sérum dělí na zónu albuminu, $\alpha - 1$, $\alpha - 2$, β , γ globulinů. Stanovení zastoupení jednotlivých frakcí může mít význam při hodnocení stádia zánětlivého procesu. Při akutních zánětech stoupá zastoupení $\alpha - 1$, později i $\alpha - 2$, při chronických zánětech dochází ke zvýšení zastoupení γ globulinů a poklesu albuminu

Imunoelektroforetické metody


- imunoelektroforéza ***podle WILLIAMSE a GRABARA***
- ***RAKETOVÁ*** imunoelektroforéza
- ***PROTISMĚRNÁ*** imunoelektroforéza
- ***DVOJROZMĚRNÁ*** imunoelektroforéza

Imunoelektroforéza podle WILLIAMSE a GRABARA:

- - 1953 *Williams a Grabar*
- - 2 stupně: 1. ***nalití destičky*** (agarózní gel s pufrem)
- vytvoření 2 žlábků a nanesení Ag mezi ně
- po rozdělení elektroforézou se do žlábků 2. napipetují ***protilátky***
- inkubace 48 hodin v lednici → dochází k **DIFUZI**
- → v místě ekvivalence se vytváří **PRECIPITAČNÍ obloučky**

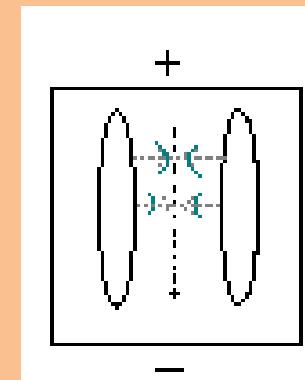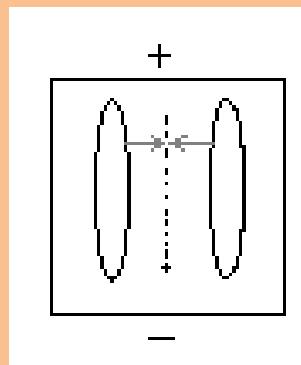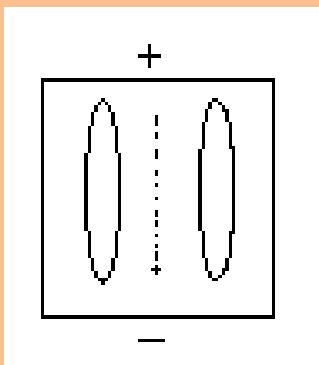


Imunoelektroforéza

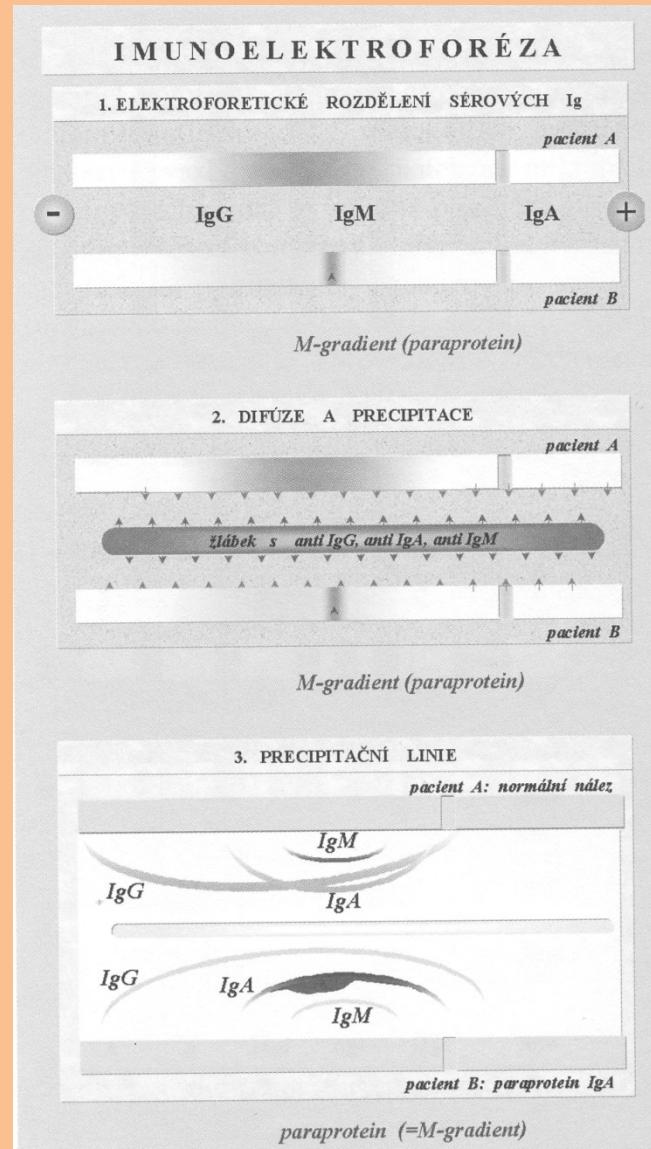


Raketová

- - Laurell 1966
- - kombinace jednoduché radiální imunodifúze s elektroforézou
- - monospecifická Ab + jeden Ag /či směs Ag/

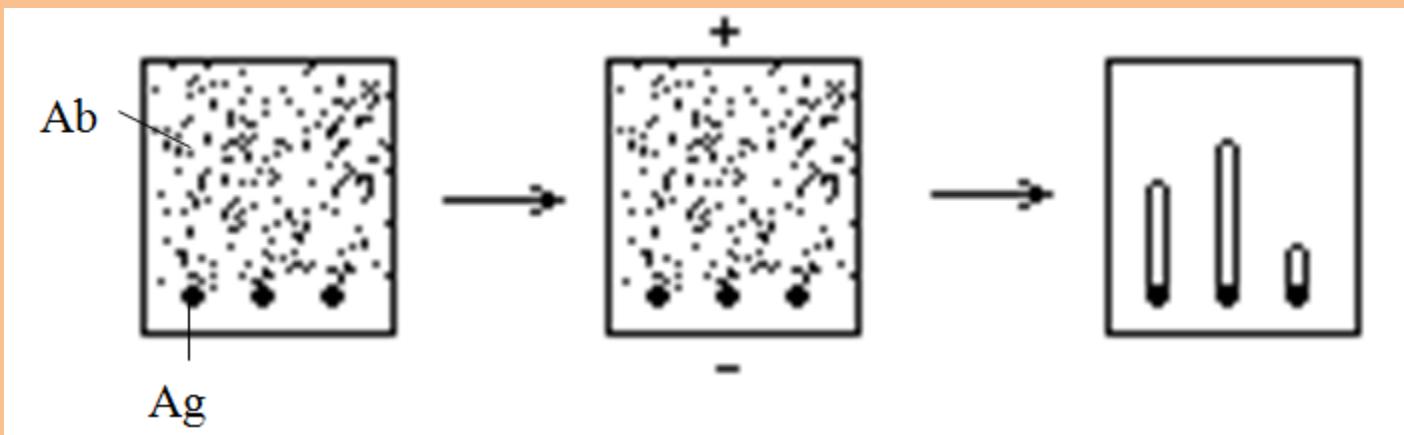


užívá se pro ***zjišťování koncentrace Ag*** – koncentrace je přímo úměrná výšce „raketky“



kalibrační křivka:

PROTISMĚRNÁ imunoelektroforéza

- obměna jednosměrné dvojité imunodifúze, kdy je *pohyb urychlován el. proudem*

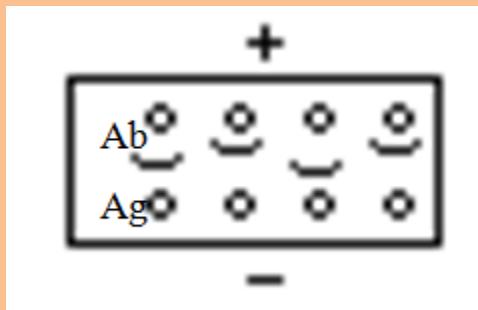

2 řady jamek:


Ab...vždy k (-)

Ag...pouze ty se (-) nábojem

- v místě ekvivalence **vzniknou precipitační obloučky**

DVOJROZMĚRNÁ imunoelektroforéza

- vypracována nezávisle na sobě : 1965 Laurell a Laurelllová
1966 Clair a Frieman
 - postup: • čistý gel + Ag – elektroforéza, rozřeže se

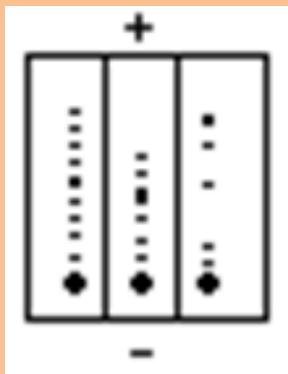

- nanese na čisté sklíčko a zalije se gelem, který obsahuje **rozptýlené polyspecifické protilátky**:



- v místě ekvivalence se vytvoří **precipitační útvary** – výška a plocha útvaru je úměrná koncentraci Ag:



v séru lze detegovat až 50 proteinů

Využití těchto metod:

<i>Metoda</i>	<i>KVALITATIVNÍ</i>	<i>KVANTITATIVNÍ</i>
1.	++	-
2.	-	++
3.	++	-
4.	++	+

legenda:

- ++...velmi vhodná
- +....vhodná
-nevhodná

Imunoelektroforetické metody

- **Využití:** Imunoelfo séra se v současné době používá výhradně k průkazu **monoklonálního imunoglobulinu v lidském séru – paraproteinu – monoklonální gamapatie**. Je vždy produkován klonem buněk vycházející z jedné plazmatické b., mající genetickou informaci pro tvorbu jedné variabilní oblasti lehkých a těžkých řetězců a jedné třídy Ig molekuly. Na rozdíl od imunoglobulinů běžného séra s velkým mn. různých variabilních oblastí Ig molekul.

Praxe: Při podezdření na monokl. gamapatii se stanovuje mn. mono,-bi,-nebo oligoklonálních protilátek, které jsou produkty jednoho nebo několika málo patologicky zmnožených kmenů B lymfocytů

- **Paraprotein** se nachází. 1. u nemocných s myelomem (nádor vycházející z plazmatických buněk) 2. při jiných malignitách lymfatického systému, 3. při chronických zánětech 4. ve vyšších věk. skupinách


Imunofixace I.

Rozdělení různých proteinů na základě jejich pohyblivosti v el. poli modifikační metodou

1. stupeň: Elfo vyšetřovaného séra
2. Stupeň: na agarózu se položí plastikované maska s výrezy, naplní se s antiséry (antilgG, IgA, IgM, anti kappa, anti lambda), pak porovnání s precip. reakce s normálním sérem ,TSP – testovaná séra pacientů


Hodnocení

- a) Okometricky
- b) denzitometricky

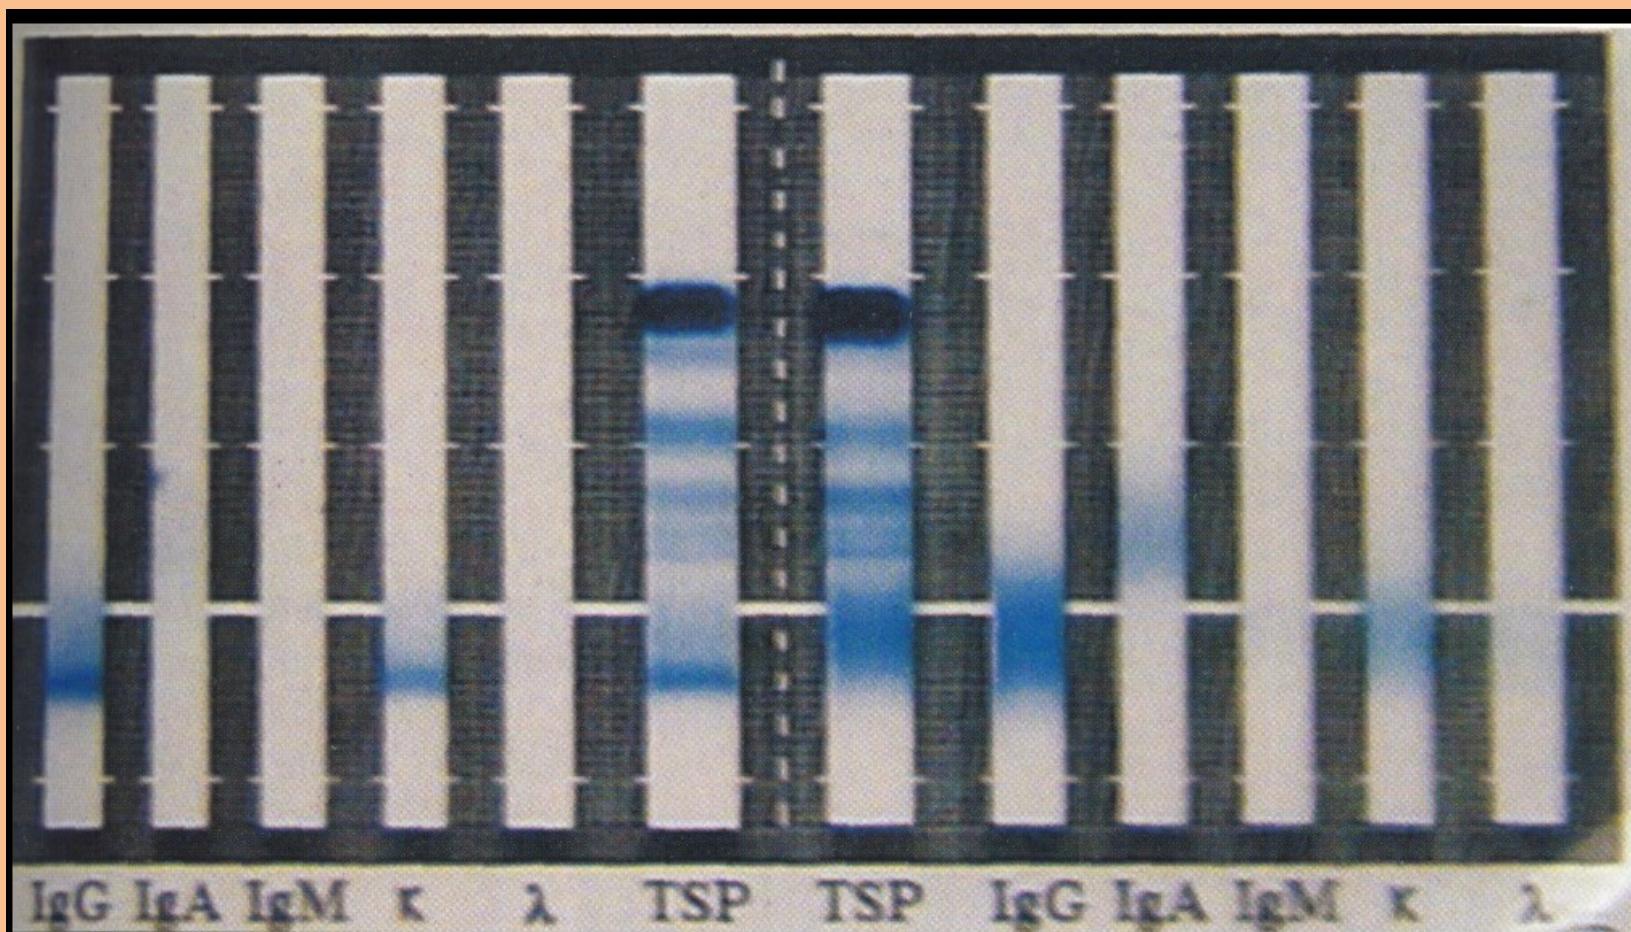


• Výsledek:

- TSP levé patologické, vpravo normální nález
- Levá ELFO patologická v paraproteinu IgG, řetězec kappa
- Vpravo ELFO normální
- Vzniká neobvyklý pruh při klasické elfo séra, neboť paraprotein se pohybuje uniformně (stejný náboj a Mr). V určitém místě elektroforetického pruhu způsobí vysokou koncentraci Ig příslušné třídy. Při následné precipitaci s přidaným antisérem je v oblasti, kam paraprotein doputoval, výrazně více antigenu, precipitační linie je deformovaná a posunuta blíže ke žlábku s antisérem


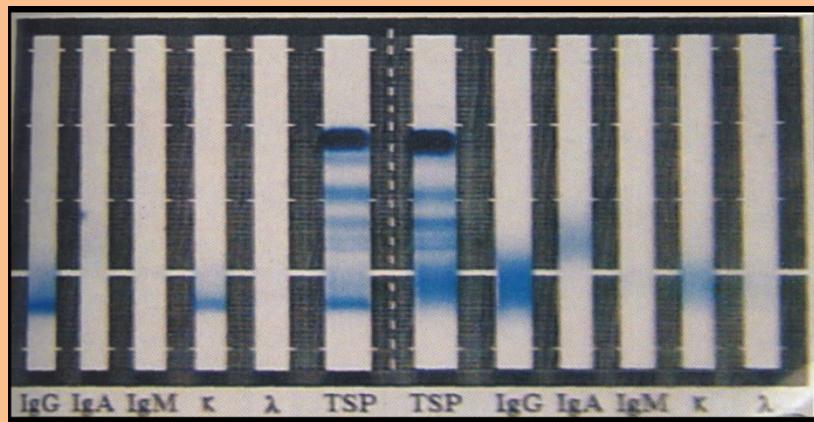


Výsledek:

- TSP levé patologické, vpravo normální nález
- Levá ELFO patologická v paraproteinu IgG, řetězec kappa
- Vpravo ELFO normální

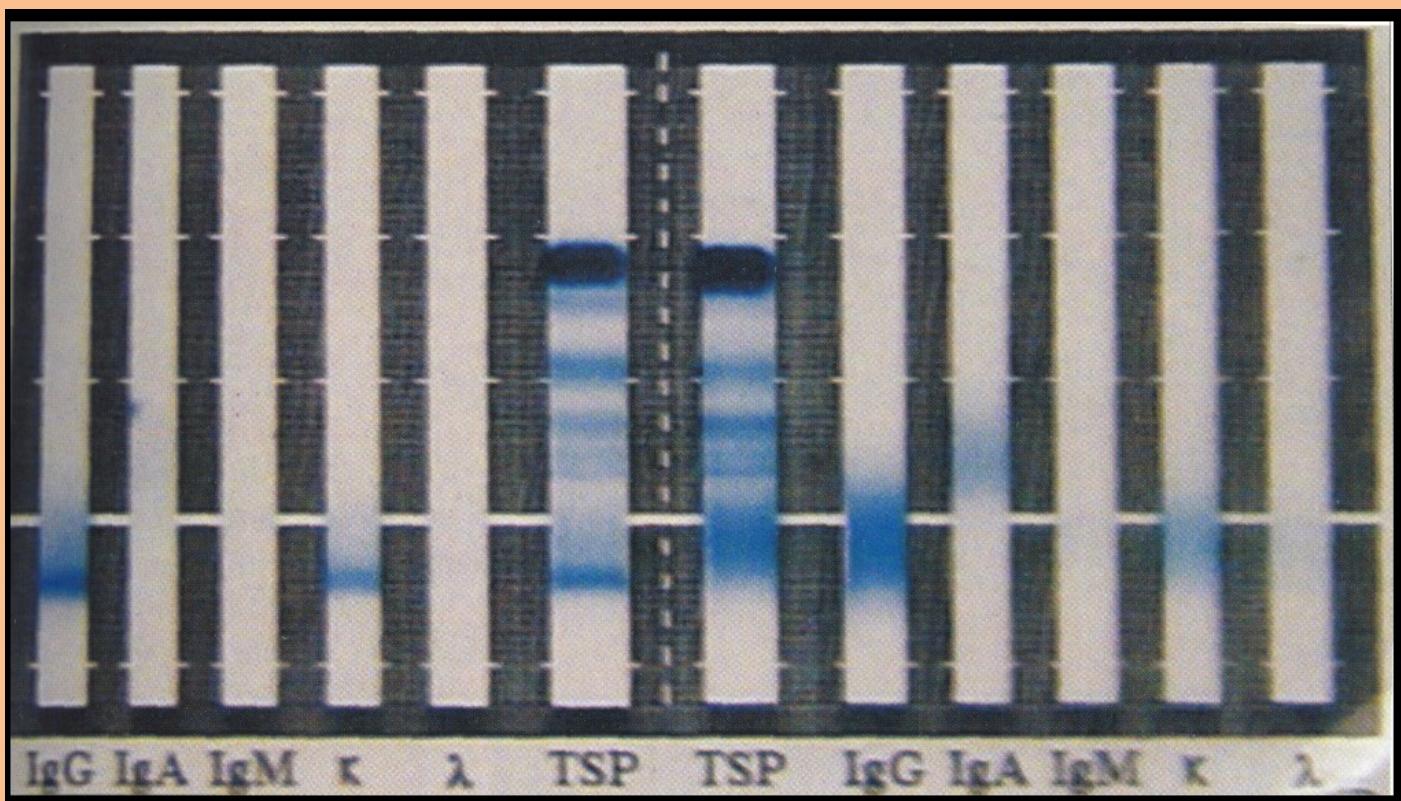

Imunofixace II.

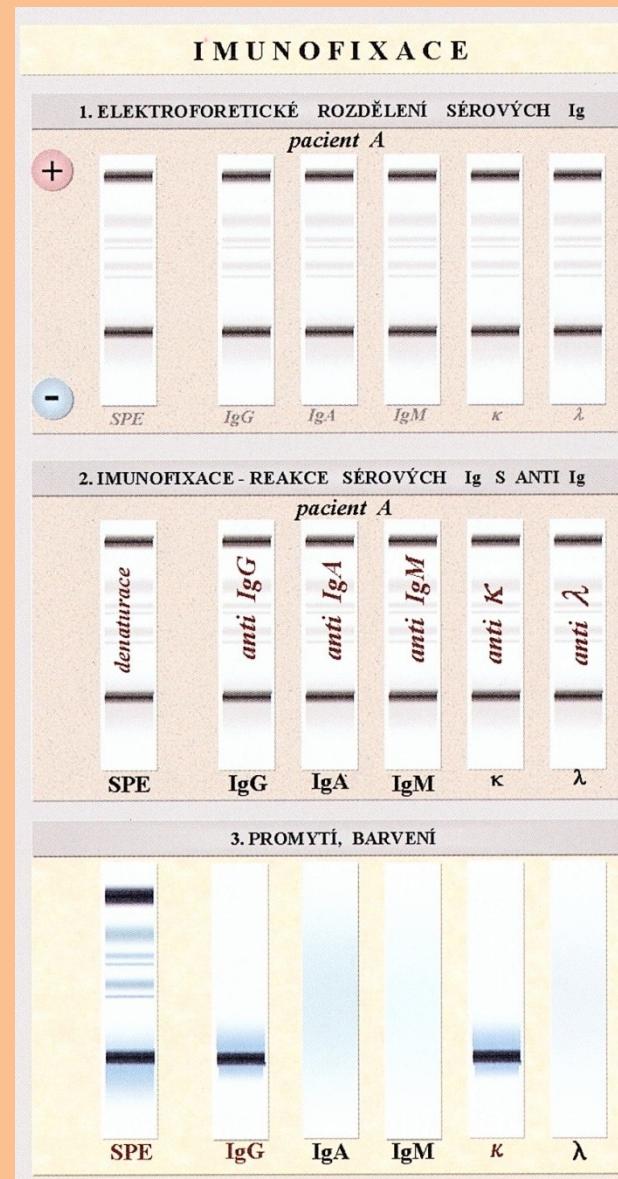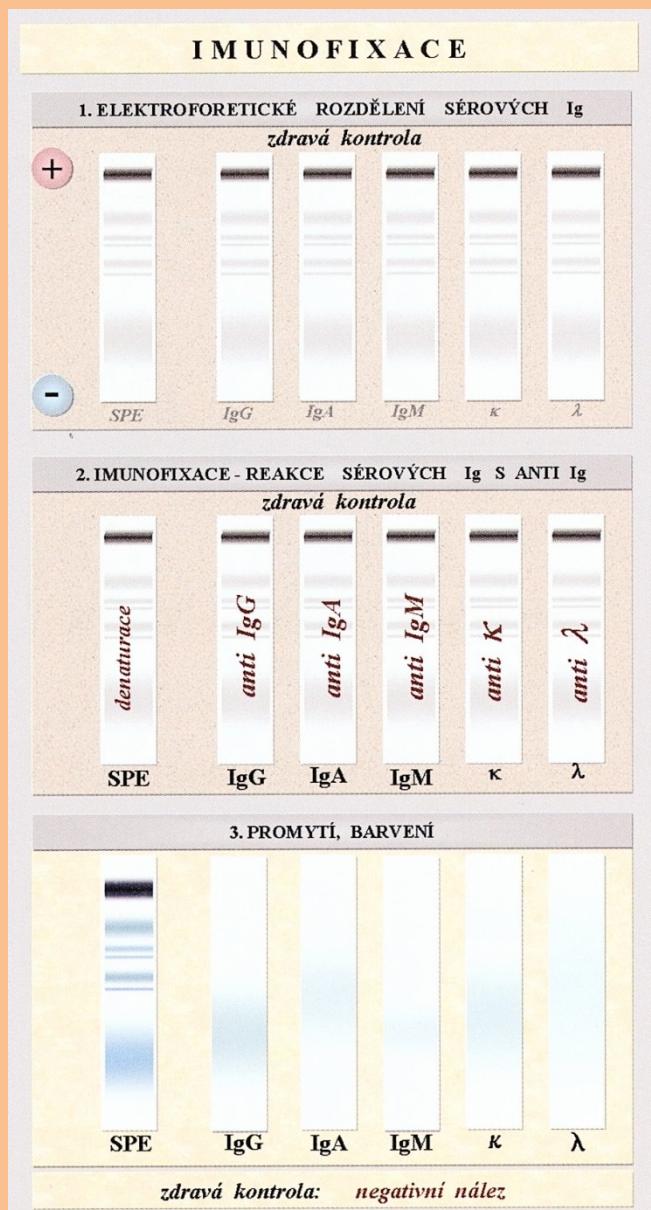

Imunofixace-výsledek

